

Paziente:

DDN: 15

Sesso: Altro

ID: 1952.1115.A6FA.50AC.4EB9.4271

ZEISS


OS Analisi singola

30-2 centrale Esame di soglia

Monitor fissazione: Sguardo/Blind Spot
Mira di fissazione: Centrale
Perdite di fissazione: 3/21
Errori falsi POS: 2%
Errori falsi NEG: 6%
Durata test: 08:13
Fovea: 35 dB


Stimolo: III, Bianco
Sfondo: 31,5 asb
Strategia: SITA Standard
Diametro pupillare: 5,6 mm *
Acuità visiva:
Rx: -1,75 DS

Data: 19-apr-2019
Ora: 12:16
Età: 66

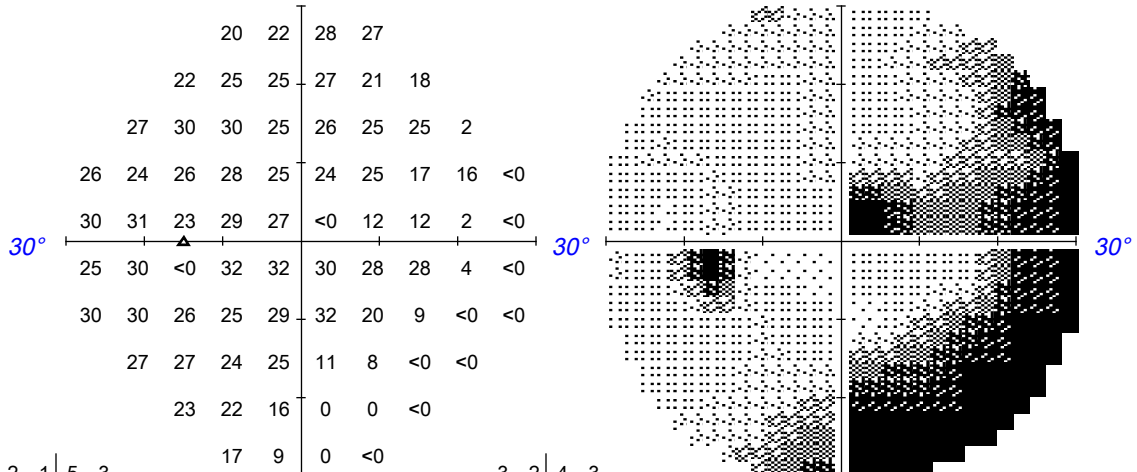


-2 -1 5 3
-3 0 -1 1 -6 -7
1 3 2 -4 -3 -4 -3 -25
-1 -4 -3 -2 -6 -7 -5 -12 -11 -27
3 2 -2 -5 -34 -19 -19 -27 -28
-3 1 1 0 -2 -4 -3 -25 -28
1 1 -4 -6 -2 0 -12 -21 -30 -28
-2 -2 -6 -6 -20 -22 -31 -29
-6 -7 -13 -29 -28 -29
-10 -18 -27 -28

Deviazione totale

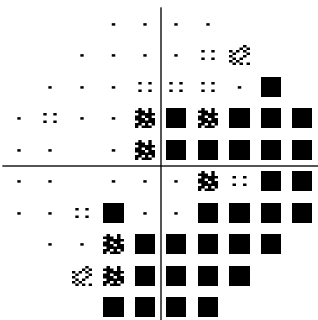

-3 -2 4 3
-4 -1 -2 0 -6 -8
0 3 1 -4 -4 -4 -4 -25
-1 -4 -4 -2 -6 -7 -6 -13 -12 -28
2 1 -2 -5 -34 -20 -19 -27 -29
-4 0 0 -1 -3 -4 -4 -25 -29
1 1 -5 -7 -3 -1 -12 -22 -31 -28
-2 -3 -6 -7 -20 -22 -32 -30
-7 -8 -13 -29 -29 -30
-11 -19 -28 -29


Deviazione dal pattern

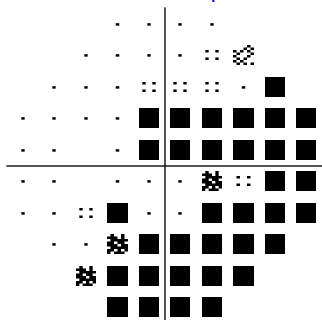

GHT: Fuori limiti normali

VFI: 72%
MD30-2: -9,94 dB P < 0,5%
PSD30-2: 12,62 dB P < 0,5%

:: P < 5%
:: P < 2%
:: P < 1%
■ P < 0.5%



Commenti

ZEISS