

ID: pex33p


## OS Analisi singola

24-2 centrale Esame di soglia

Monitor fissazione: Sguardo/Blind Spot  
 Mira di fissazione: Centrale  
 Perdite di fissazione: 2/18  
 Errori falsi POS: 8%  
 Errori falsi NEG: 0%  
 Durata test: 07:16  
 Fovea: 32 dB


Stimolo: III, Bianco  
 Sfondo: 31,5 asb  
 Strategia: SITA Standard  
 Diametro pupillare: 3,9 mm \*  
 Acuità visiva:  
 Rx:

Data: 17-gen-2020  
 Ora: 10:57  
 Età: 53

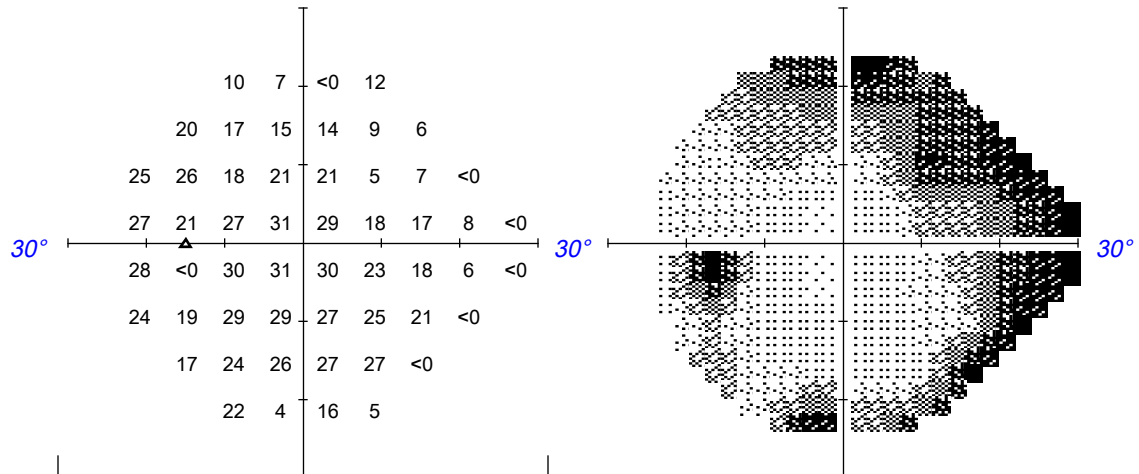


-16	-20	-29	-15
-8	-12	-14	-16
-4	-3	-13	-11
-3	-5	-2	-4
-2	-2	-2	-3
-6	-11	-3	-3
-14	-6	-5	-5
-8	-26	-14	-24

Deviazione totale

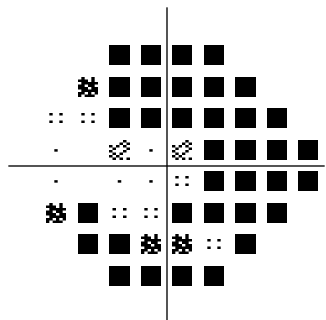

-13	-17	-27	-12
-5	-9	-11	-13
-2	-1	-10	-8
0	-2	1	-1
1	1	1	0
-3	-9	0	0
-11	-4	-2	-2
-5	-23	-11	-22


Deviazione dal pattern

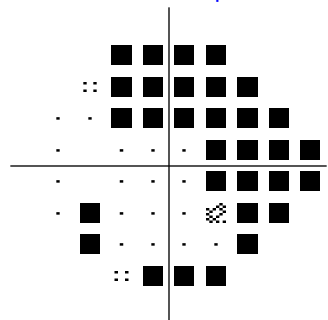

GHT: Fuori limiti normali

VFI: 72%  
 MD24-2: -11,80 dB P < 0,5%  
 PSD24-2: 9,64 dB P < 0,5%

:: P < 5%  
 :: P < 2%  
 :: P < 1%  
 :: P < 0.5%



Commenti