Single Field Analysis   Eye: Left

Name: SNASERI0123   DOB: 01-09-1950

ID: SNASERI0123

Central 30-2 Threshold Test

Fixation Monitor: Blind Spot   Stimulus: III, White   Pupil Diameter: Date: 22-10-2018
Fixation Target: Central   Background: 31.5 ASB   Visual Acuity: Time: 2:34 PM
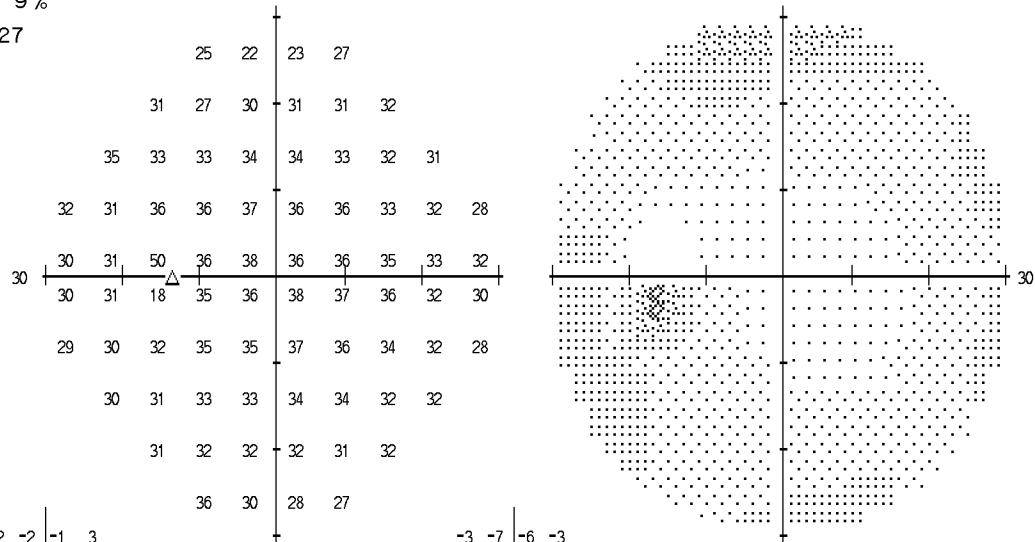Fixation Losses: 12/12 xx   Strategy: SITA-Fast   RX: +1.50 DS   DC X   Age: 68
False POS Errors: 49 % xx
False NEG Errors: 9 %
Test Duration: 05:27

Fovea: 33 dB

```
                  25  22 | 23  27
              31  27  30 | 31  31  32
          35  33  33  34 | 34  33  32  31
      32  31  36  36  37 | 36  36  33  32  28
30    30  31  50  36  38 | 36  36  35  33  32          30
      30  31  18  35  36 | 38  37  36  32  30
      29  30  32  35  35 | 37  36  34  32  28
          30  31  33  33 | 34  34  32  32
              31  32  32 | 32  31  32
                  36  30 | 28  27
```

```
              2  -2 |-1   3                      -3  -7 |-6  -3
          5   1   4 | 5   5   5                0  -4  -2 |-1  -1   0
       8  6   5   6 | 5   4   4   4          2  0  -1   0 | 0  -1  -2  -1
   4  3  6   7   6 | 5   5   3   3  2     -1 -2  1   1   1 | 0   0  -2  -2  -3
   1  2      5   6 | 4   5   4   4  5     -4 -4     -1   1 |-1  -1  -1  -2   0
  ─────────────────┼──────────────      ──────────────────┼──────────────────
   1  1      4   4 | 5   5   5   3  3     -4 -5     -2  -1 | 0   0  -1  -3  -2
   0  1  2   4   3 | 5   4   4   3  1     -5 -5 -4  -1  -2 |-1  -1  -2  -2  -4
      1  1   2   2 | 3   3   2   4           -5 -4  -3  -3 |-3  -2  -3  -1
          1   2   2 | 3   3   4              -4 -3  -3 |-2  -3  -1
              8   2 | 1   0                       3  -3 |-5  -5
```

             Total Deviation   Pattern Deviation


```
         .  . | .  .                          .  .:: | .  .
      .   .   . | .   .   .                 .   .   . | .   .   .
   .   .   .   . | .   .   .   .          .   .   .   . | .   .   .   .
 .  .   .   .   . | .   .   .   .  .     .  .::  .   . | .   .   .   .  .
 .  .      .   . | .   .   .   .  .     .  .::      .   . |.   .   .   .  .
───────────────┼──────────────      ──────────────────┼──────────────────
 .  .      .   . | .   .   .   .  .     .  .::  .:: .   . | .   .   .   .  .
 .  .   .   .   . | .   .   .   .  .     .  .:: .:: .   . | .   .   .   .  .
    .   .   .   . | .   .   .   .           .:: .:: .   . | .   .   .   .
        .   .   . | .   .   .                 .   .   . | .   .   .
            .   . | .   .                       .  . | .:: .::
```

                :: < 5%
                ⸬ < 2%
                ▓ < 1%
                ■ < 0.5%
```

*** Excessive High False Positives ***

GHT
Abnormally High Sensitivity

VFI     100%

MD      +3.72 dB
PSD     1.87 dB