



ID: pex10p


## OS Analisi singola

30-2 centrale Esame di soglia

Monitor fissazione: Sguardo/Blind Spot  
Mira di fissazione: Centrale  
Perdite di fissazione: 1/17  
Errori falsi POS: 1%  
Errori falsi NEG: 0%  
Durata test: 06:24  
Fovea: 36 dB


Stimolo: III, Bianco  
Sfondo: 31,5 asb  
Strategia: SITA Standard  
Diametro pupillare: 3,9 mm \*  
Acuità visiva:  
Rx: +4,75 DS +1,50 DC X 170

Data: 07-gen-2019  
Ora: 10:14  
Età: 69

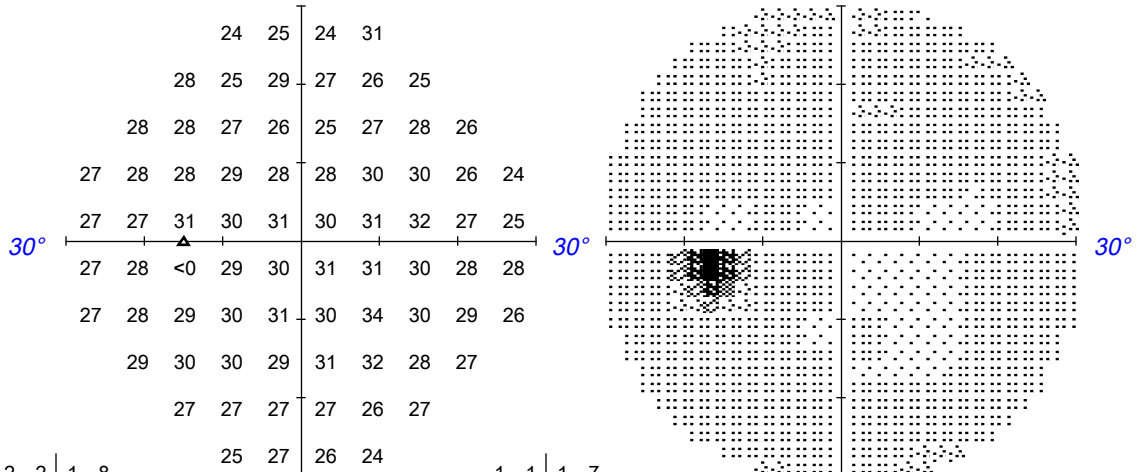


2	2	1	8
3	0	3	1
2	1	-1	-3
0	0	0	-1
0	-2	-1	-1
-1	-1	-2	-2
-1	-1	-1	0
0	0	0	-2
-1	-2	-2	-2
-2	-1	-1	-2

Deviazione totale

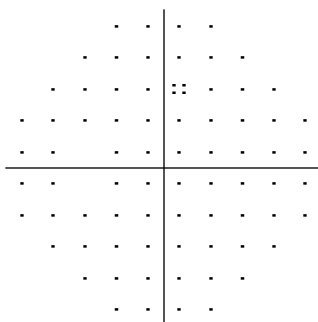

1	1	1	7
3	-1	2	0
1	0	-1	-3
0	0	-1	-2
-1	-3	-1	-1
-1	-2	-3	-3
-2	-1	-1	-1
0	0	-1	-3
-2	-3	-2	-2
-3	-1	-2	-2

Deviazione dal pattern

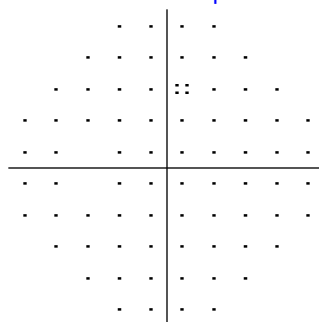

GHT: Entro i limiti normali

VFI: 100%  
MD30-2: -0,60 dB  
PSD30-2: 1,60 dB

:: P < 5%  
■ P < 2%  
■ P < 1%  
■ P < 0.5%



Commenti

