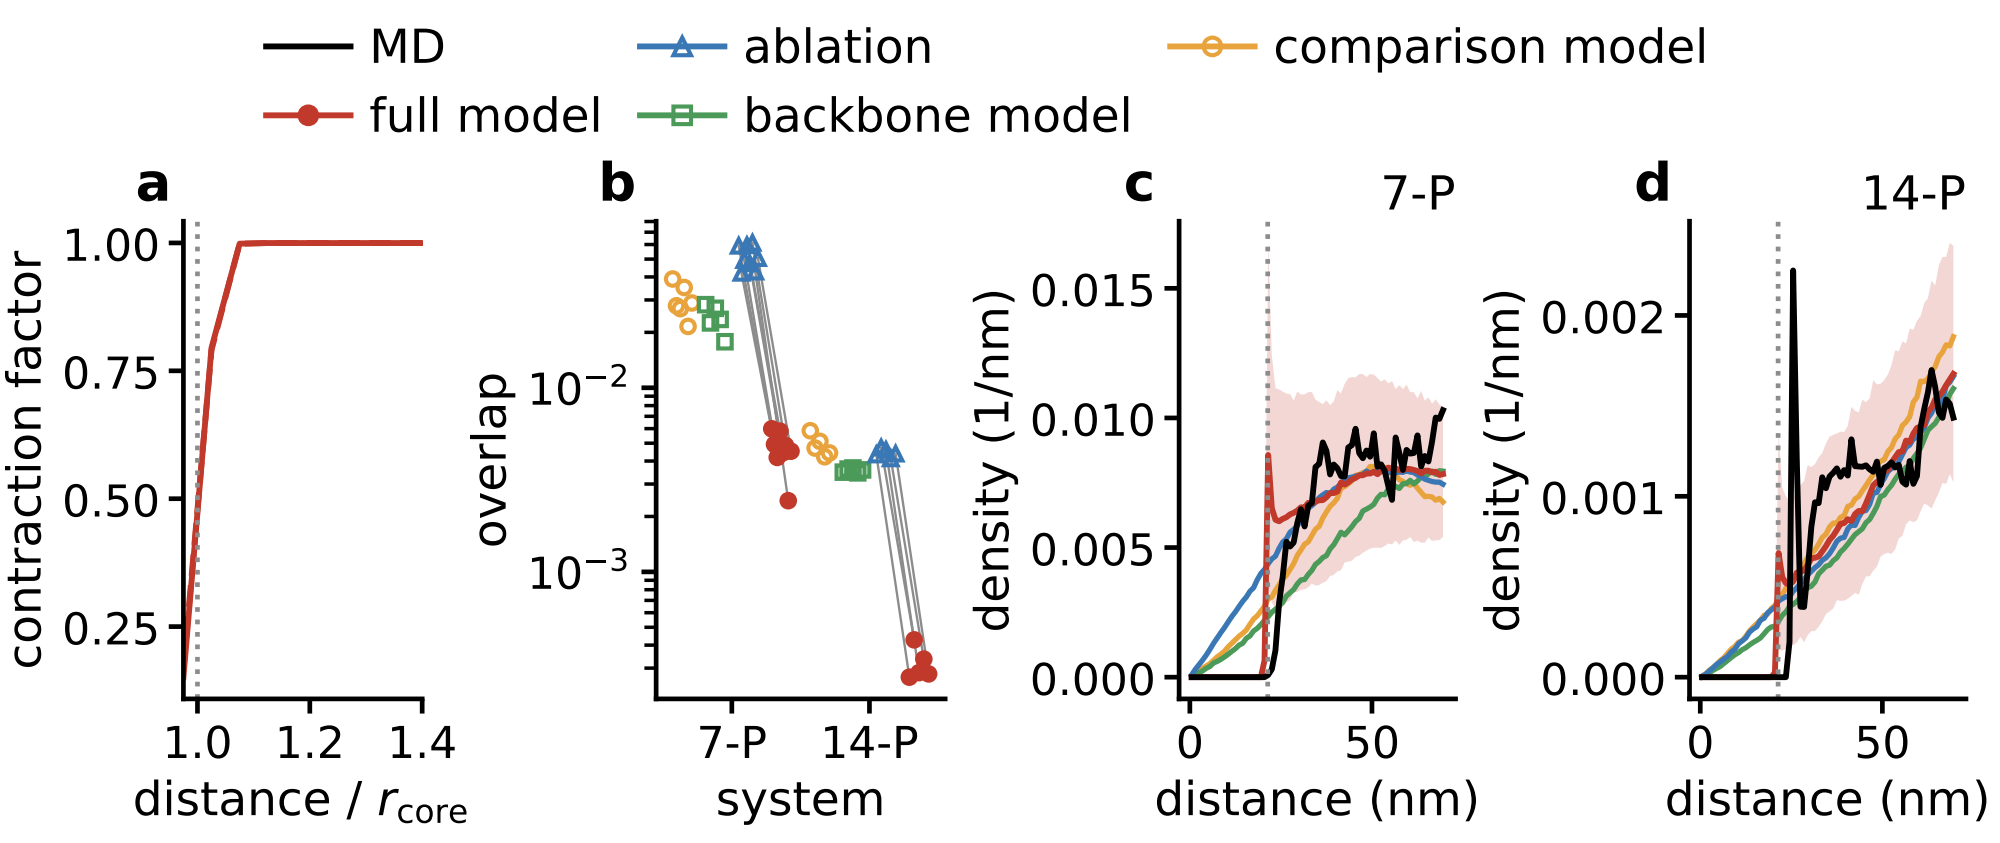
MD
ablation
comparison model
full model
backbone model
a
b
c
7-P
d
14-P
contraction factor
1.00
0.75
0.50
0.25
1.0
1.2
1.4
distance / r_{core}
overlap
10^{-2}
10^{-3}
7-P
14-P
system
density (1/nm)
0.015
0.010
0.005
0.000
0
50
distance (nm)
density (1/nm)
0.002
0.001
0.000
0
50
distance (nm)