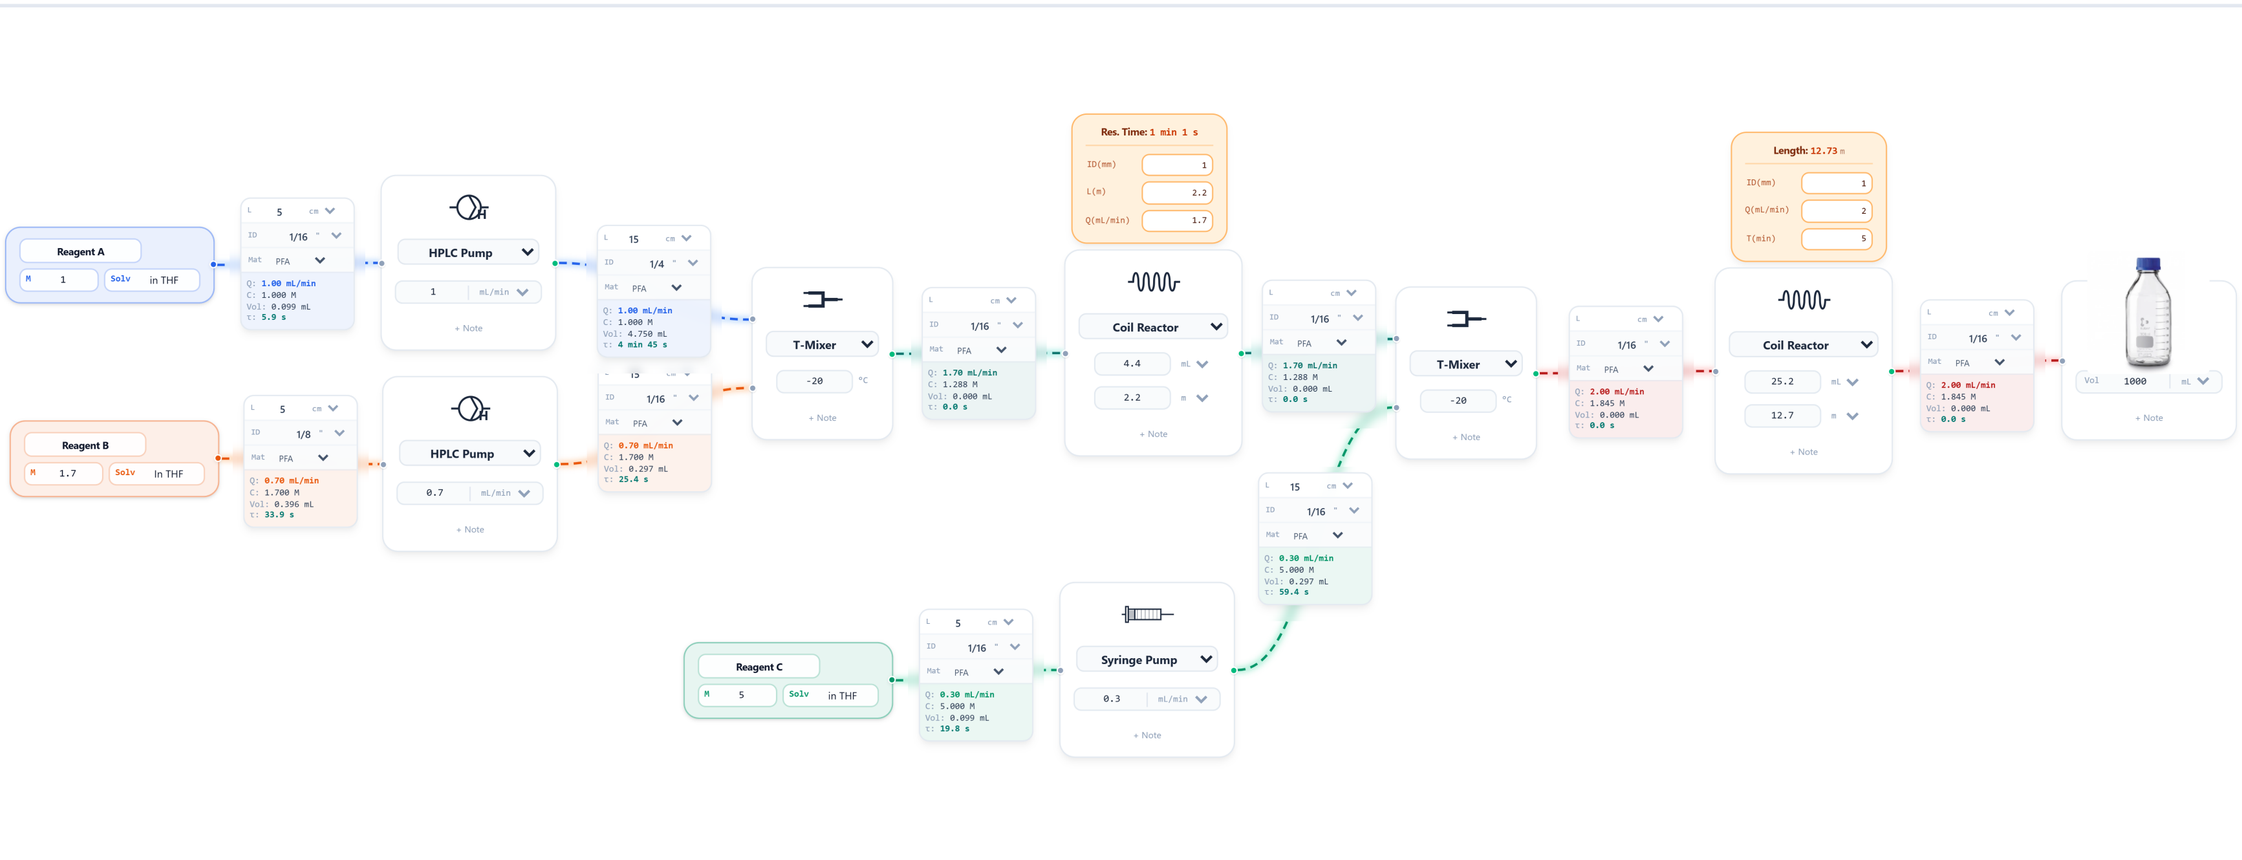

Reagent A
M 1
Solv in THF
Q: 1.00 mL/min
C: 1.000 M
Vol: 0.099 mL
τ: 5.9 s
L 5 cm
ID 1/16 "
Mat PFA
HPLC Pump
1 mL/min
+ Note
L 15 cm
ID 1/4 "
Mat PFA
Q: 1.00 mL/min
C: 1.000 M
Vol: 4.750 mL
τ: 4 min 45 s
T-Mixer
-20 °C
+ Note
L cm
ID 1/16 "
Mat PFA
Q: 1.70 mL/min
C: 1.288 M
Vol: 0.000 mL
τ: 0.0 s
Res. Time: 1 min 1 s
ID(mm) 1
L(m) 2.2
Q(mL/min) 1.7
Coil Reactor
4.4 mL
2.2 m
+ Note
L cm
ID 1/16 "
Mat PFA
Q: 1.70 mL/min
C: 1.288 M
Vol: 0.000 mL
τ: 0.0 s
T-Mixer
-20 °C
+ Note
L cm
ID 1/16 "
Mat PFA
Q: 2.00 mL/min
C: 1.845 M
Vol: 0.000 mL
τ: 0.0 s
Length: 12.73 m
ID(mm) 1
Q(mL/min) 2
T(min) 5
Coil Reactor
25.2 mL
12.7 m
+ Note
L cm
ID 1/16 "
Mat PFA
Q: 2.00 mL/min
C: 1.845 M
Vol: 0.000 mL
τ: 0.0 s
Vol 1000 mL
+ Note
Reagent B
M 1.7
Solv In THF
Q: 0.70 mL/min
C: 1.700 M
Vol: 0.396 mL
τ: 33.9 s
L 5 cm
ID 1/8 "
Mat PFA
HPLC Pump
0.7 mL/min
+ Note
L 15 cm
ID 1/16 "
Mat PFA
Q: 0.70 mL/min
C: 1.700 M
Vol: 0.297 mL
τ: 25.4 s
L 15 cm
ID 1/16 "
Mat PFA
Q: 0.30 mL/min
C: 5.000 M
Vol: 0.297 mL
τ: 59.4 s
Reagent C
M 5
Solv in THF
Q: 0.30 mL/min
C: 5.000 M
Vol: 0.099 mL
τ: 19.8 s
L 5 cm
ID 1/16 "
Mat PFA
Syringe Pump
0.3 mL/min
+ Note