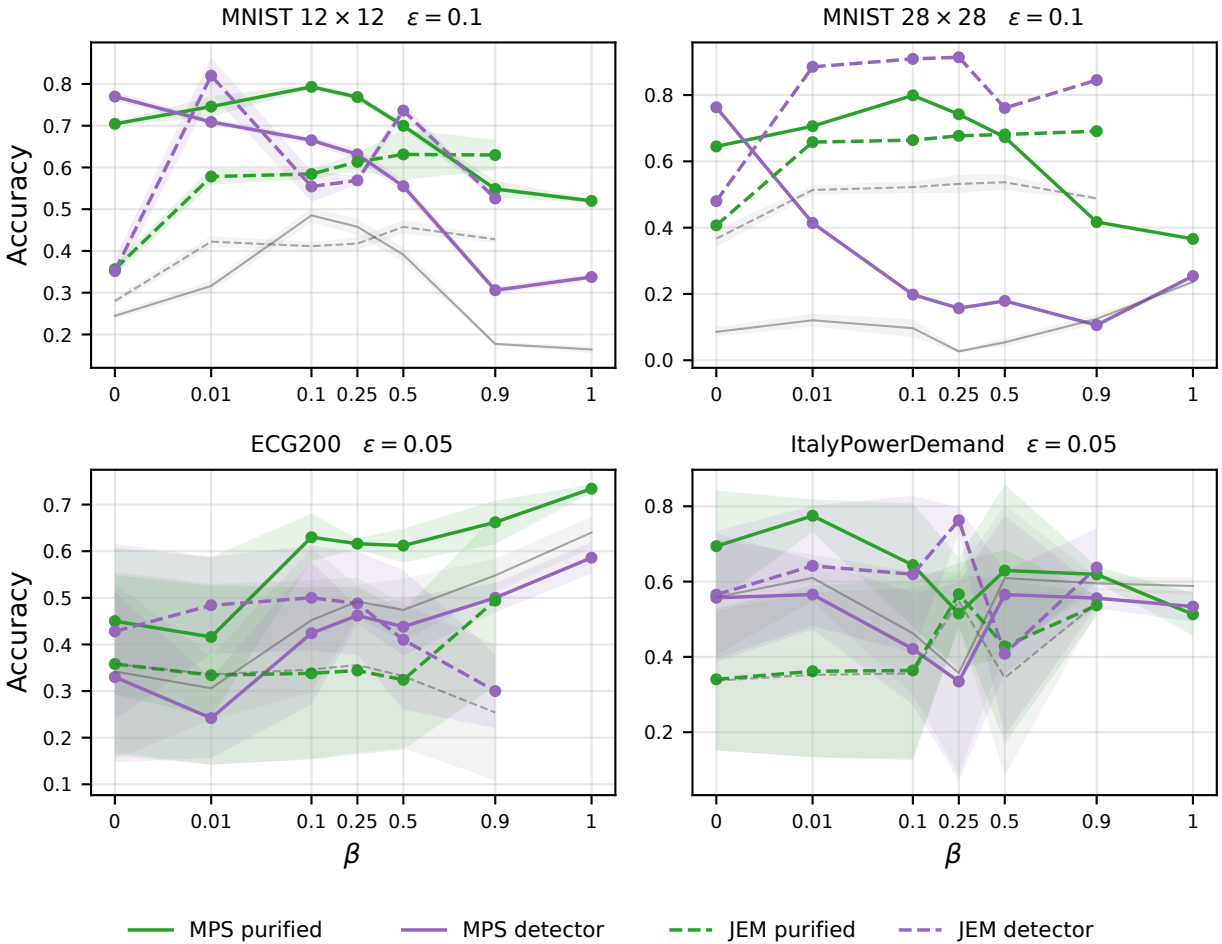
MNIST 12 × 12 ε = 0.1
MNIST 28 × 28 ε = 0.1
ECG200 ε = 0.05
ItalyPowerDemand ε = 0.05
Accuracy
Accuracy
β
β
0
0.01
0.1
0.25
0.5
0.9
1
MPS purified
MPS detector
JEM purified
JEM detector
MPS no defence
JEM no defence