

Batterie schwach



Elektrode



FEHLERBEHEBUNG

pH-Wert auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

Halten Sie beim Einschalten die Tasten HOLD/TEMP und MODE/CAL gleichzeitig gedrückt. Sobald „def“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, lassen Sie alle Tasten los, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Achtung:

1. Das Gerät wurde werkseitig kalibriert und kann direkt verwendet werden.
2. Reinigen Sie die Elektrode nach der Messung mit klarem Wasser und halten Sie sie trocken.
3. Rühren Sie mehrmals vorsichtig um, um sicherzustellen, dass sich keine Luftblasen um die Elektrode bilden.
4. Zerkleinern Sie das Messgerät nicht eigenmächtig, um Schäden zu vermeiden.
5. Halten Sie es trocken. Waschen Sie die Sonde nach der Messung trocken und bewahren Sie sie auf.
6. Falls die pH-Kalibrierung falsch ist, setzen Sie sie bitte zurück.
7. Es ist normal, dass H₂-reicher Wasserstoff, pH-Säure-Basis, Redoxpotential usw. in der Luft fehlerhafte Werte anzeigen. Leitungswasser und Schwimmbadwasser enthalten keinen Wasserstoff, und der Messwert beträgt 0.
8. Während der Messung sollte der Wasserstand die höchste Wasserstandslinie (nicht über der Stifkappe) nicht überschreiten.

Garantie:


Für das Messgerät gilt eine Garantie von drei Jahren ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie deckt den normalen Betrieb ab, nicht jedoch vom Menschen verursachte Schäden. Für Garantiereparaturen ist ein Kaufbeleg erforderlich. Die Garantie erlischt, wenn das Messgerät auseinandergenommen wurde.

Rücksendeberechtigung:

Der Verbraucher sollte den Grund für den Produktmangel beifügen und das defekte Produkt samt Verpackung zurücksenden, um Transportschäden zu vermeiden.


BEDIENUNGSANLEITUNG

STIFTTYP WASSERQUALITÄTS MESSGERÄT

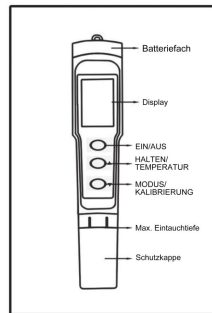

CL201	CL ₂ /TEMP
CL301	CL ₂ /H ₂ /TEMP
CL401	ORP/CL ₂ /H ₂ /TEMP
CL501	pH/ORP/CL ₂ /H ₂ /TEMP

BILDSCHIRMANZEIGE




BEDIENUNG

HALTEN/TEMPERATURVERSCHIEBUNG



Modus-Wechsel

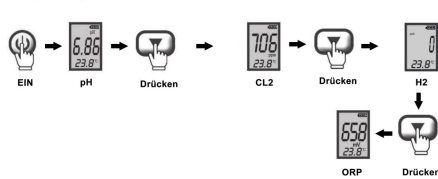


TASTE




Halten Sie die HOLD/TEMP-Taste fünf Sekunden lang gedrückt. Anzeige kann zwischen Fahrenheit und Celsius umgerechnet werden.

pH-KALIBRIERUNG

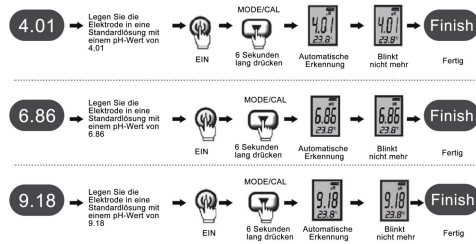

ORP-Kalibrierung



PARAMETER

ARTIKEL	CL201	CL301	CL401	CL501
pH	Messbereich	0~14.00pH		
	Auflösung	0.01 pH		
	Genauigkeit	± 0.01 pH		
	Temperatur kompensation	(0~60) °C (Auto)		
ORP	Messbereich	± 1999 mV		
	Auflösung	1 mV		
	Genauigkeit	± 2mV		
(CL ₂)	Messbereich	0.01~4.00ppm (Chlore résiduel total)		
	Auflösung	0.01ppm		
	Genauigkeit	± 10% reading Value, ± 0.01ppm		
	Temperatur kompensation	(0~60) °C (Auto)		
(H ₂)	Messbereich	0-10000ppb (0.001-10.000ppb)		
	Auflösung	2PPb (0.002ppb)		
	Genauigkeit	± 10ppb (±0.01ppb)		
	Temperatur kompensation	(0~60) °C (Auto)		
(TEMP)	Messbereich	0-60°C		
	Auflösung	0.1°C		
	Genauigkeit	±0.1°C		
Wasserdichtigkeit	IP65		Stromzelle	3*1.5V (LR44)
Arbeitsumgebung	0-60°C (30.0-140.0°F) RH: 100%		Bildschirmgröße	28*20mm
Hintergrundbeleuchtung	LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung		Anzeigemodus	Flüssigkristall-Digitalanzeige
Automatische Abschaltung	Fünf Minuten		Achtung	Die Elektroden müssen nach Gebrauch gereinigt werden