

BATTERIA SCARICA



ELETTRODO



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Ripristino delle impostazioni di fabbrica del pH:
Addivio, TENERE PREMUTI contemporaneamente il tasto HOLD/TEMP e il tasto MODE/CAL. Quando sullo schermo viene visualizzato il messaggio del, rilasciare tutti i tasti per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Attenzione:

1. È stato calibrato in fabbrica, utilizzarlo direttamente.
2. Al termine, pulire l'elettrodo con acqua pura e mantenerlo asciutto.
3. Mescolare delicatamente più volte per assicurarsi che non si formino bolle d'aria intorno all'elettrodo.
4. Non smontare il misuratore senza autorizzazione per evitare danni.
5. Mantenerlo asciutto. Dopo la misurazione, asciugare la sonda e riportarla.
6. Se la calibrazione del pH è errata, reimpostarla.
7. È normale che l'idrogeno ricco di H₂, il pH acido-base, il potenziale ORP negativo, ecc. mostri valori disordinati nell'aria. L'acqua del rubinetto e l'acqua della piscina non contengono idrogeno e il valore misurato è 0.
8. Durante la misurazione, il livello dell'acqua non deve superare la linea di livello più alto (non sopra il tappo della penna).


Garanzia:

Il contatore è garantito esente da difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di tre anni dalla data di acquisto. La garanzia copre il normale funzionamento ma non copre i danni causati dall'utente. Per la riparazione in garanzia è richiesta la prova d'acquisto. La garanzia decade se il contatore è stato smontato.

Autorizzazione al reso:


Il consumatore è tenuto a fornire la causa del difetto e a restituire il prodotto difettoso e l'imballaggio per evitare danni durante il trasporto.

MANUALE D'USO
TIPO A PENNA
MISURATORE DI QUALITÀ
DELL'ACQUA
CONTAMINATORE

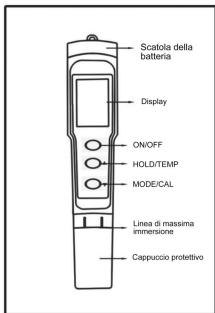


CL201	CL ₂ /TEMP
CL301	CL ₂ /H ₂ /TEMP
CL401	ORP/CL ₂ /H ₂ /TEMP
CL501	pH/ORP/CL ₂ /H ₂ /TEMP

DISPLAY SCHERMO




PULSANTE




FUNZIONAMENTO

HOLD/TEMP SHIFT



CAMBIO DI MODELLO

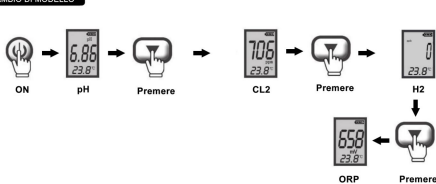


Premere a lungo e tenere premuto il tasto HOLD/TEMP per cinque secondi. Può convertire la visualizzazione in gradi Fahrenheit e Celsius.

PARAMETRO

ARTICOLO	CL201	CL301	CL401	CL501
pH	Campo di misura	0~14.00pH		
	Risoluzione	0.01 pH		
	Precisione	± 0.01 pH		
	Compensazione della temperatura	(0~60) °C (Auto)		
ORP	Campo di misura	± 1999 mV		
	Risoluzione	1 mV		
	Risoluzione	± 2mV		
(CL ₂)	Campo di misura	0.01~4.00ppm (Cloro residuo totale)		
	Risoluzione	0.01ppm		
	Precisione	± 10% reading Value, ± 0.01ppm		
	Compensazione della temperatura	(0~60) °C (Auto)		
(H ₂)	Campo di misura	0-10000ppb (0.001-10.000ppb)		
	Risoluzione	2PPb (0.002ppb)		
	Precisione	± 10ppb (±0.01ppb)		
	Compensazione della temperatura	(0~60) °C (Auto)		
(TEMP)	Campo di misura	0-60°C		
	Risoluzione	0.1°C		
	Precisione	±0.1°C		
Classe di impermeabilità	IP65		Cella elettrica	3*1.5V (LR44)
Ambiente di lavoro	0-60°C (30.0-140.0°F) RH: 100%		Dimensioni dello schermo	28*20mm
Retroilluminazione	Schermo LCD retroilluminato		Modalità di visualizzazione	Display digitale a cristalli liquidi
Spegnimento automatico	Cinque minuti		Attenzione	Già elettrodi devono essere puliti dopo l'uso

CALIBRAZIONE DEL pH

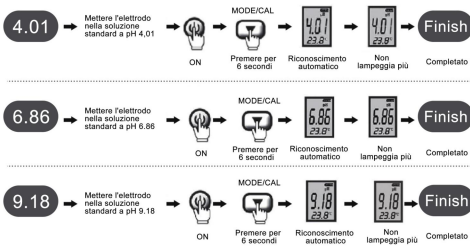

ORP

