



PILE FAIBLE



ÉLECTRODE



DÉPANNAGE

Rétablissement des paramètres d'usine du pH :

Au démarrage, maintenir simultanément les touches HOLD/TEMP et MODE/CAL enfoncées. Lorsque « del » s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches pour rétablir les paramètres d'usine.

- Attention :
1. Cet appareil a été calibré en usine, utilisez-le directement.
 2. Une fois terminé, nettoyez l'électrode à l'eau pure et gardez-la au sec.
 3. Remuez délicatement plusieurs fois pour éviter toute bulle d'air autour de l'électrode.
 4. Ne démontez pas l'appareil sans autorisation pour éviter tout dommage.
 5. Gardez-le au sec. Après la mesure, essuyez la sonde et rangez-la.
 6. Si l'étalonnage du pH est incorrect, veuillez le réinitialiser.
 7. Il est normal que l'hydrogène riche en H₂, le pH acide-base, le potentiel ORP négatif, etc. affichent des valeurs décalées dans l'air. L'eau du robinet et l'eau de piscine ne contiennent pas d'hydrogène et la valeur mesurée est de 0.
 8. Lors de la mesure, le niveau d'eau ne doit pas dépasser le repère de niveau le plus élevé (pas au-dessus du capuchon du stylo).

Garantie :

Le compteur est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat. La garantie couvre le fonctionnement normal, mais ne couvre pas les dommages causés par l'homme. Une preuve d'achat est requise pour les réparations sous garantie. La garantie est annulée si le compteur a été démonté.

Autorisation de retour :


Le consommateur doit indiquer la raison du produit défectueux et retourner le produit défectueux ainsi que son emballage afin d'éviter tout dommage pendant le transport.

MANUEL D'UTILISATION

TYPE DE STYLO


QUALITÉ DE L'EAU

APPAREIL DE MESURE

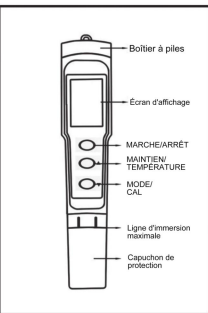


CL201	CL ₂ /TEMP
CL301	CL ₂ /H ₂ /TEMP
CL401	ORP/CL ₂ /H ₂ /TEMP
CL501	pH/ORP/CL ₂ /H ₂ /TEMP

AFFICHAGE À L'ÉCRAN




FONCTIONNEMENT


MAINTIEN/CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE



CHANGEMENT DE MODELE



BOUTON




Appuyez longuement sur la touche HOLD/TEMP pendant cinq secondes. Permet de convertir l'affichage en degrés Fahrenheit et Celsius.

PARAMÈTRE

ARTICLE	CL201	CL301	CL401	CL501
pH	Plage de mesure	0~14.00pH		
	Résolution	0.01 pH		
	Précision	± 0.01 pH		
	Compensation de température	(0~60) °C (Auto)		
ORP	Plage de mesure	± 1999 mV		
	Résolution	1 mV		
	Précision	± 2mV		
(CL ₂)	Plage de mesure	0.01~4.00ppm (Chlore résiduel total)		
	Résolution	0.01ppm		
	Précision	± 10% reading Value, ± 0.01ppm		
	Compensation de température	(0~60) °C (Auto)		
(H ₂)	Plage de mesure	0-10000ppb (0.001-10.000ppb)		
	Résolution	2PPb (0.002ppb)		
	Précision	± 10ppb (±0.01ppb)		
	Compensation de température	(0~60) °C (Auto)		
(TEMP)	Plage de mesure	0-60°C		
	Résolution	0.1°C		
	Précision	±0.1°C		
Indice d'étanchéité	IP65		Pile électrique	3*1.5V (LR44)
Environnement de travail	0-60°C (30.0-140.0°F) RH: 100%		Taille de l'écran	28*20mm
Rétroéclairage	Écran LCD rétroéclairé		Mode d'affichage	Écran numérique à cristaux liquides
Arrêt automatique	Cinq minutes		Attention	Les électrodes doivent être nettoyées après utilisation

ÉTALONNAGE DU pH

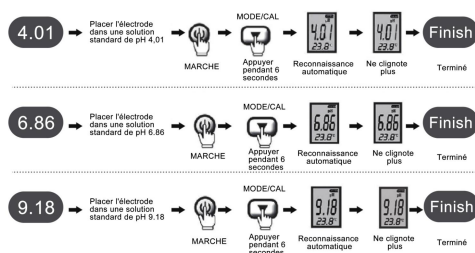

Étalonnage du potentiel redox

