


## BATERÍA BAJA



## ELECTRODO



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Restaurar la configuración de fábrica del pH:

Al iniciar el equipo, mantenga presionadas las teclas **HOLD/TEMP** y **MODE/CAL** simultáneamente. Cuando aparezca "000" en la pantalla, suelte todas las teclas para restaurar la configuración de fábrica.

#### Atención:

1. Calibrado de fábrica, ósele directamente.
2. Una vez finalizado, limpie el electrodo con agua pura y manténgalo seco.
3. Remueva suavemente varias veces para asegurar que no queden burbujas de aire alrededor del electrodo.
4. No desmonte el medidor sin autorización para evitar daños.
5. Manténgalo seco. Después de la medición, seque la sonda y guárdela.
6. Si la calibración del pH es incorrecta, reiniciela.
7. Es normal que el hidrógeno rico en  $H_2O_2$ , el pH ácido-base, el potencial ORP negativo, etc., muestren valores irregulares en el aire. El agua del grifo y el agua de la piscina no contienen hidrógeno, y el valor medido es 0.
8. Al medir, el nivel del agua no debe superar la línea de nivel más alto (no por encima de la tapa del bote).

#### Garantía:


El medidor está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante tres años a partir de la fecha de compra. La garantía cubre el funcionamiento normal, pero no cubre daños causados por el hombre. Se requiere comprobante de compra para reparaciones cubiertas por la garantía. La garantía queda anulada si el medidor ha sido desarmado.

#### Autorización de devolución:

El consumidor debe justificar el motivo del producto defectuoso y devolver el producto defectuoso junto con el embalaje para evitar daños durante el transporte.


## MANUAL DE OPERACIÓN

### TIPO DE PLUMA CALIDAD DEL AGUA MEDIDOR

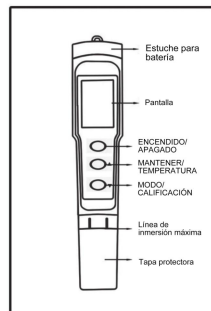

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| CL201 | CL <sub>2</sub> /TEMP                        |
| CL301 | CL <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> /TEMP        |
| CL401 | ORP/CL <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> /TEMP    |
| CL501 | pH/ORP/CL <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> /TEMP |

## CALIBRACIÓN DE pH

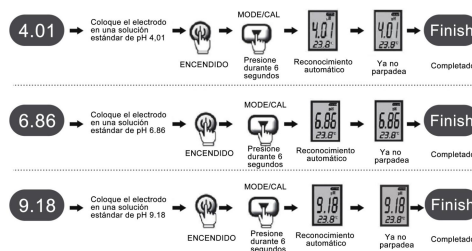


## ORP




## PARÁMETRO

| ARTÍCULO            | CL201                          | CL301                               | CL401                 | CL501                                            |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| pH                  | Rango de medición              | 0~14.00pH                           |                       |                                                  |
|                     | Resolución                     | 0.01 pH                             |                       |                                                  |
|                     | Precisión                      | ± 0.01 pH                           |                       |                                                  |
|                     | Compensación de temperatura    | (0~60) °C (Auto)                    |                       |                                                  |
| ORP                 | Rango de medición              | ± 1999 mV                           |                       |                                                  |
|                     | Resolución                     | 1 mV                                |                       |                                                  |
|                     | Precisión                      | ± 2mV                               |                       |                                                  |
| (CL <sub>2</sub> )  | Rango de medición              | 0.01~4.00ppm (Cloro residual total) |                       |                                                  |
|                     | Resolución                     | 0.01ppm                             |                       |                                                  |
|                     | Precisión                      | ± 10% reading Value, ± 0.01ppm      |                       |                                                  |
|                     | Compensación de temperatura    | (0~60) °C (Auto)                    |                       |                                                  |
| (H <sub>2</sub> )   | Rango de medición              | 0-10000ppb (0.001-10.000ppb)        |                       |                                                  |
|                     | Resolución                     | 2PPb (0.002ppb)                     |                       |                                                  |
|                     | Precisión                      | ± 10ppb (±0.01ppb)                  |                       |                                                  |
|                     | Compensación de temperatura    | (0~60) °C (Auto)                    |                       |                                                  |
| (TEMP)              | Rango de medición              | 0-60°C                              |                       |                                                  |
|                     | Resolución                     | 0.1°C                               |                       |                                                  |
|                     | Precisión                      | ±0.1°C                              |                       |                                                  |
| Resistencia al agua | IP65                           |                                     | Celda eléctrica       | 3*1.5V (LR44)                                    |
| Entorno de trabajo  | 0-60°C (30.0-140.0°F) RH: 100% |                                     | Tamaño de pantalla    | 28*20mm                                          |
| Retroiluminación    | Pantalla LCD retroiluminada    |                                     | Modo de visualización | Pantalla digital de cristal líquido.             |
| Apagado automático  | Cinco minutos                  |                                     | Cuidado               | Los electrodos deben limpiarse después de su uso |

### PANTALLA




### BOTÓN



Mantenga presionada la tecla HOLD/TEMP durante cinco segundos. Puede convertir la visualización de grados Fahrenheit a Celsius.

### OPERACIÓN

#### MANTENER/CAMBIO DE TEMPERATURA



#### CAMBIO DE MODE

