


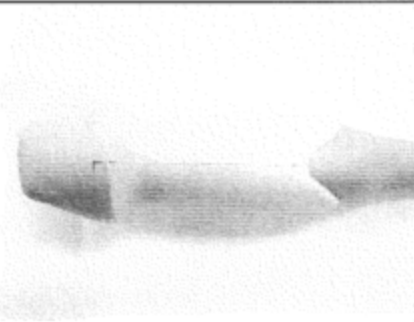

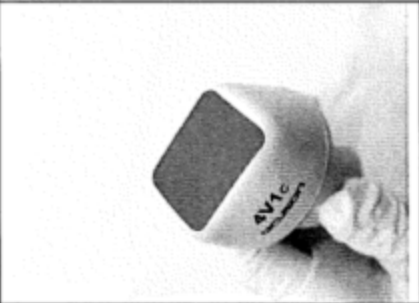
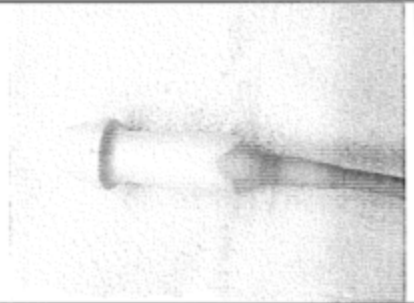
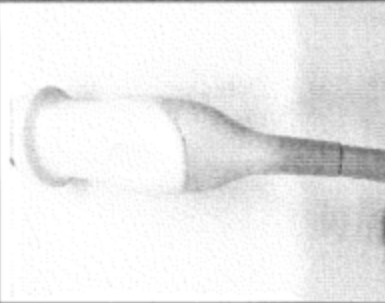
西门子

Healthineers



XDCR 名称	XDCR S/N	部分	浸泡前	浸泡后	差异（之前之后）	后果
Z6Ms	83534016	抗电强度	4.49毫安	4.5毫安	-	通过
		泄漏试验	276.431 uA	274.966 uA	-	通过
		体贴 Stdevat 3MHz	0.17伏/伏	0.18伏	0.496471675分贝	通过
		体贴 Stdevat 5MHz	0.15伏/伏	0.16伏/伏	0.560574472分贝	通过
		体贴 Stdevat 6MHz	0.11伏/伏	0.12伏/伏	0.755771218分贝	通过
		TOF	8.6纳秒	8.2纳秒	0.4纳秒	通过
		死去的 要素	6.	40	34	失败
		外观检查	无缺陷	无缺陷	-	通过
		最终决定		失败		

外观检查

XDCR	测验	透镜	鼻罩和外壳	应力消除和电缆
4V1c	之前			
	之后			
后果		无缺陷		