
INDIKERINGSPROTOKOLL WORKS TEST CERTIFICATE

3971


Tests according to the limits of error as laid down by DR. G. SCHLESINGER.

Indikeringen motsvarar värden angivna av DR. G. SCHLESINGER.




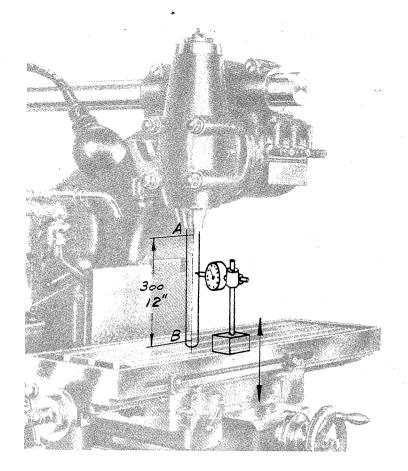


No	М. М.		INCH	
1	Tillåtet värde	Indikerat värde	Permitted error	Tested error
Α	0.00	0.00	0.000	0.000
В	0.02		0.0008	0.000

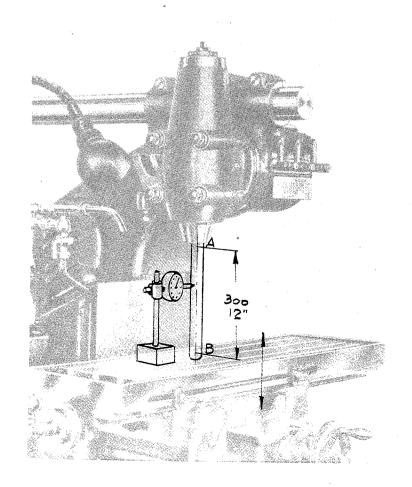


No	М. М.		INCH		
2	Tillåtet värde	Indikerat värde	Permitted error	Tested error	
Α	0.00	0.00	0.000	0.000	
В	0.02		0.0008	0,00	Ø,

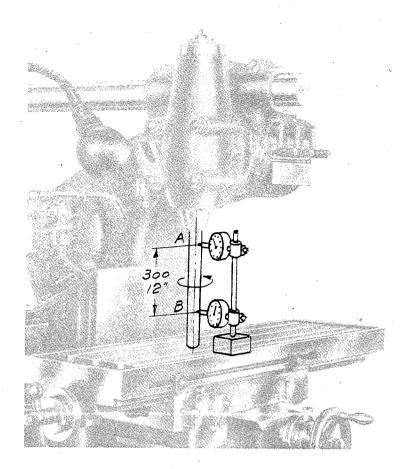


No	М. М.		INCH		
3	Tillåtet värde	Indikerat värde	Permitted error	Tested error	
Α	0.01		0.0004	0.000	
В	0.02		0.0008	0.000	7

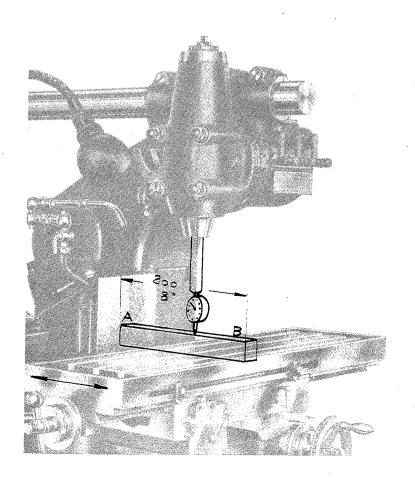

No	M. M.		INCH		
4	Tillåtet värde	Indikerat värde	Permitted error	Tested error	
Α	0.00	0.00	0.000	0.000	
В	0.01		0.0004	1.000	ن

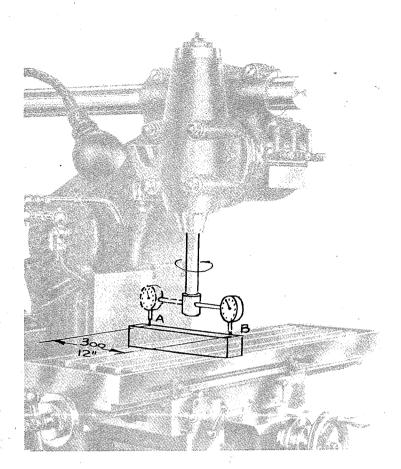

No	М	. M.	INC	H	
5	Tillåtet värde	Indikerat värde	Permitted error	Tested error	
Α	0.00	0.00	0.000	0.000	
В	0.02		0.0008	Dom	2

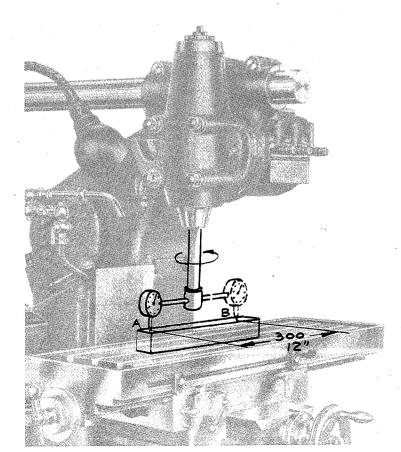


No	М	. M.	INC	:H
6	Tillåtet värde	Indikerat värde	Permitted error	Tested error
Α	0.00	0.00	0.000	0.000
В	0.02		0.0008	0,00

ested error 0.000


0,000

ested error


200

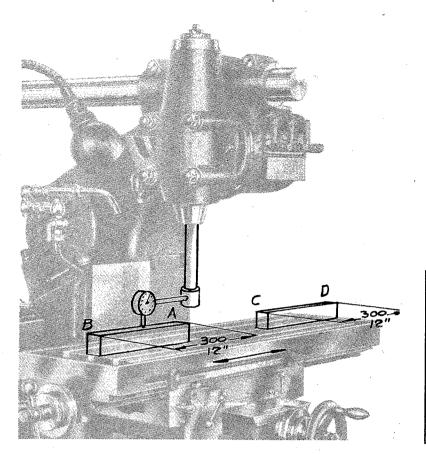


No	M. M.		INCH	
7	Tillåtet värde	Indikerat värde	Permitted error	Tested error
Α	0.00	0.00	0.000	0.000
В	0.02		0.0008	1,000
С	0.00	0.00	0.000	0.000
D	0.02		0.0008	0,000

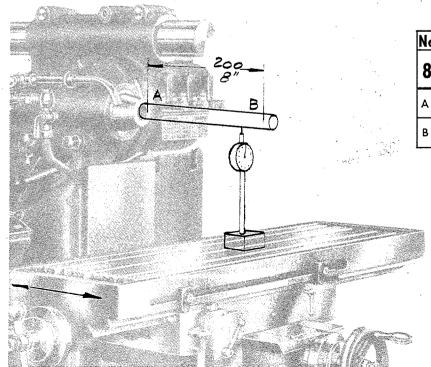

No	M. M.		INC	Н
8	Tillåtet värde	lndikerat värde	Permitted error	Tested error
Α	0.00	0.00	0.000	0.000
В	0.01		0.0004	1,000

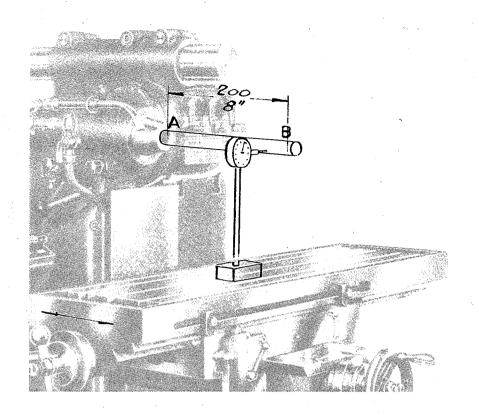

No	М. М.		INC		
9	Tillåtet värde	lndikerat värde	Permitted error	Tested error	
Α	0.00	0.00	0.000	0.000	
В	0.01		0.0004	0,00	13

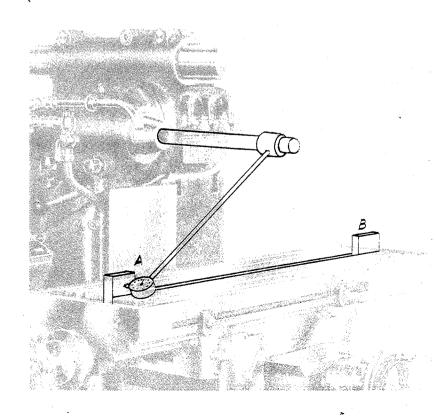

No	M. M.		INCH		
10	Tillåtet värde	Indikerat värde	Permitted error	Tested error	
Α	0.00	0.00	0.000	0.000	
В	0.05		0.002	0.00	