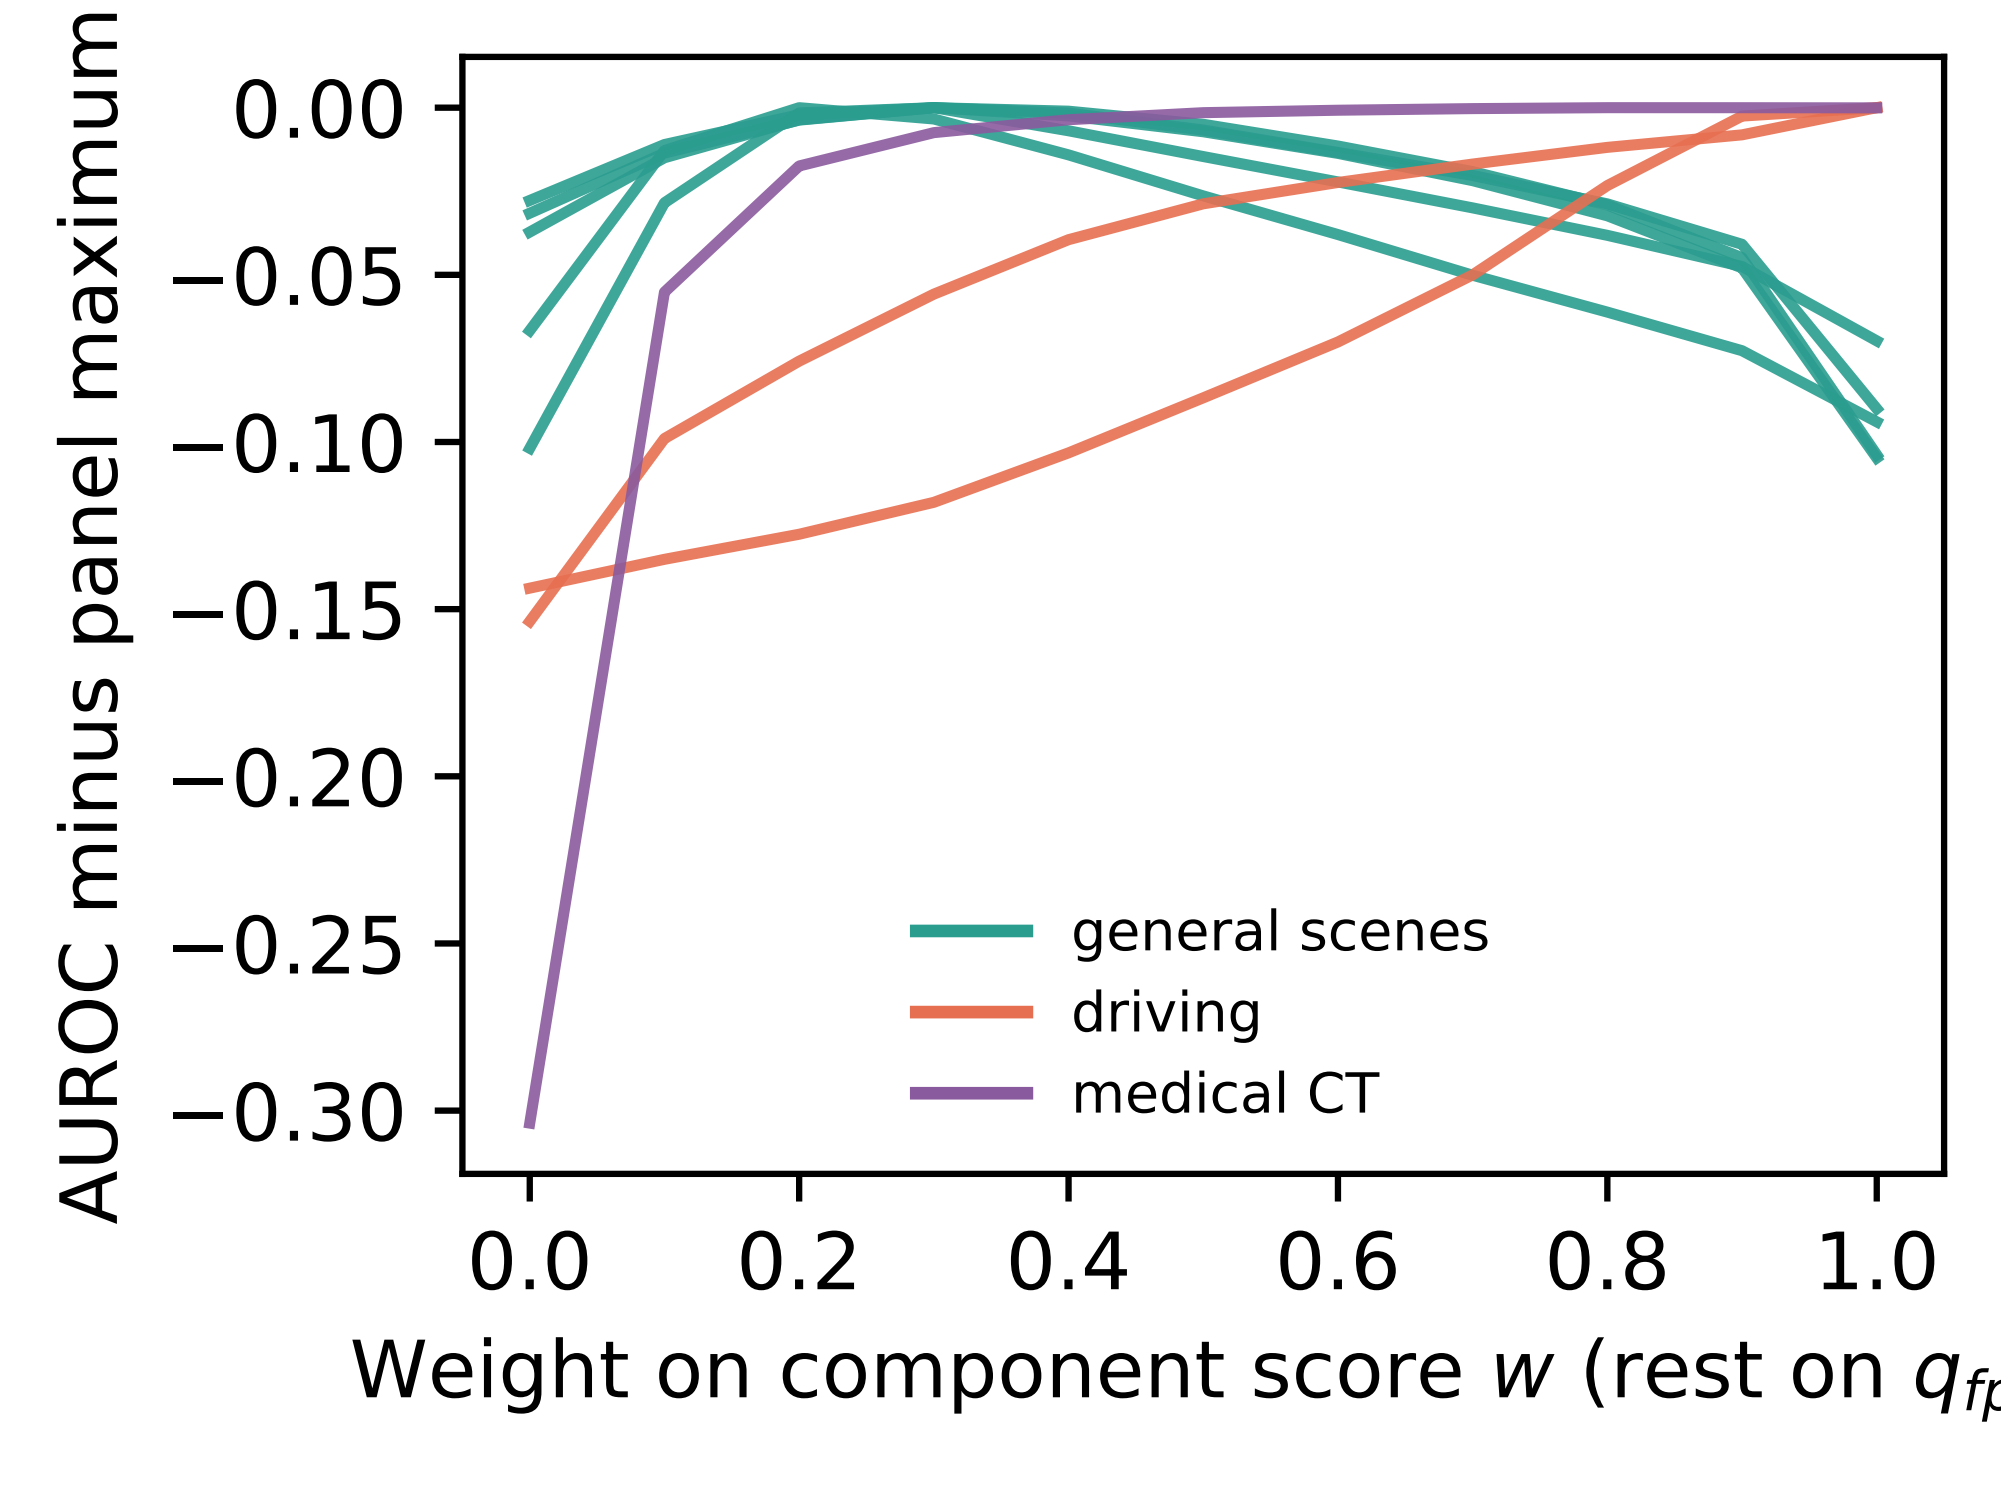
AUROC minus panel maximum
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20
−0.25
−0.30
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Weight on component score w (rest on q_{fp}
general scenes
driving
medical CT