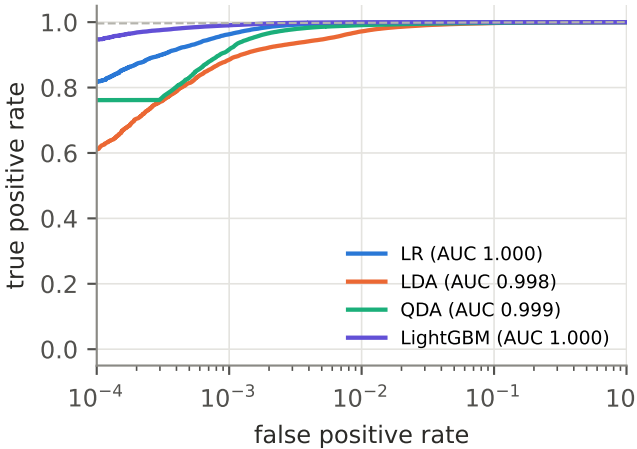
true positive rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
false positive rate
LR (AUC 1.000)
LDA (AUC 0.998)
QDA (AUC 0.999)
LightGBM (AUC 1.000)

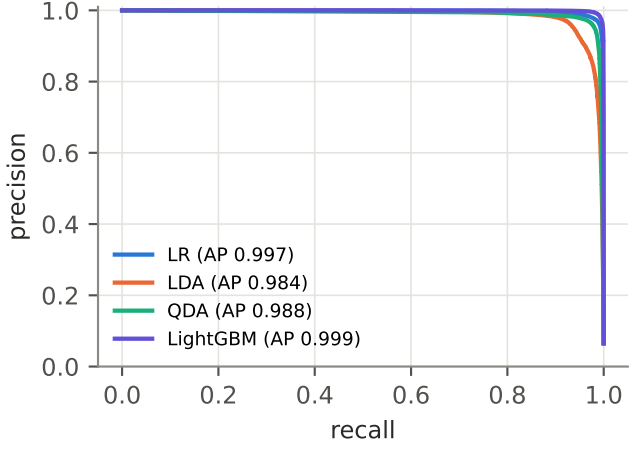
precision
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
recall
LR (AP 0.997)
LDA (AP 0.984)
QDA (AP 0.988)
LightGBM (AP 0.999)