



Estado de la telemetría: Activado
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
Estado del registrador: Desactivado
Estado del registrador: Activado
Modo Toco: externo

Modo FCF1: no transductor


Modo FCF2: US

Modo Toco: no transductor
Modo Toco : externo



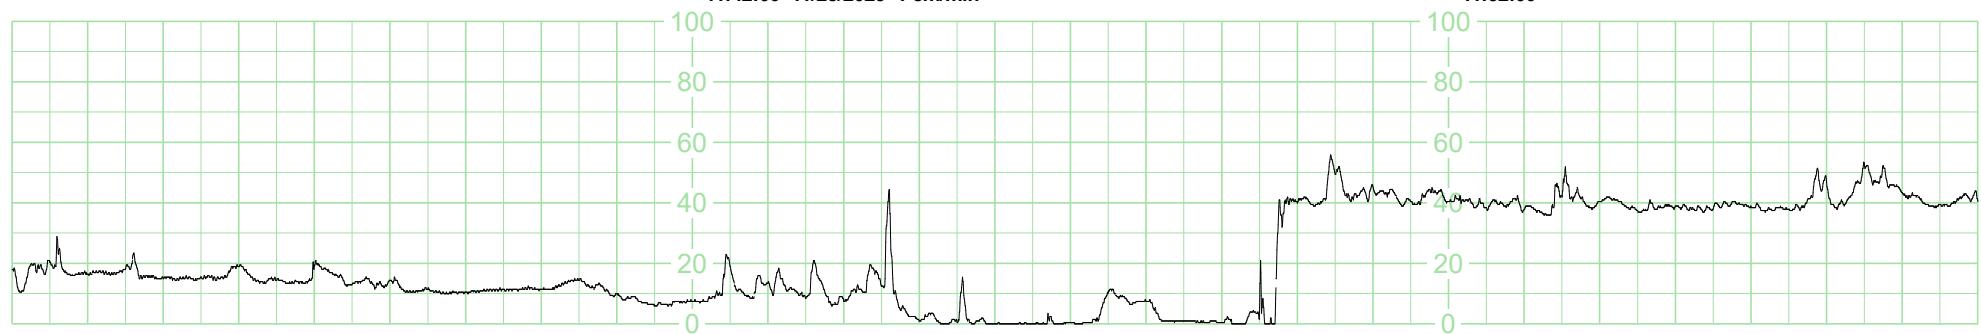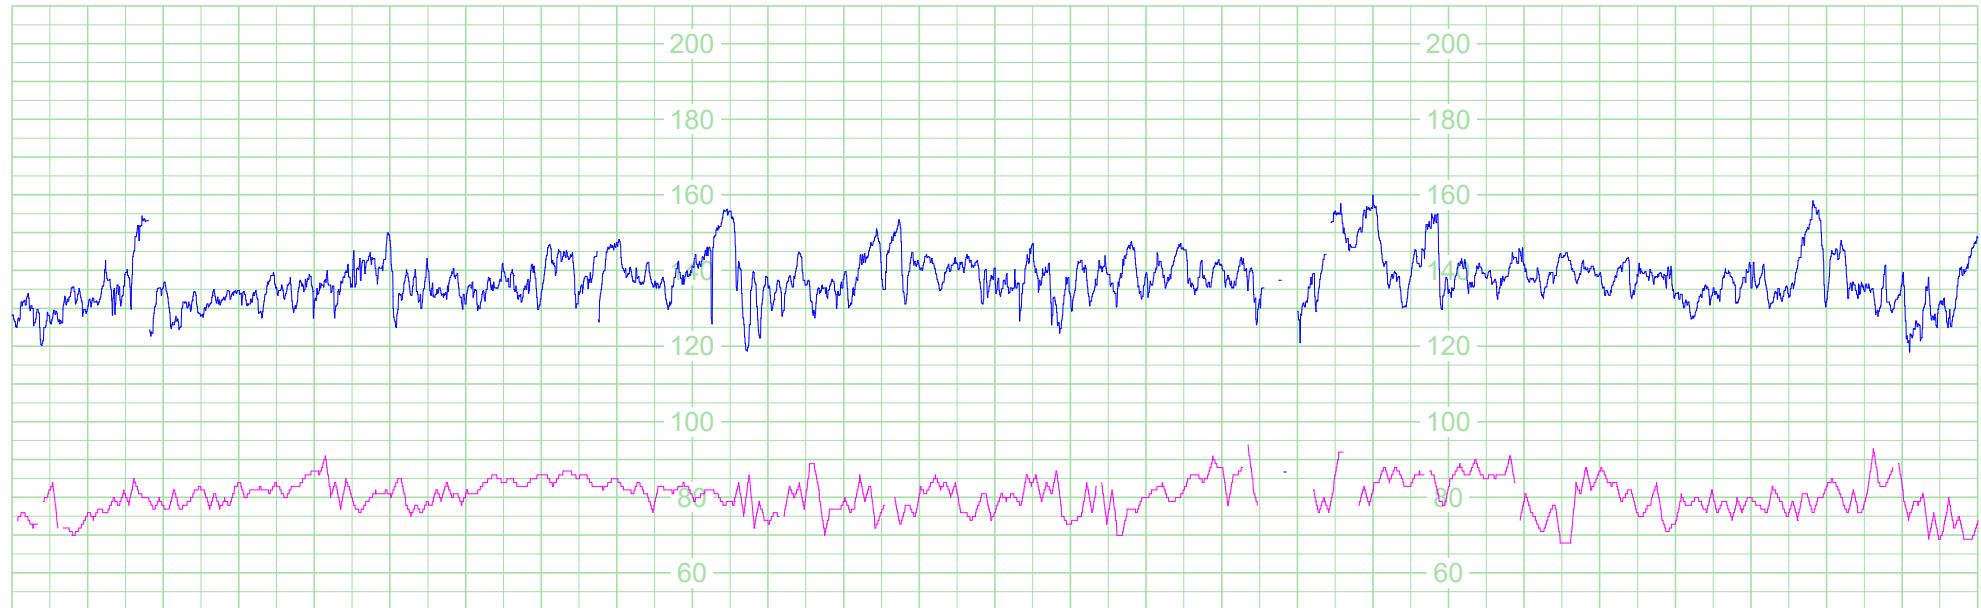




Estado del monitor: En espera
Modo FCF2: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del registrador: Desactivado
Estado de la telemetría: Desactivado

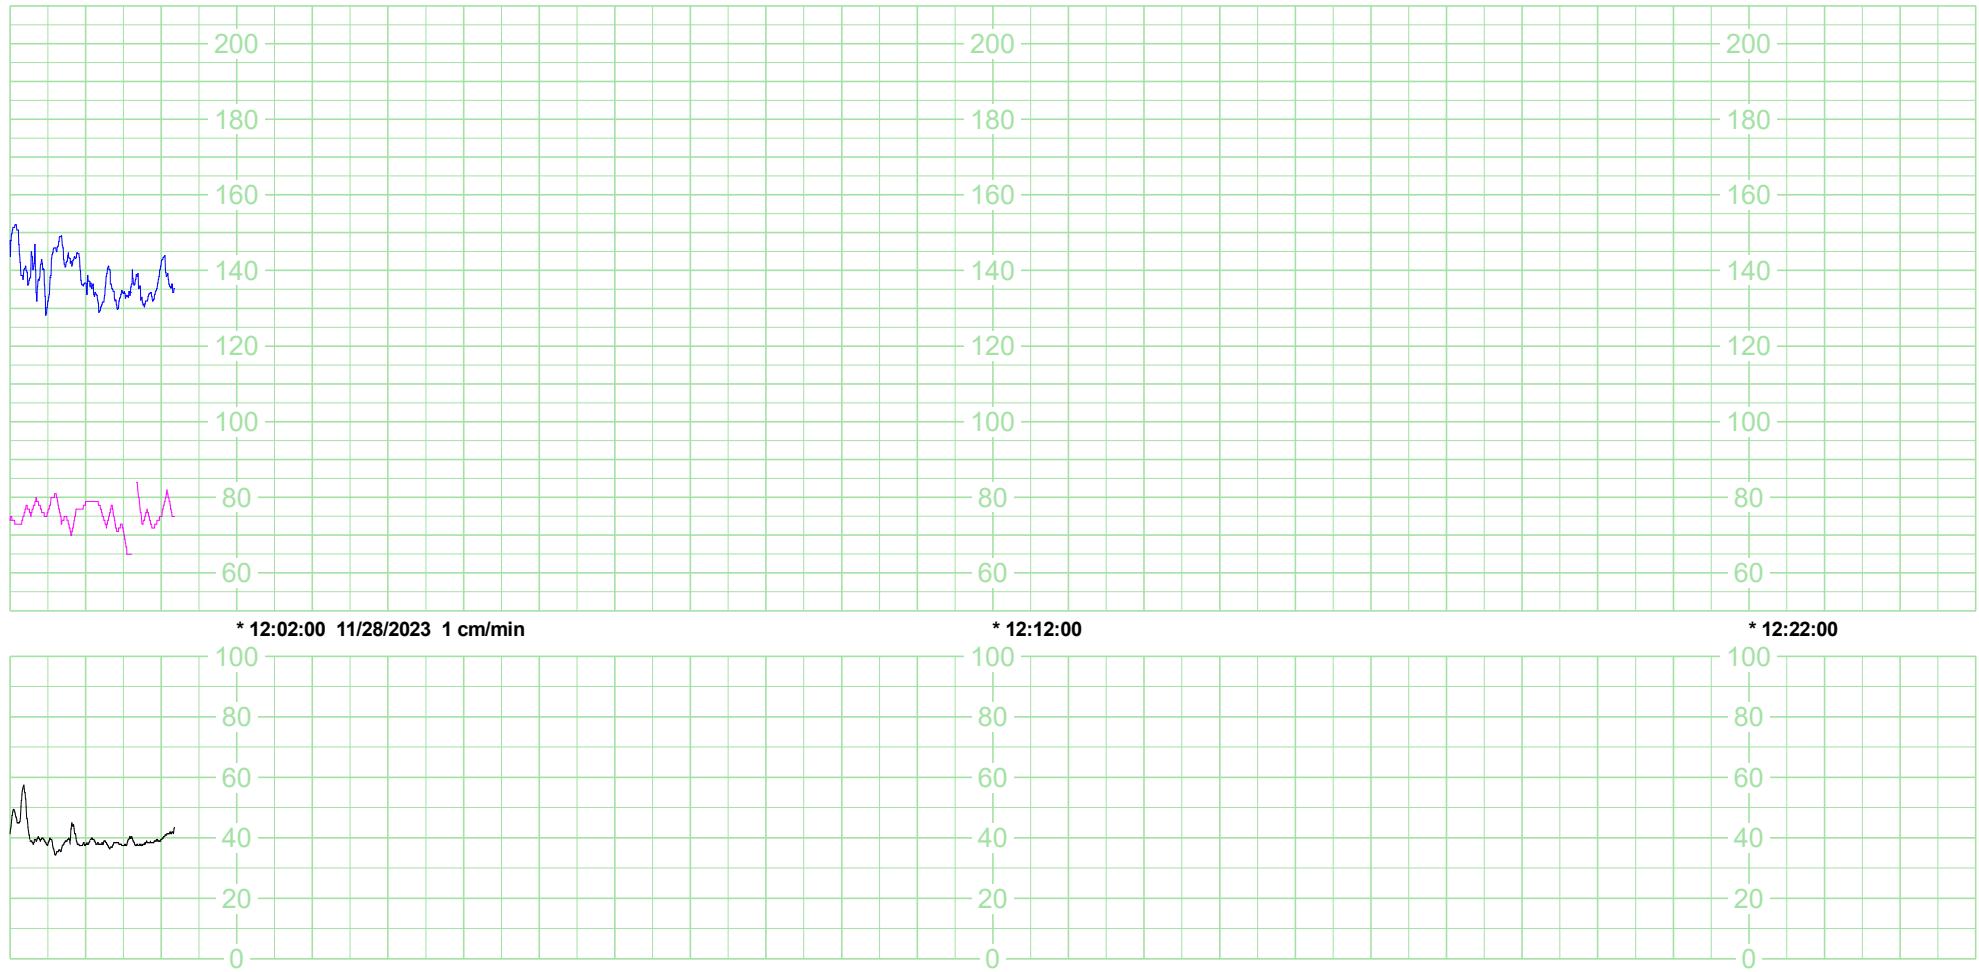



Estado de la telemetría: Activado
Estado del monitor: Activado
Estado del registrador: Activado
Estado de la telemetría: Desactivado
Estado de la telemetría: Activado
Modo FCF: US
Estado del FMP: Activado
Modo Toco: externo


** FCF1: BRADICARDIA
— Alarma con acuse de recibo

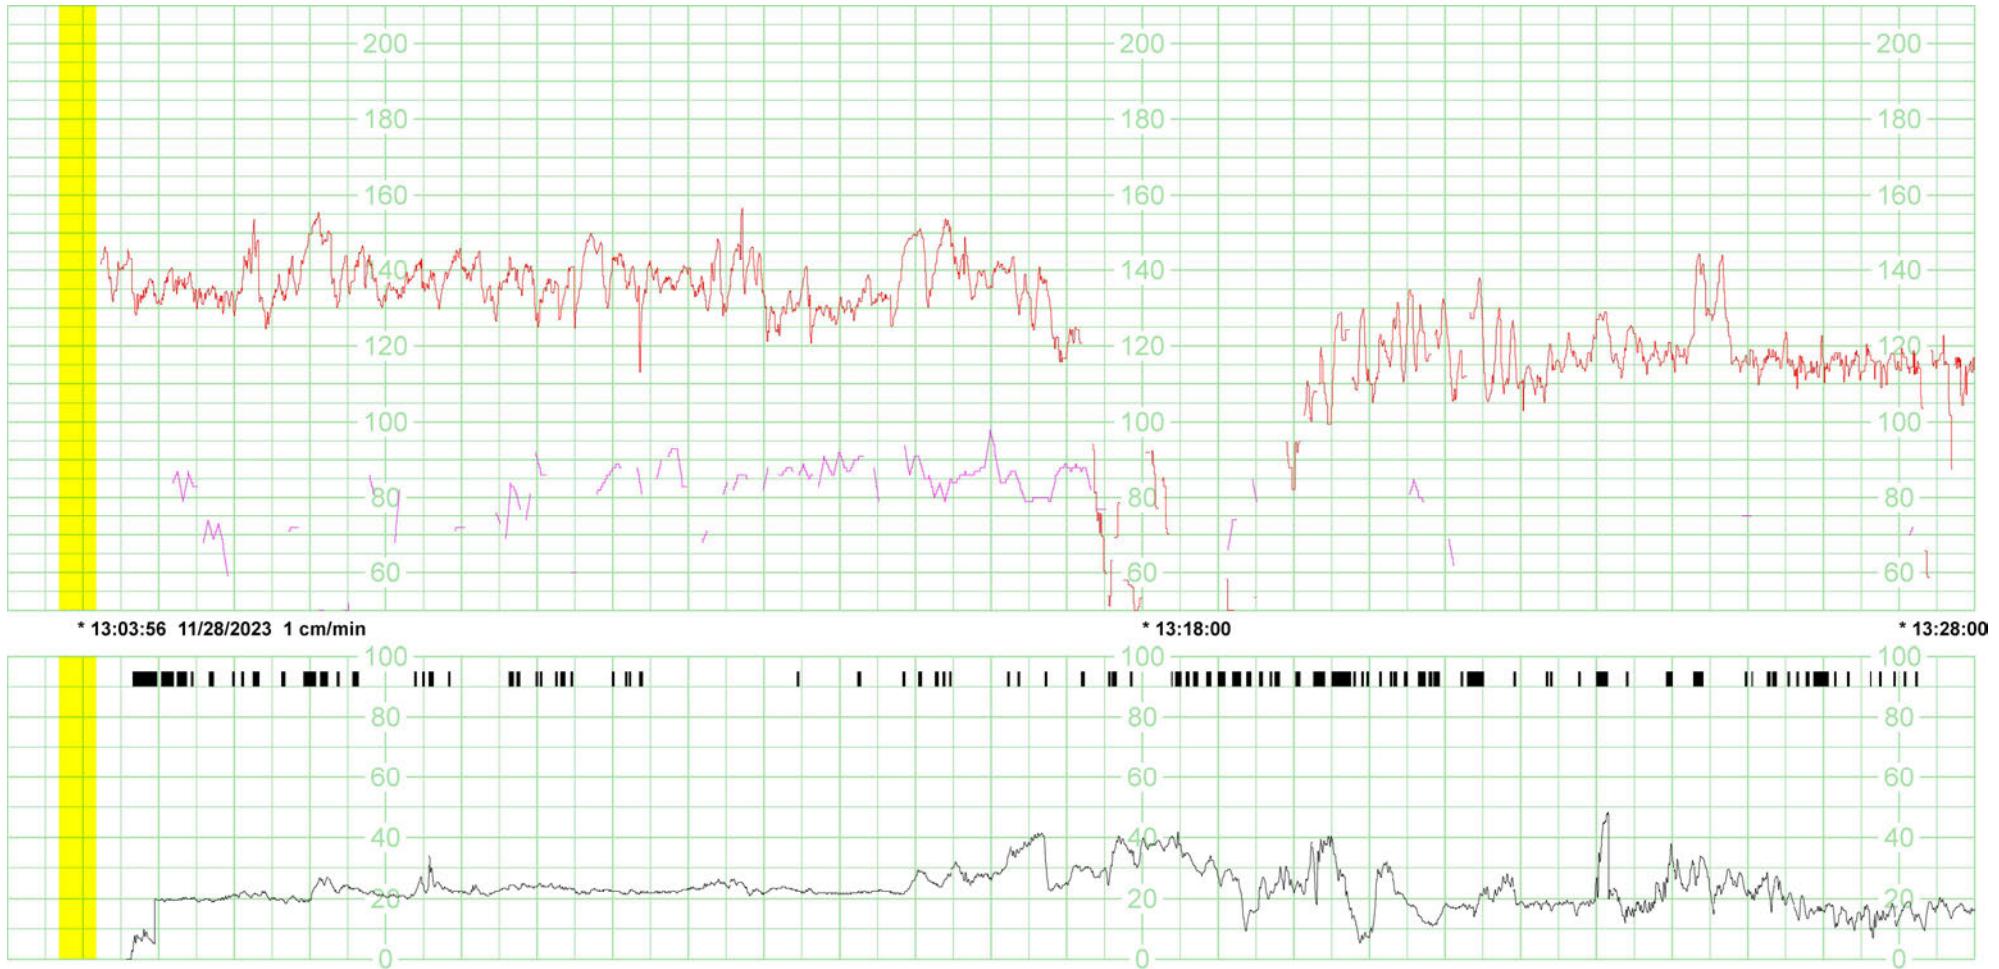


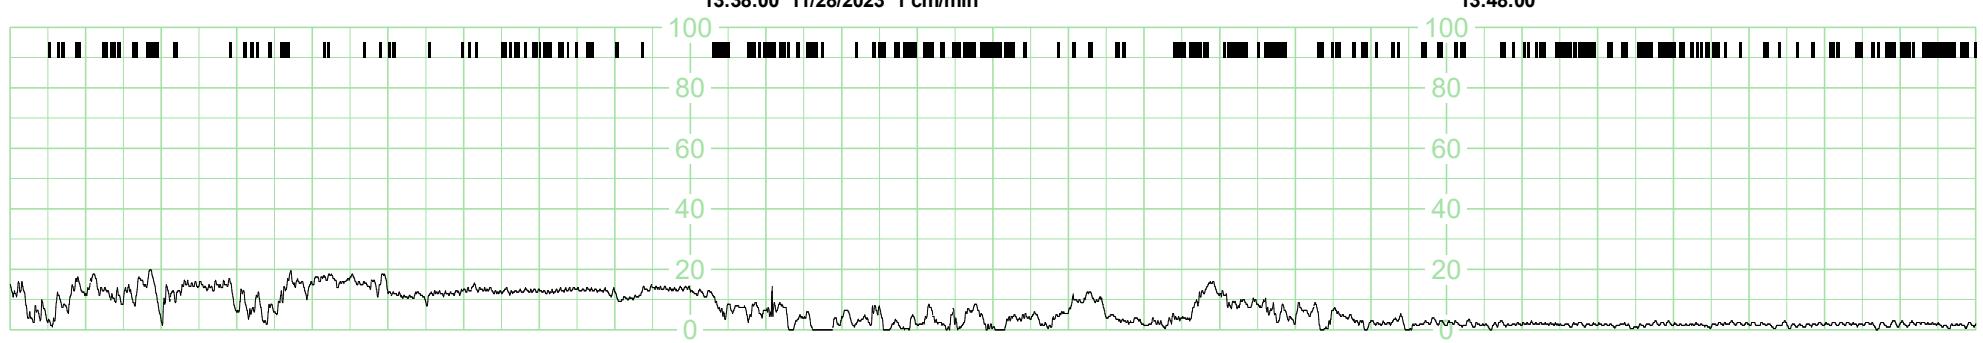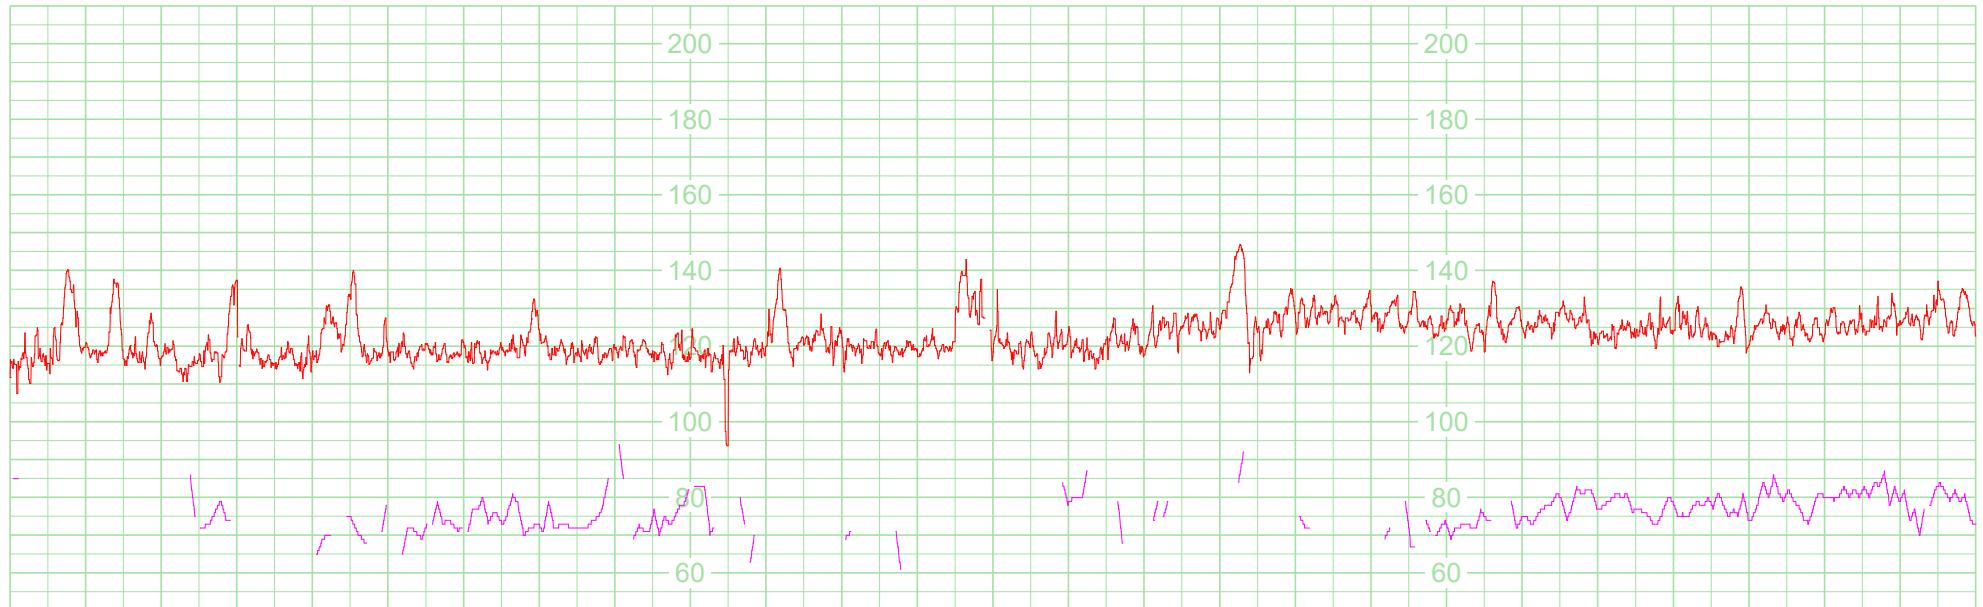


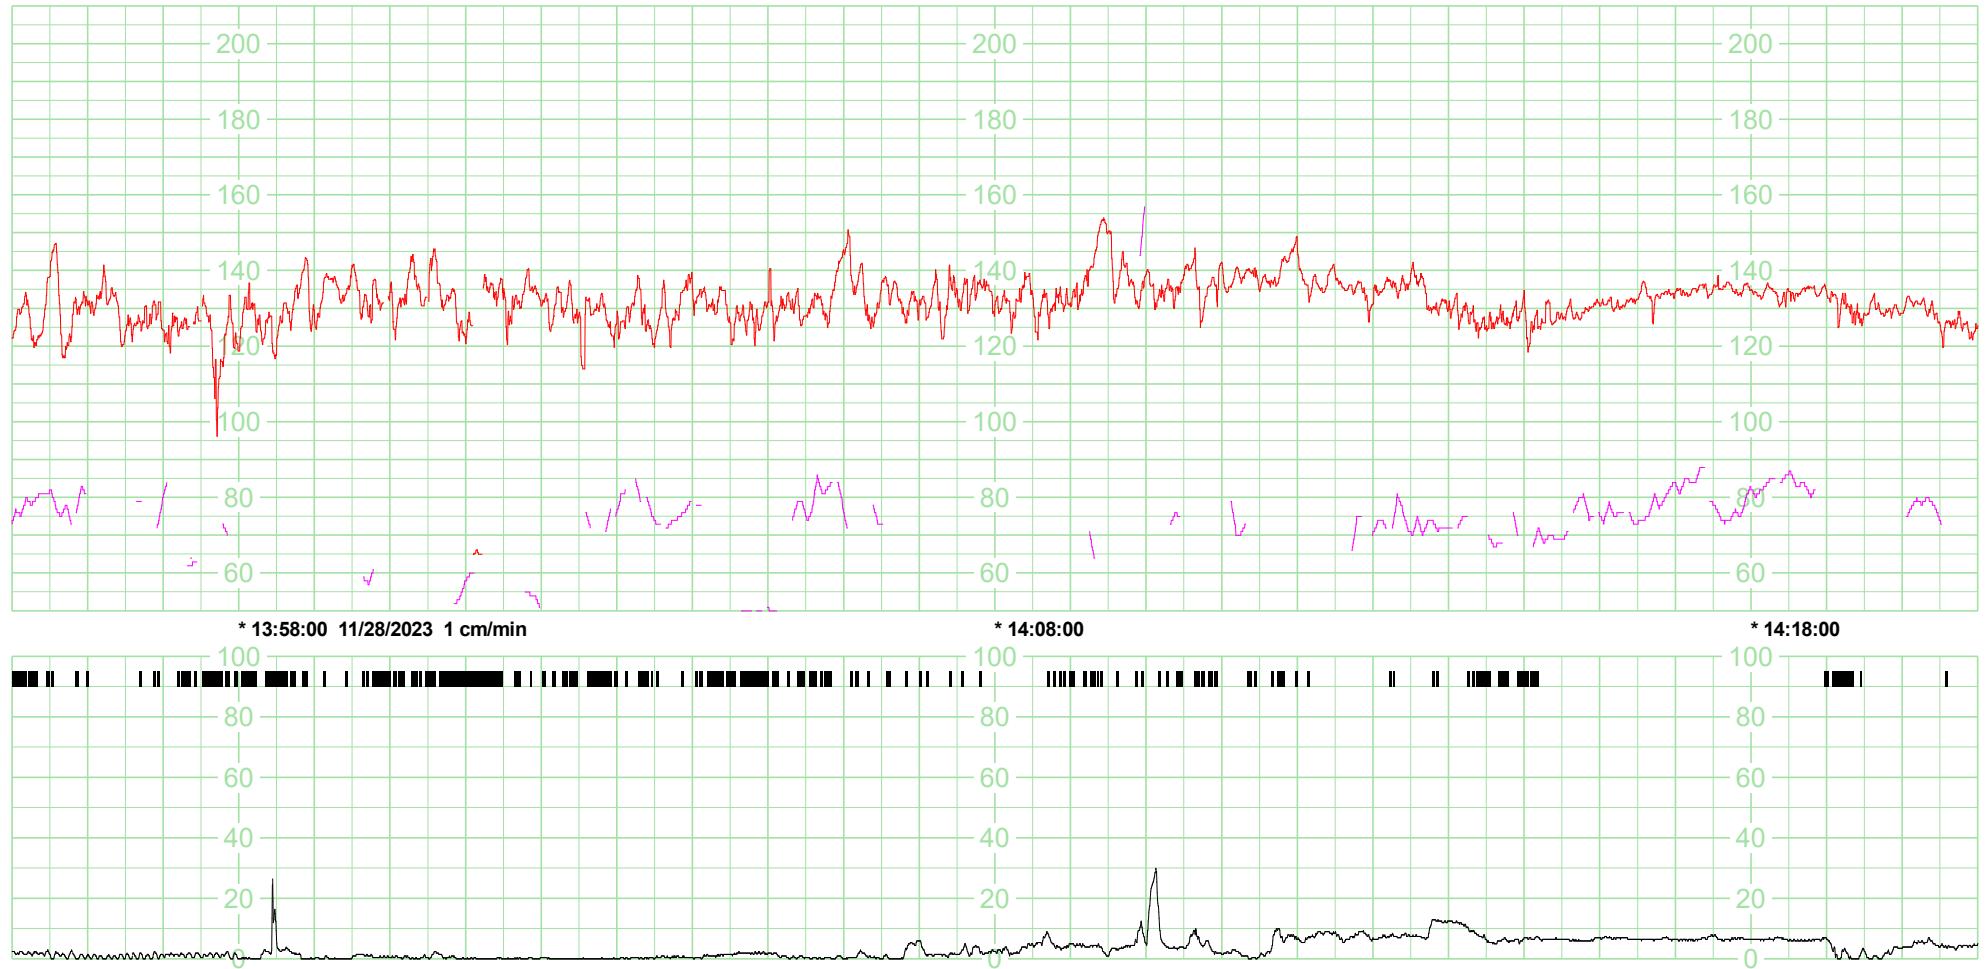

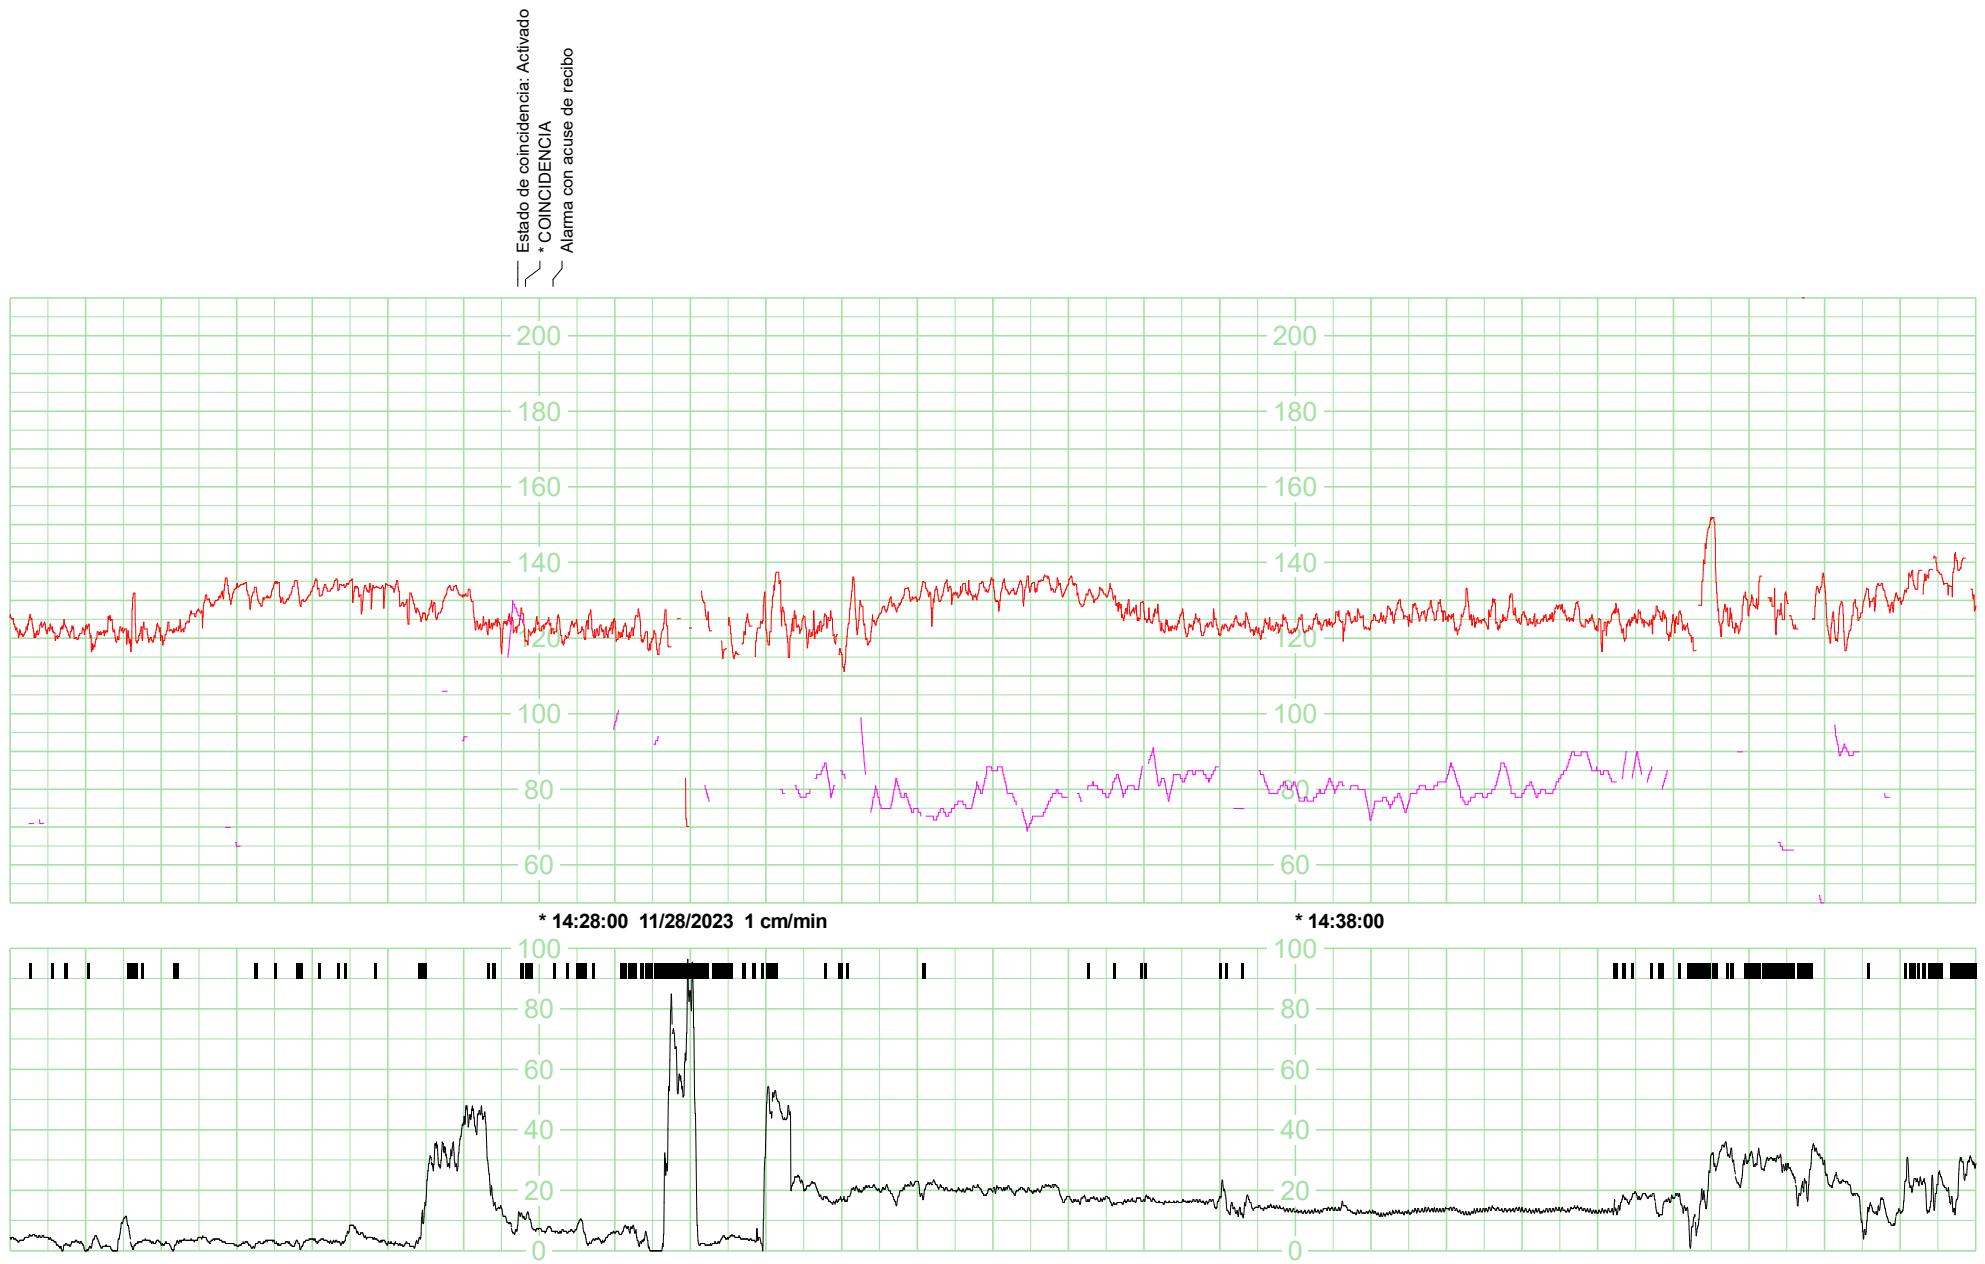



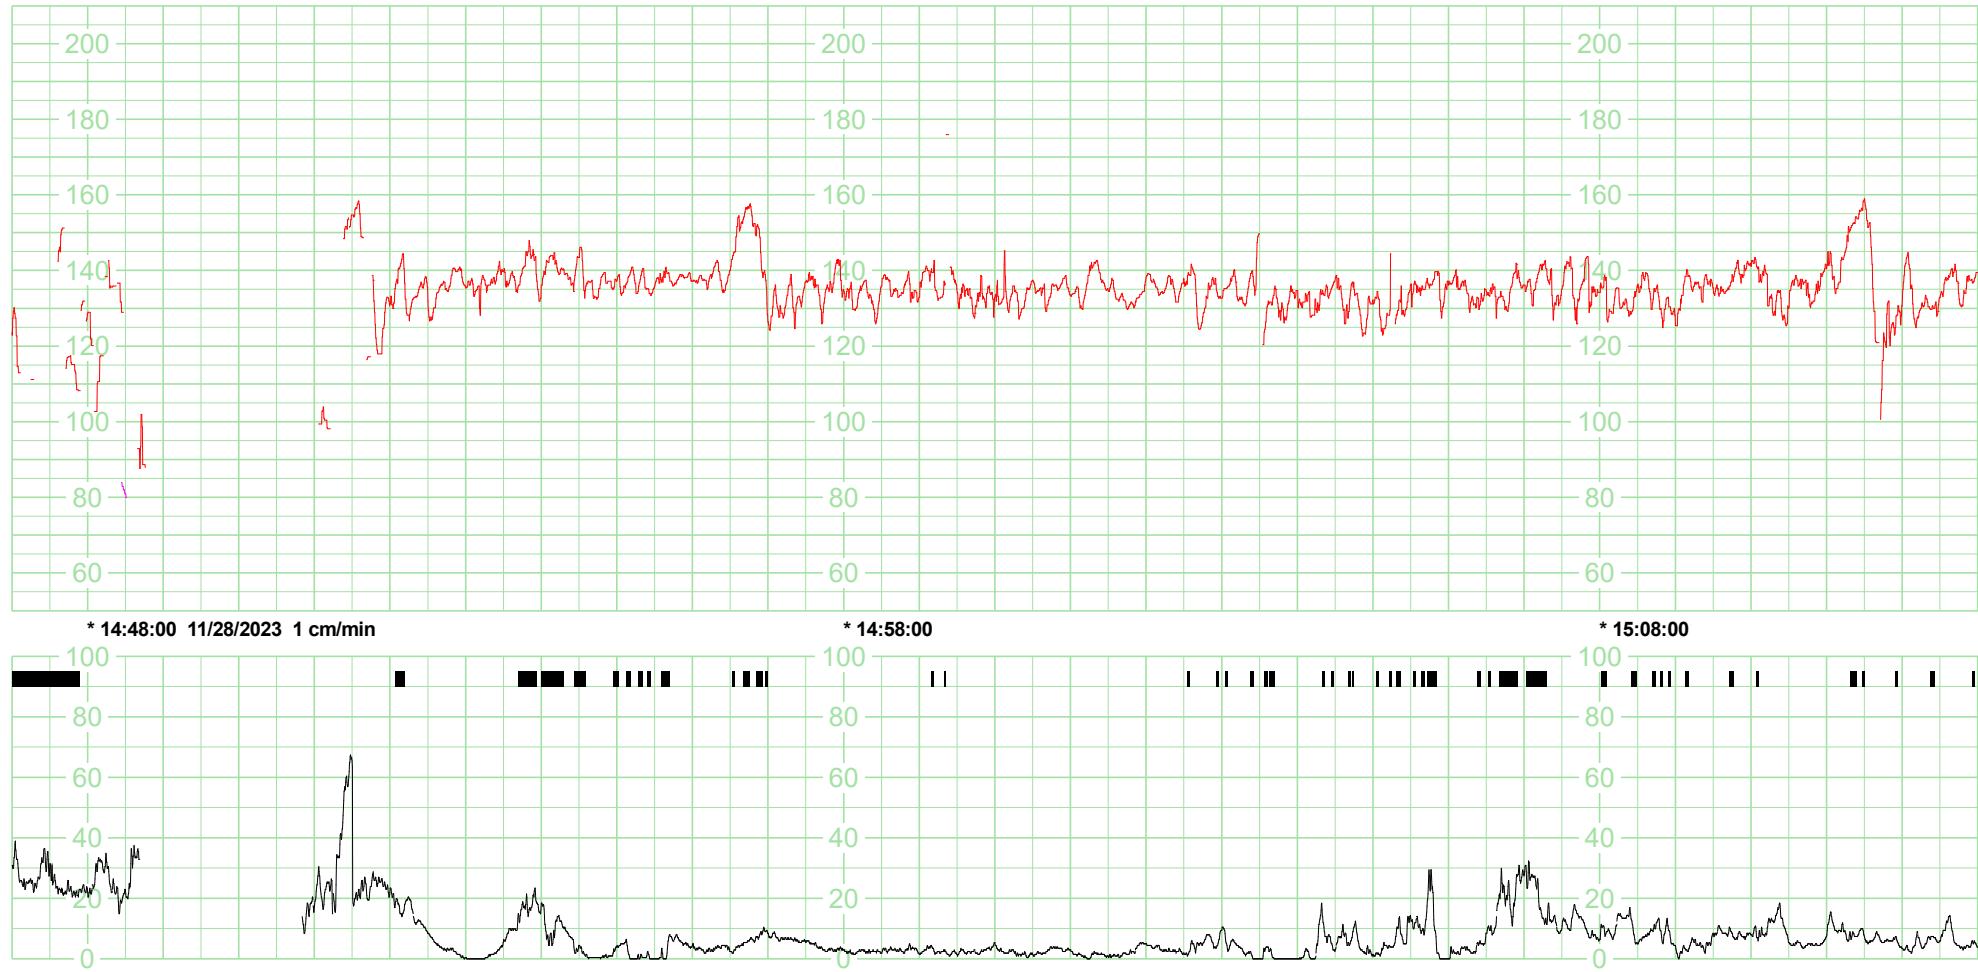


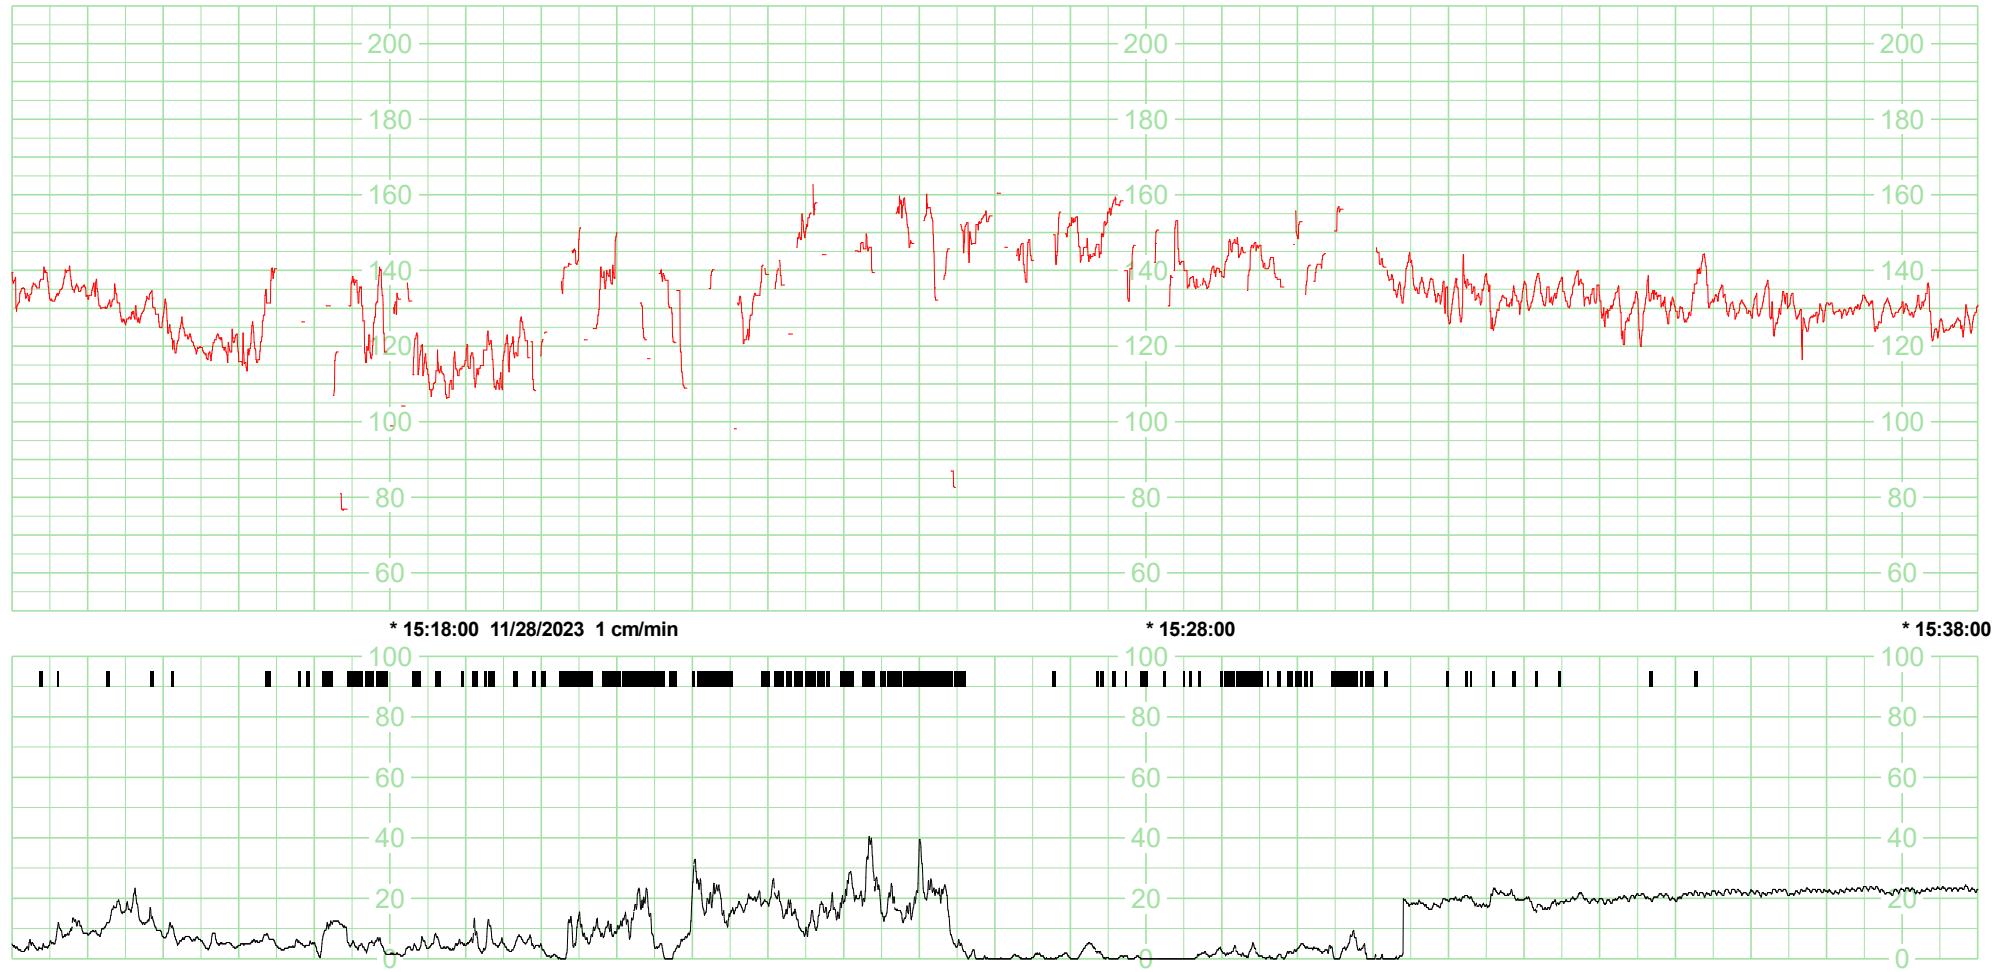


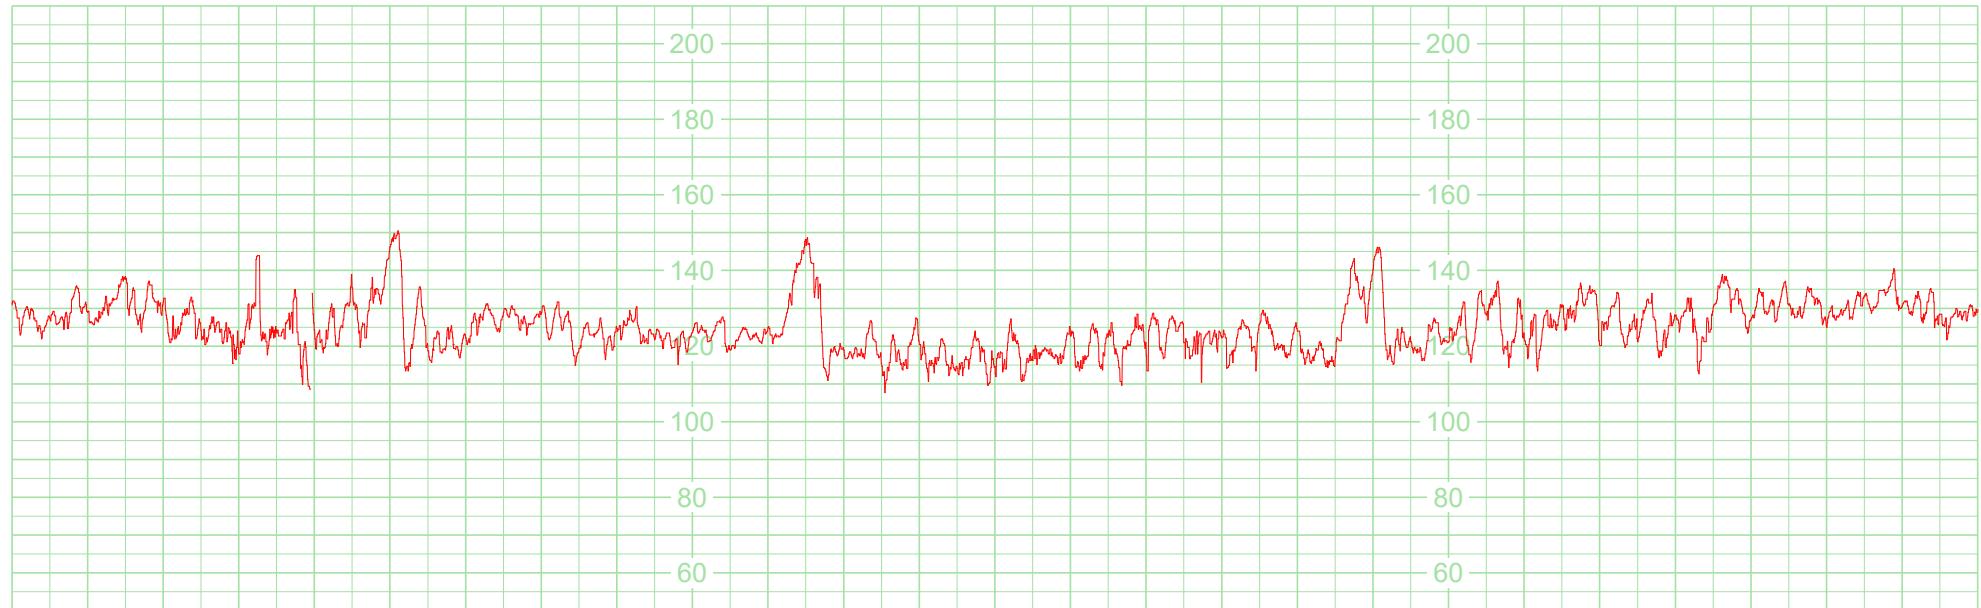



* 15:48:00 11/28/2023 1 cm/min

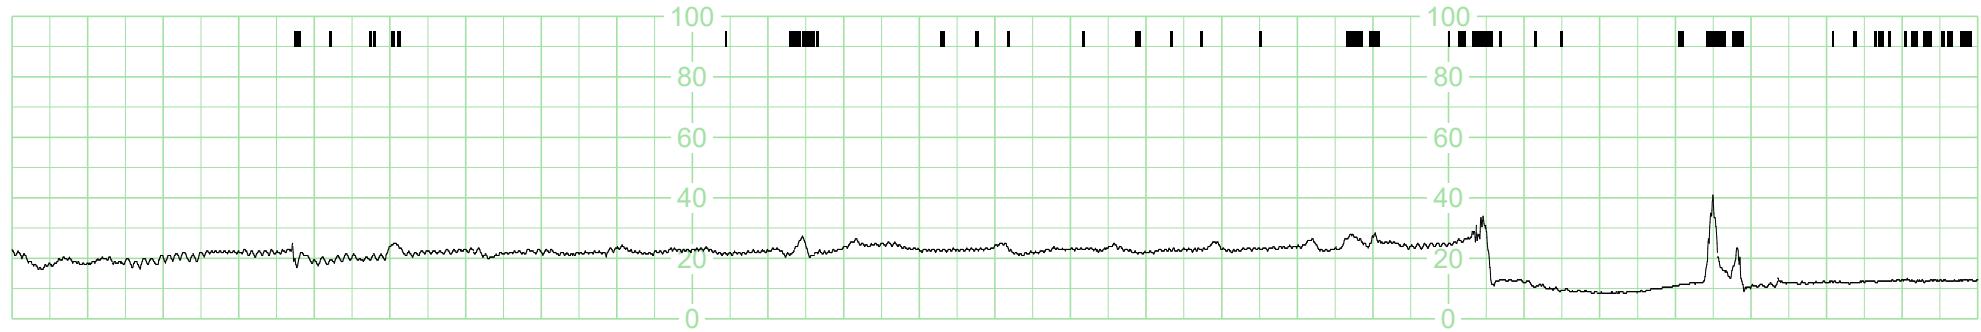


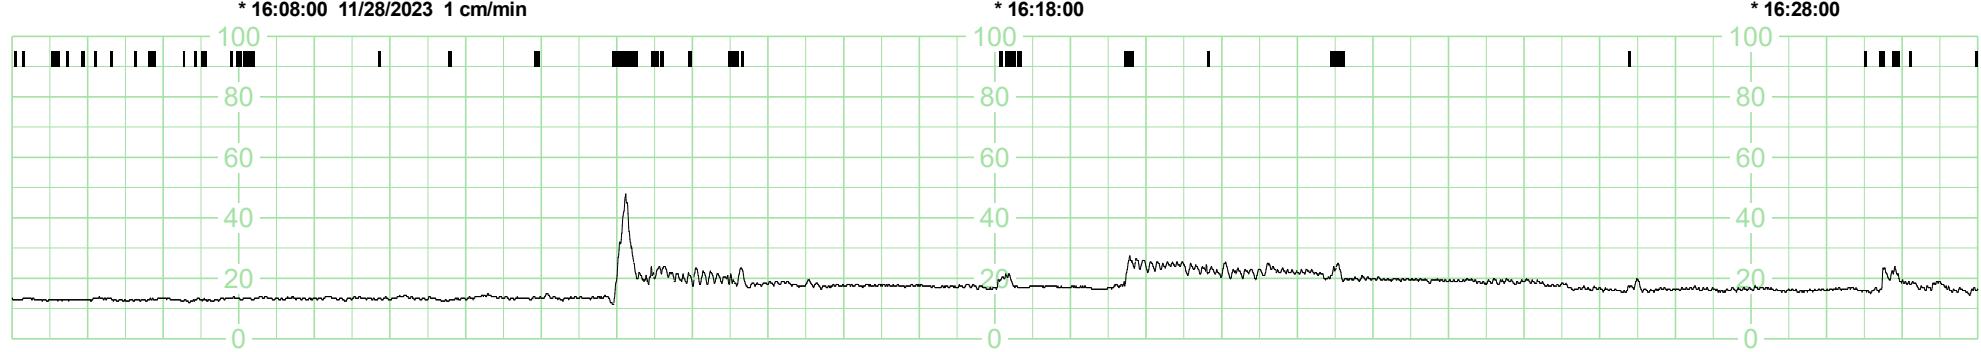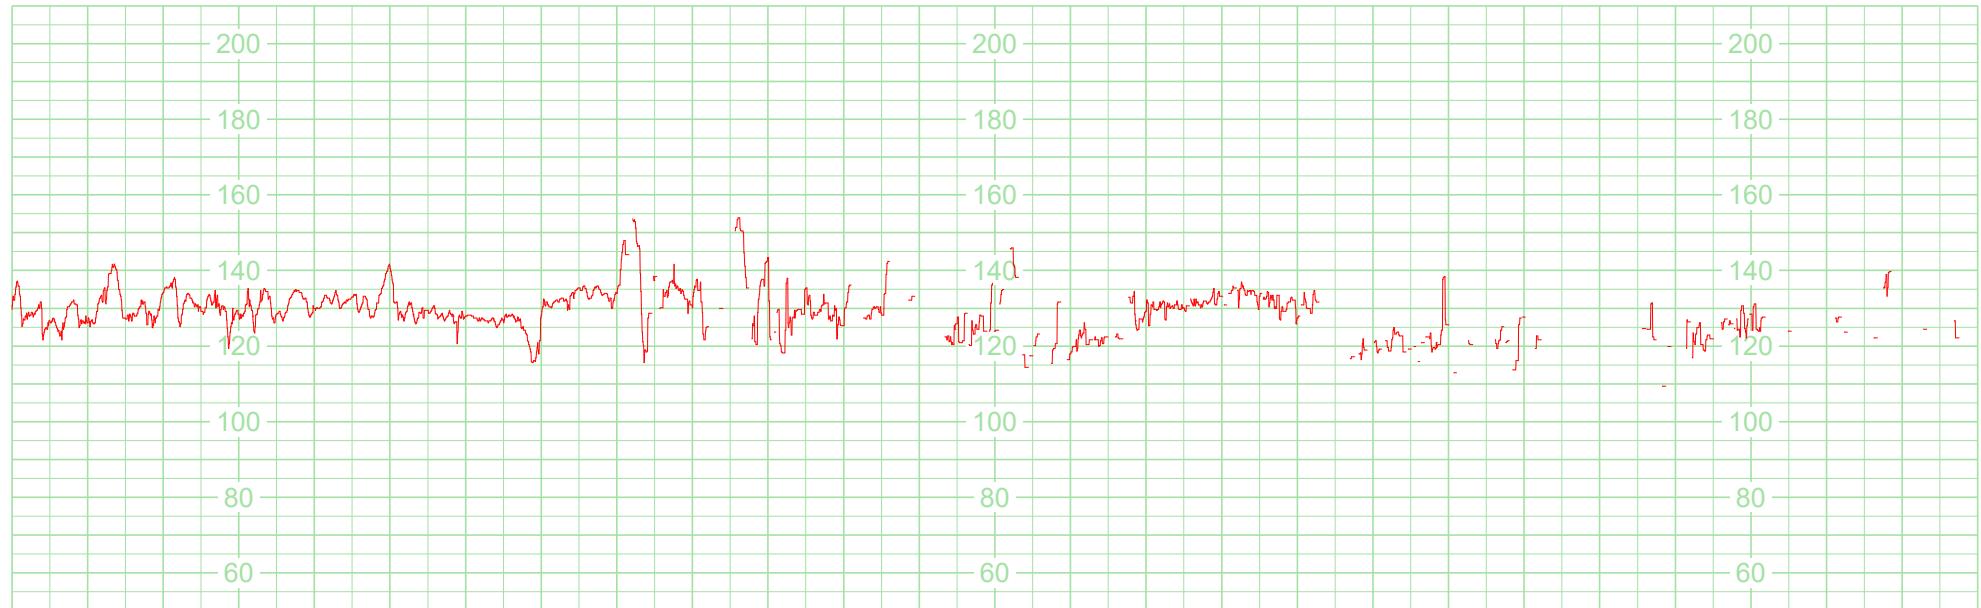

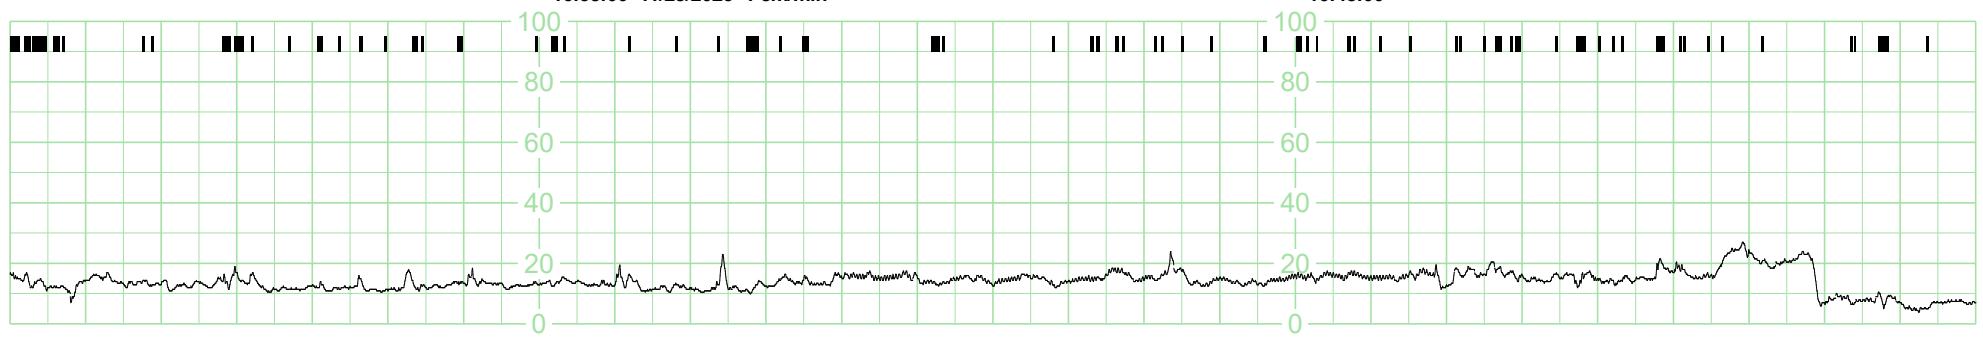




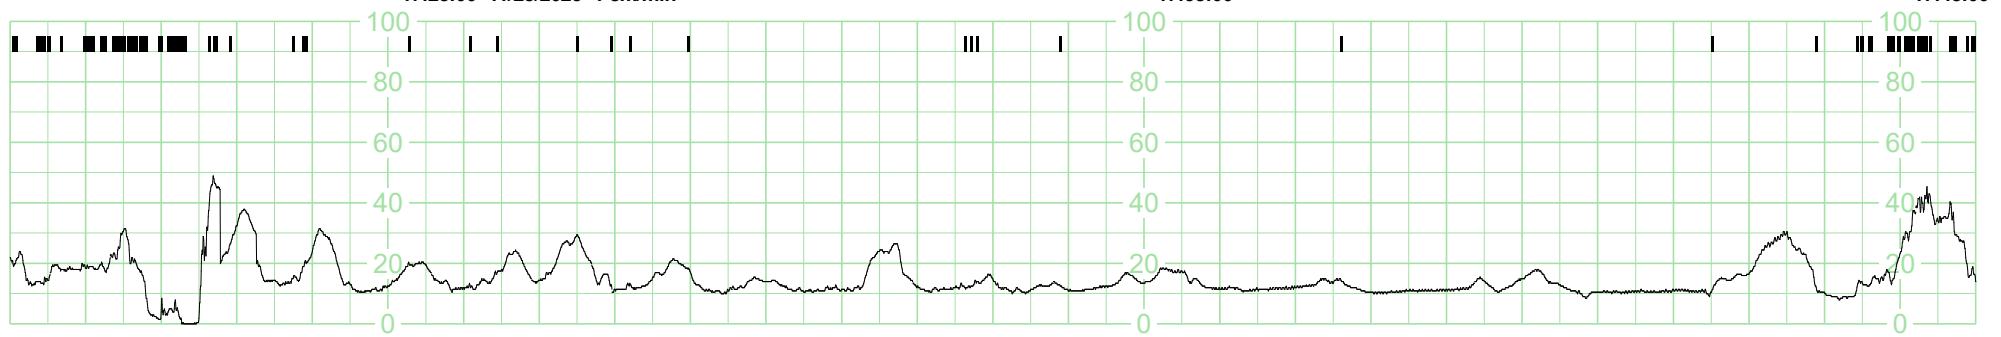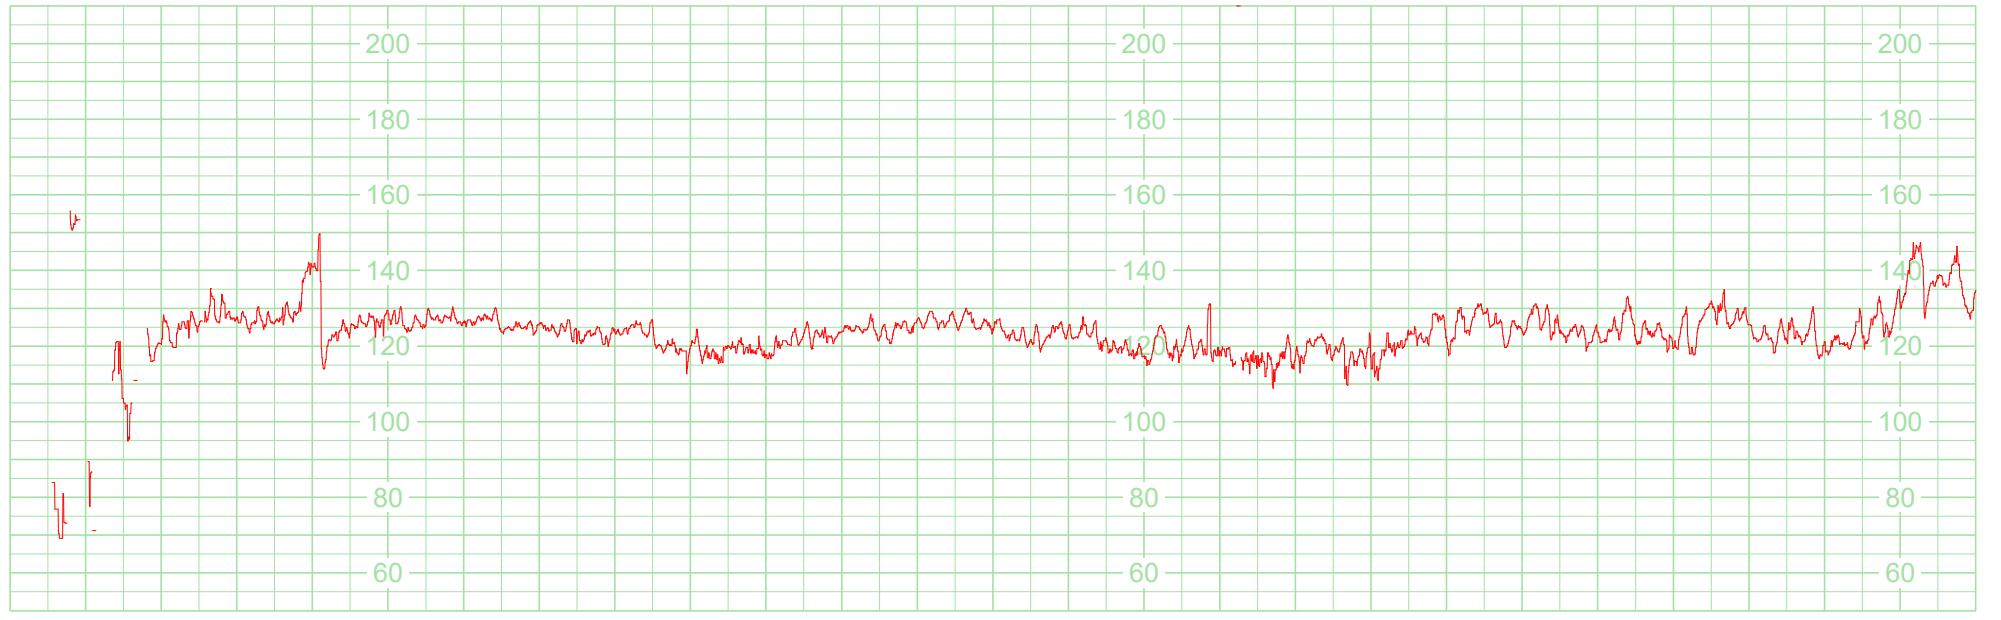

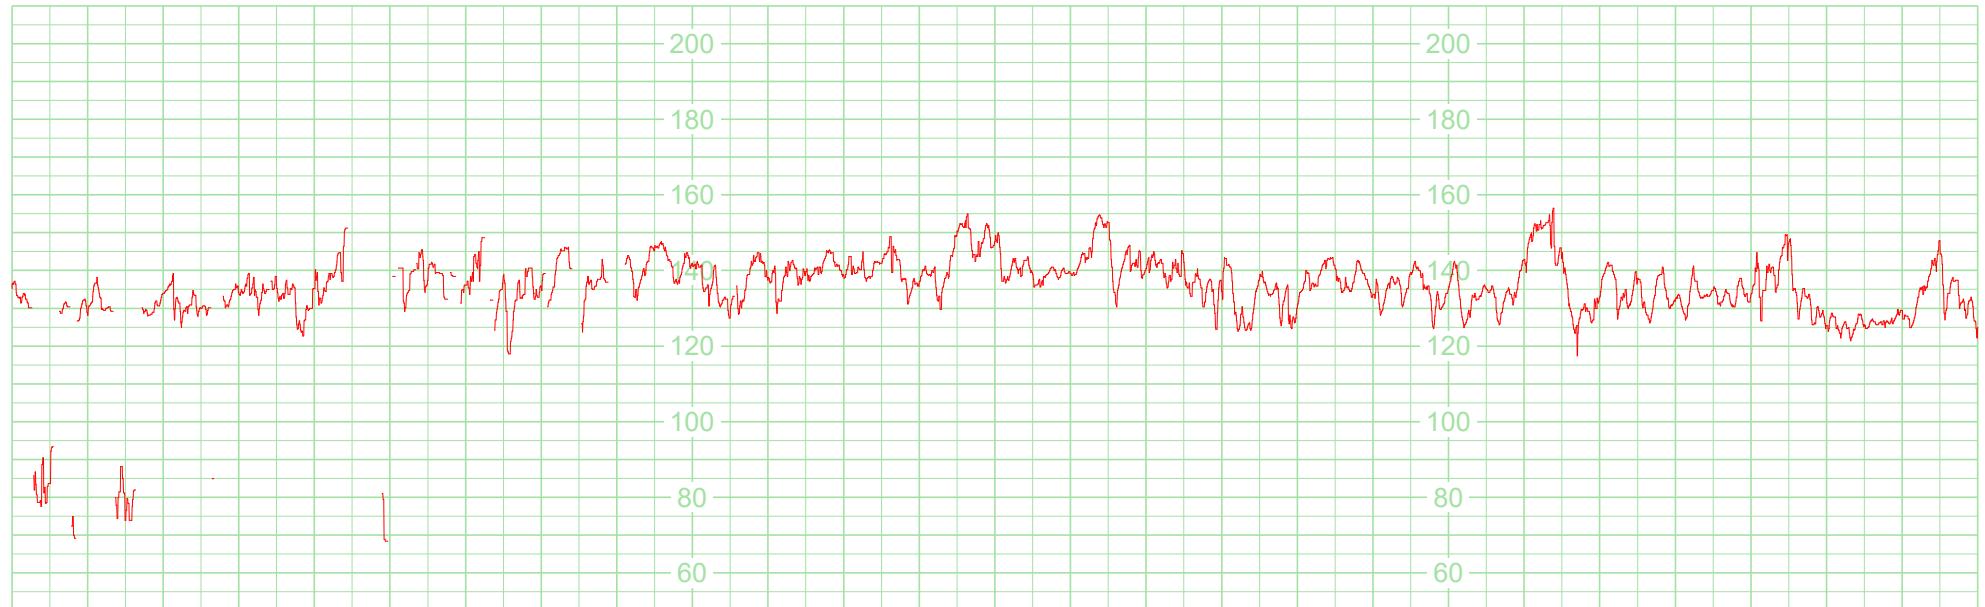


* 17:58:00 11/28/2023 1 cm/min



* 18:08:00

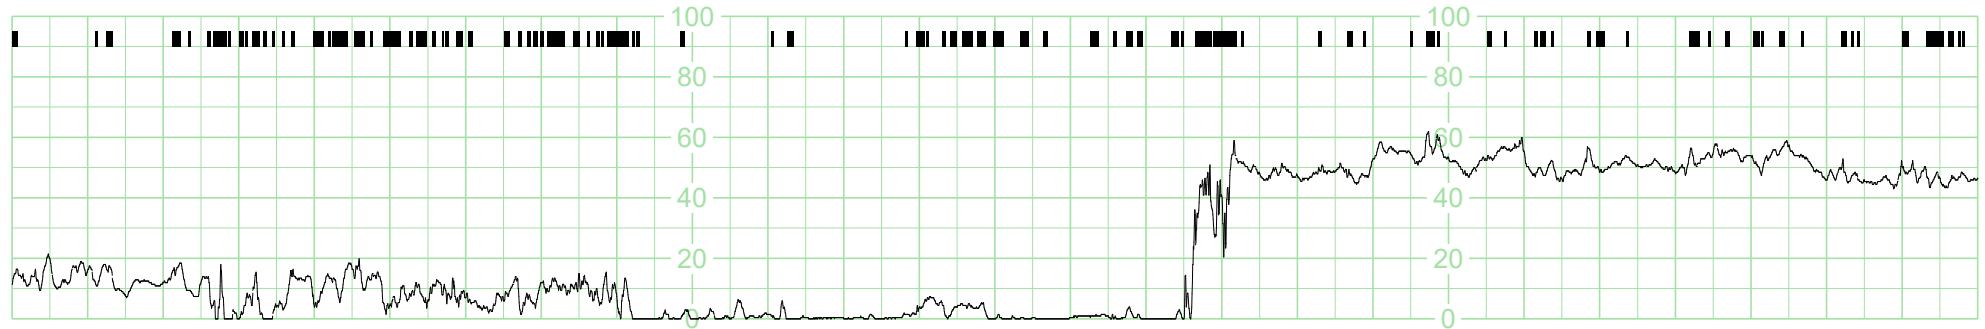





Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A
Estado del registrador: Desactivado
Modo FCF1: no transductor
Modo FCF2: no transductor
Modo FCF3: no transductor
Modo FCM: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado de la telemetría: Activado
Modo Toco: externo
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
AJUSTES DE ALARMAS PARA
PACIENTE
Estado del registrador: Activado

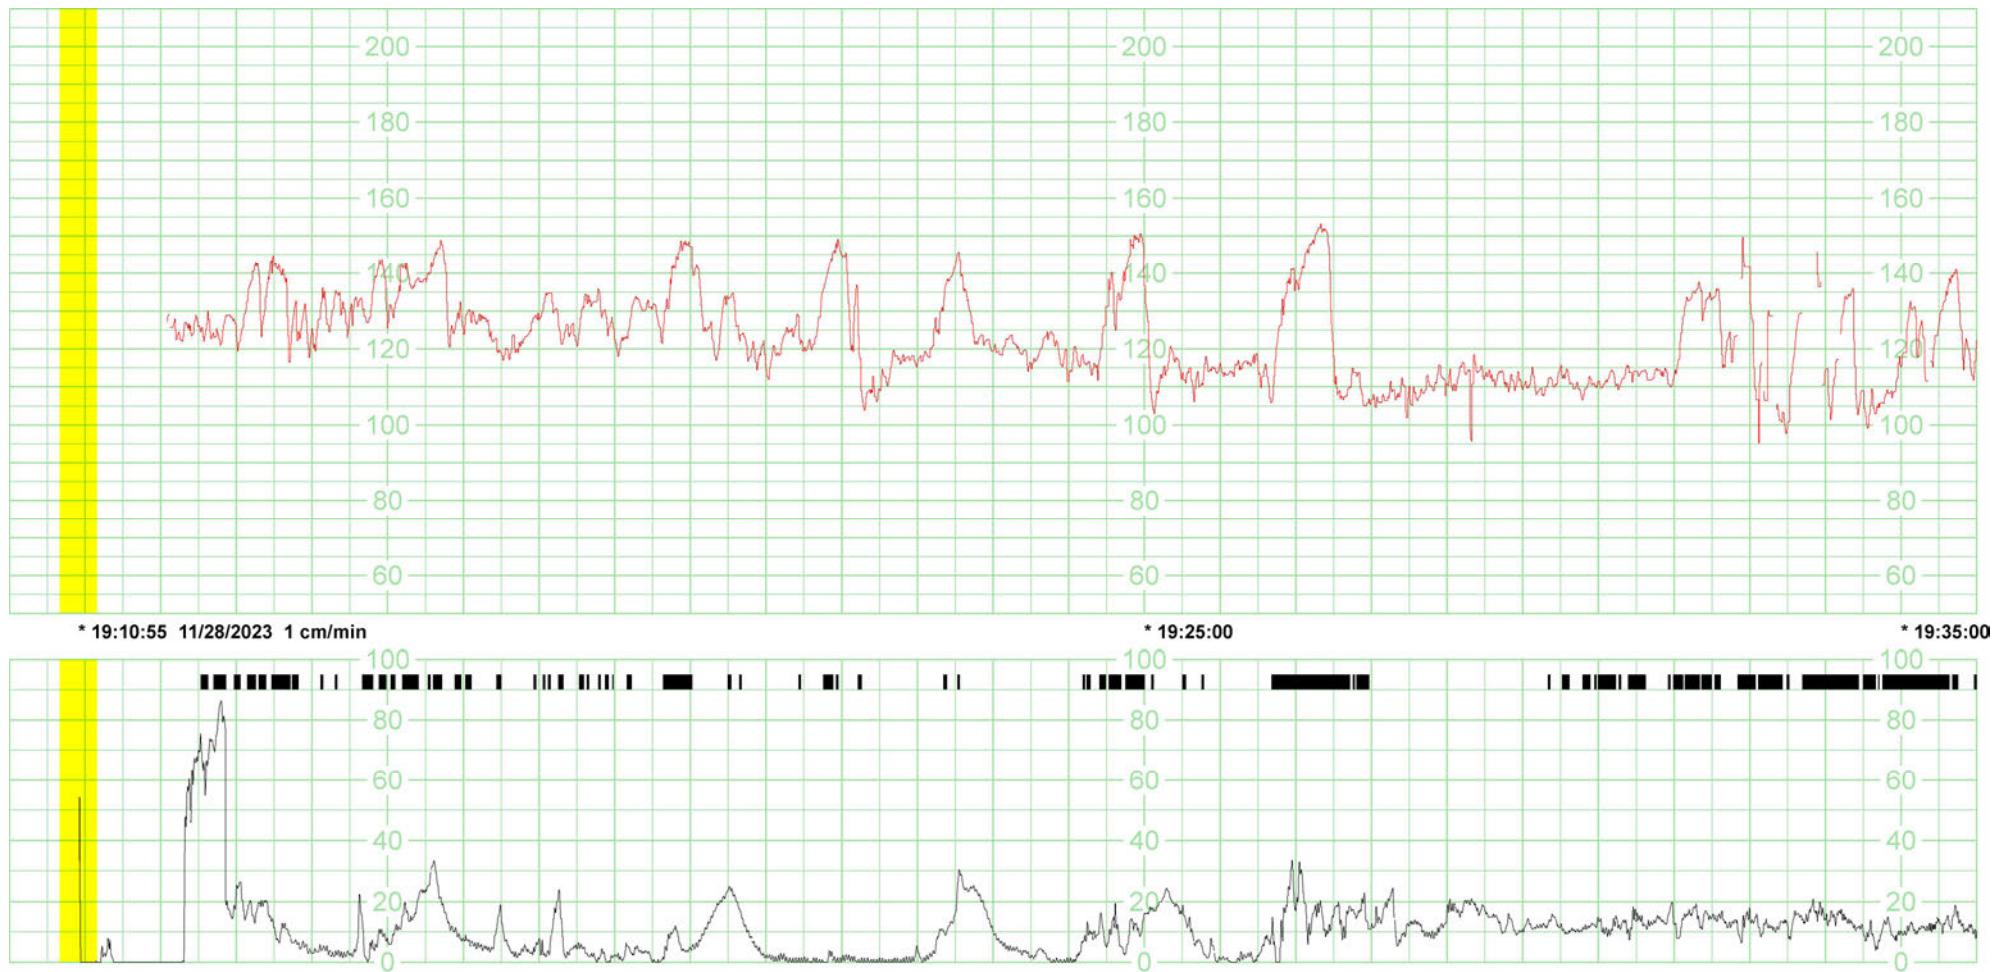

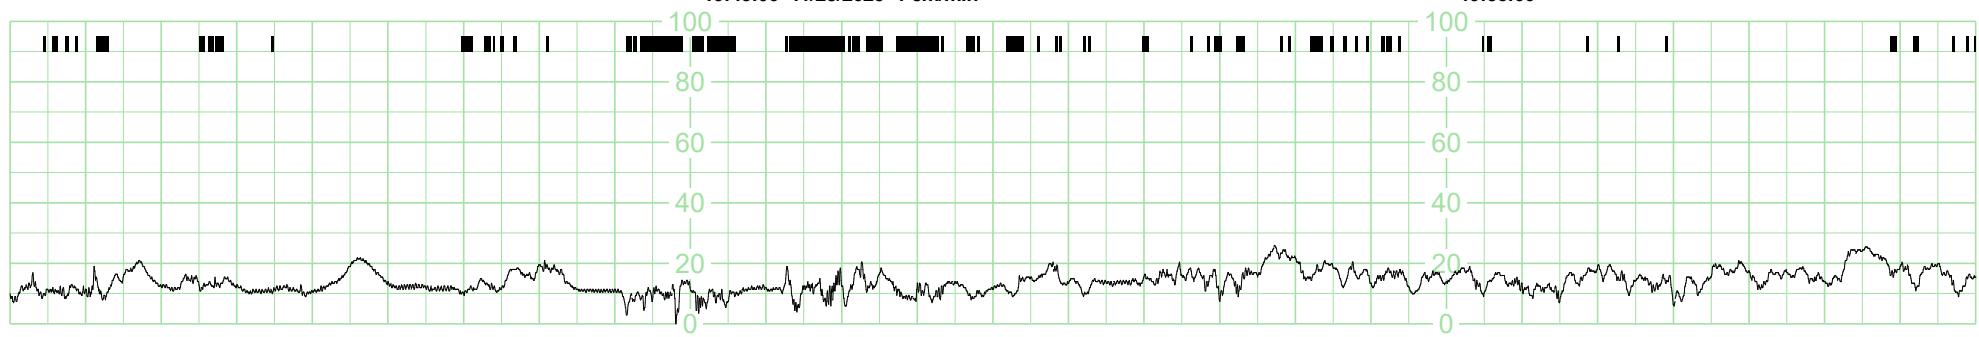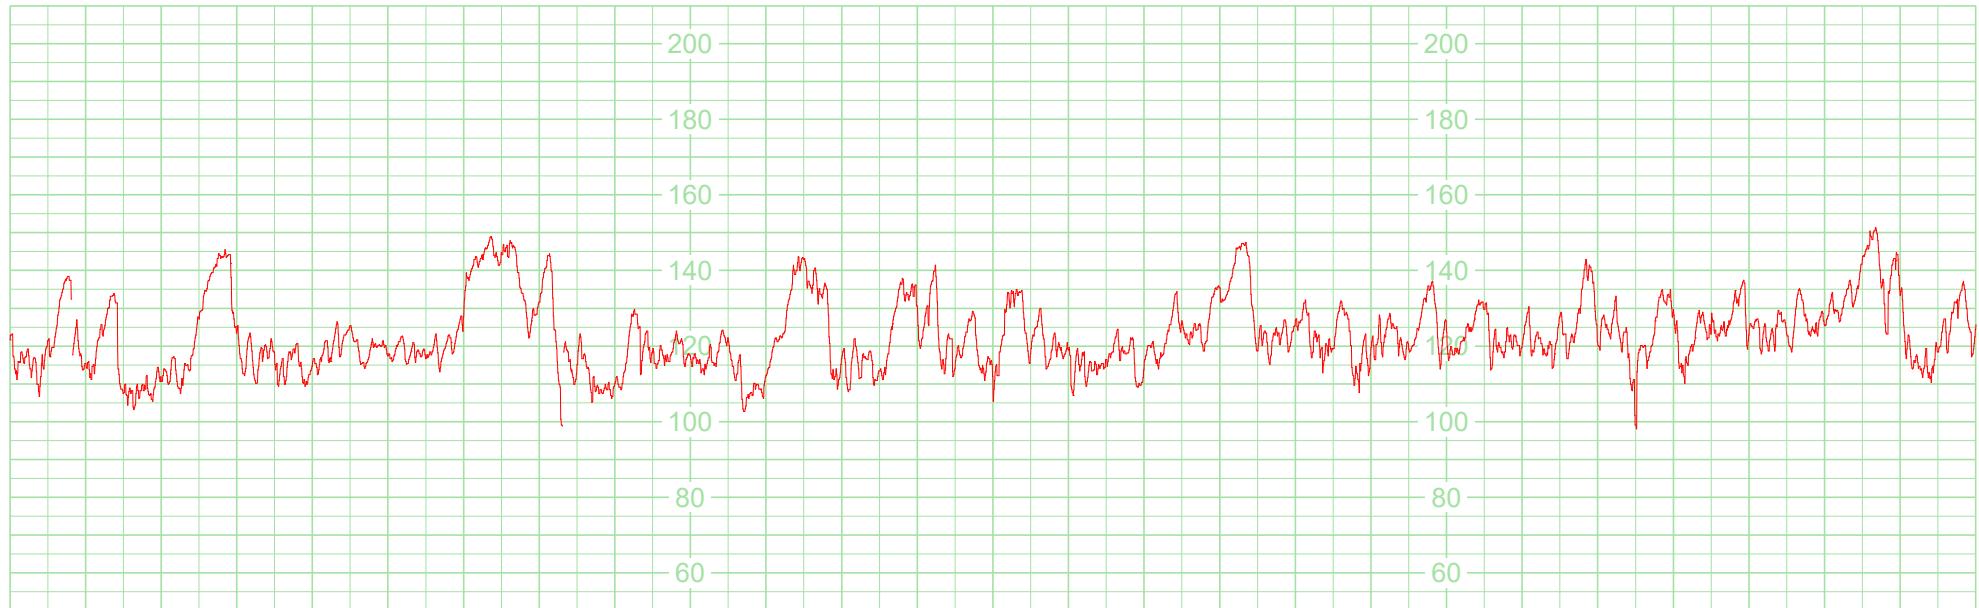



Estado del monitor: En espera
Modo FCFI: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del registrador: Desactivado
Estado de la telemetría: Desactivado

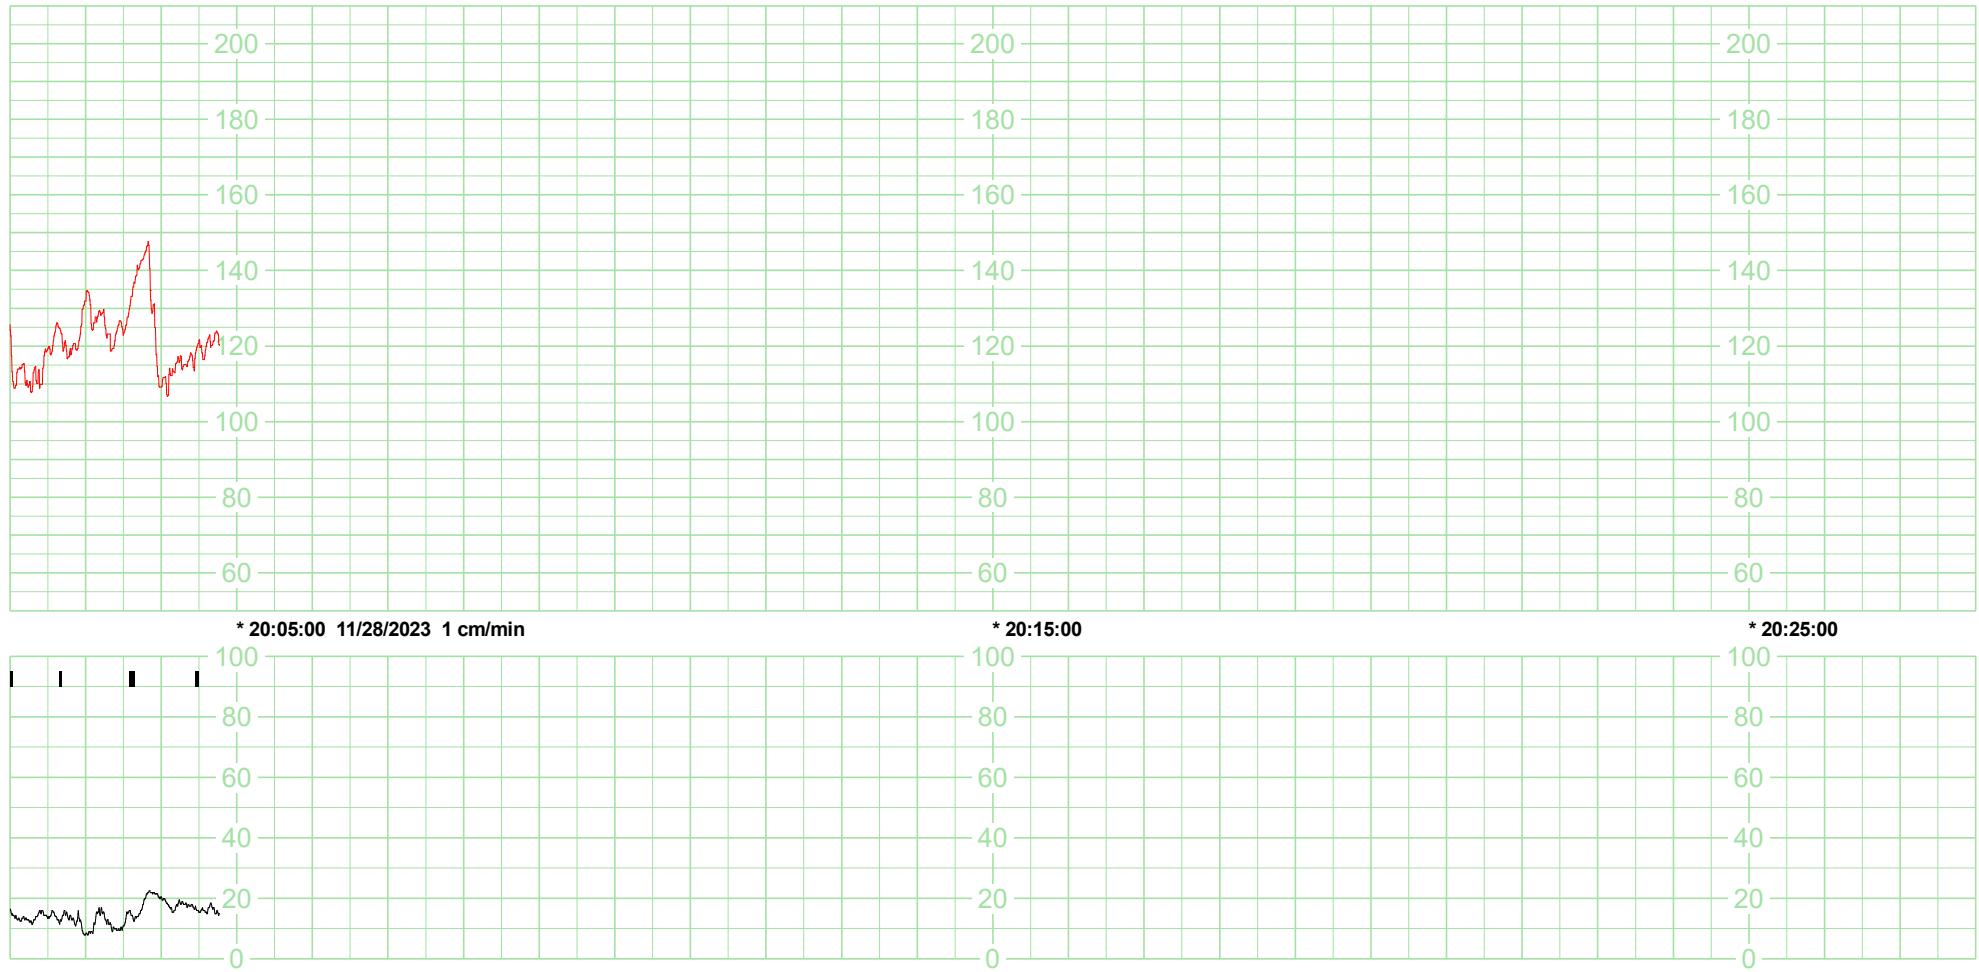



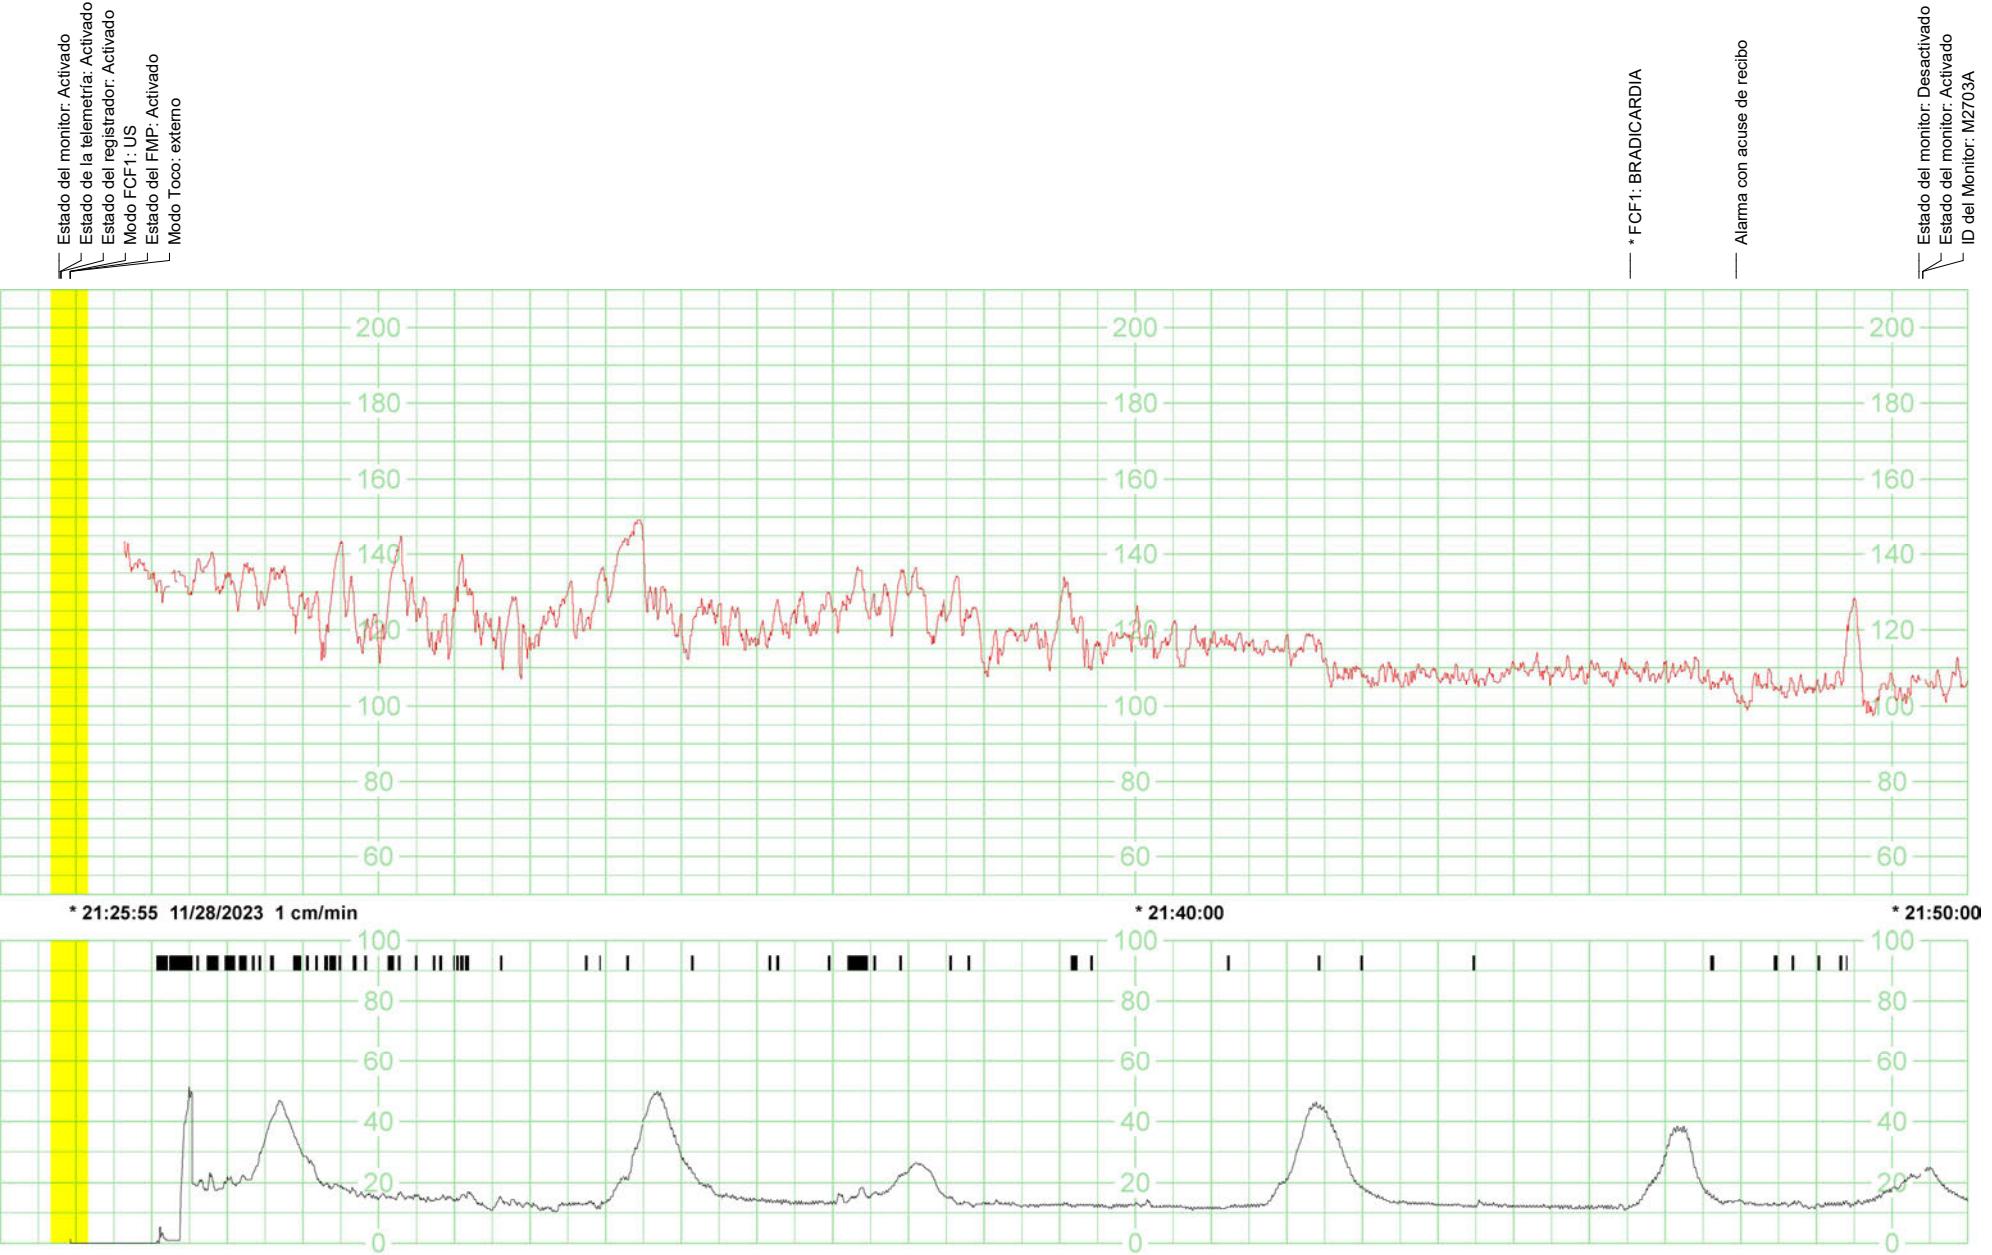



 Estado del monitor: Desactivado
ID del Monitor: M2703A

 * FCF1:BRADICARDIA
 Alarma con acuse de recibo

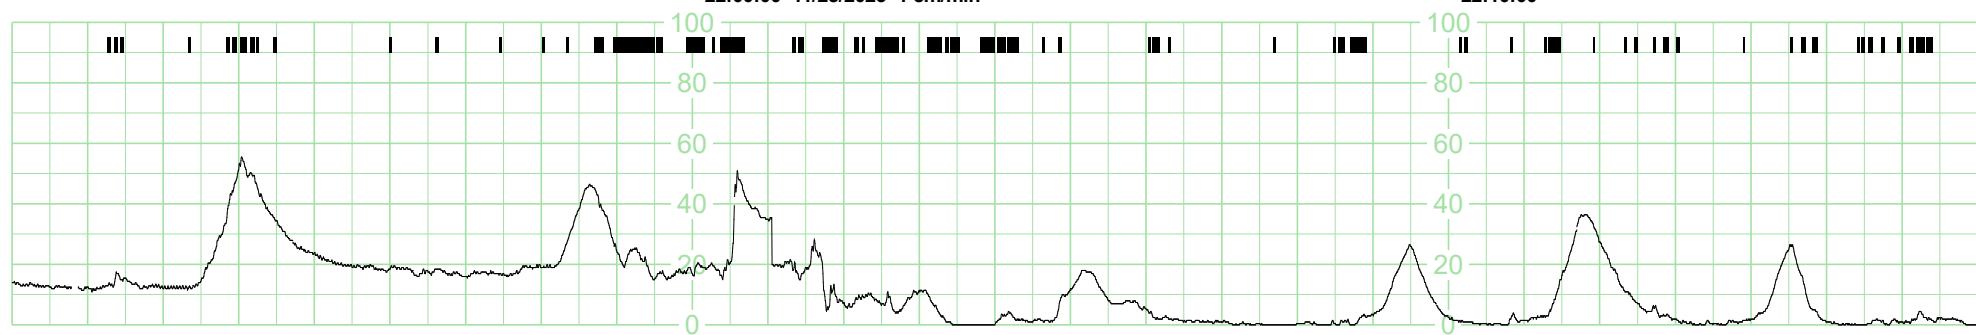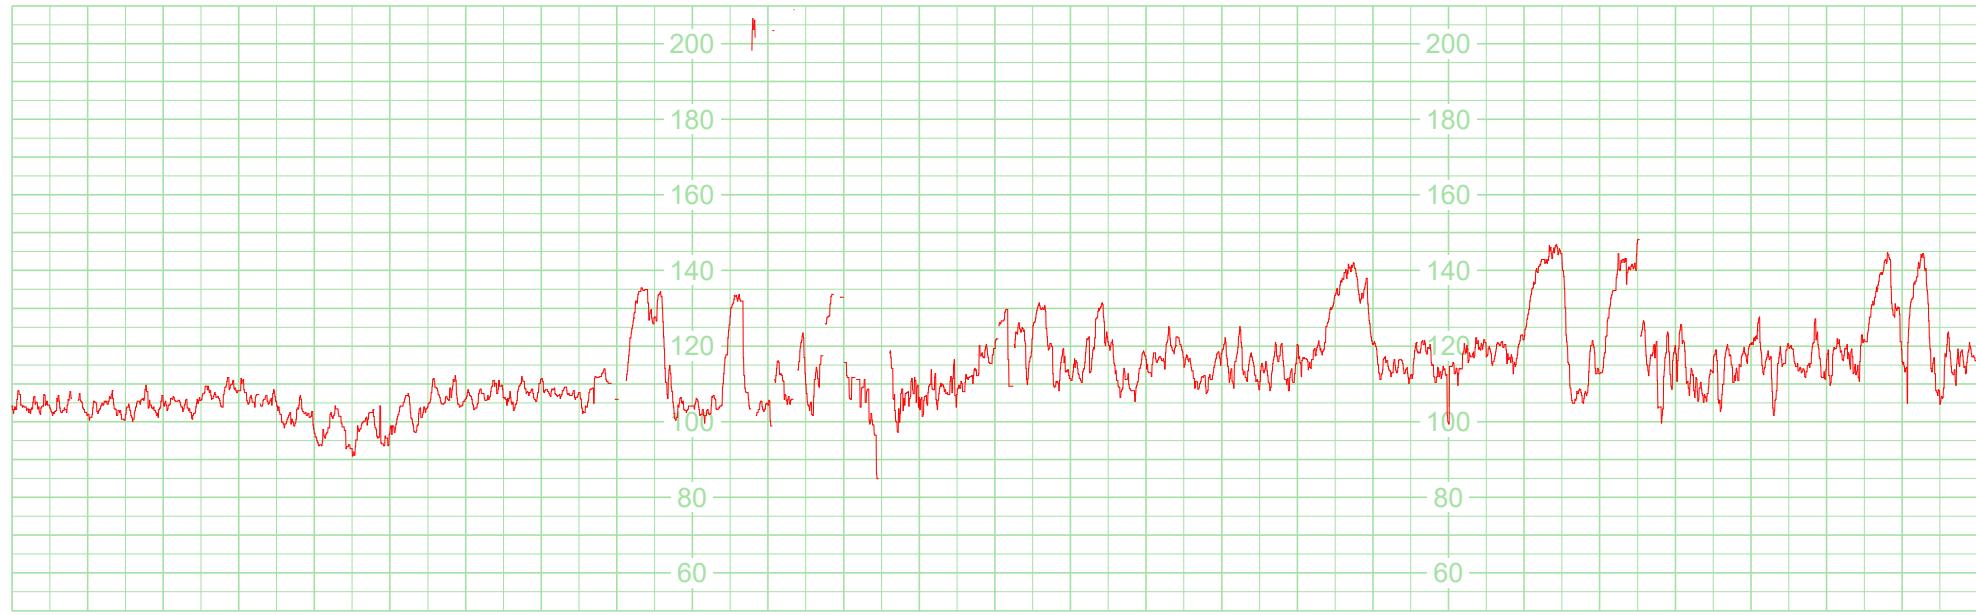



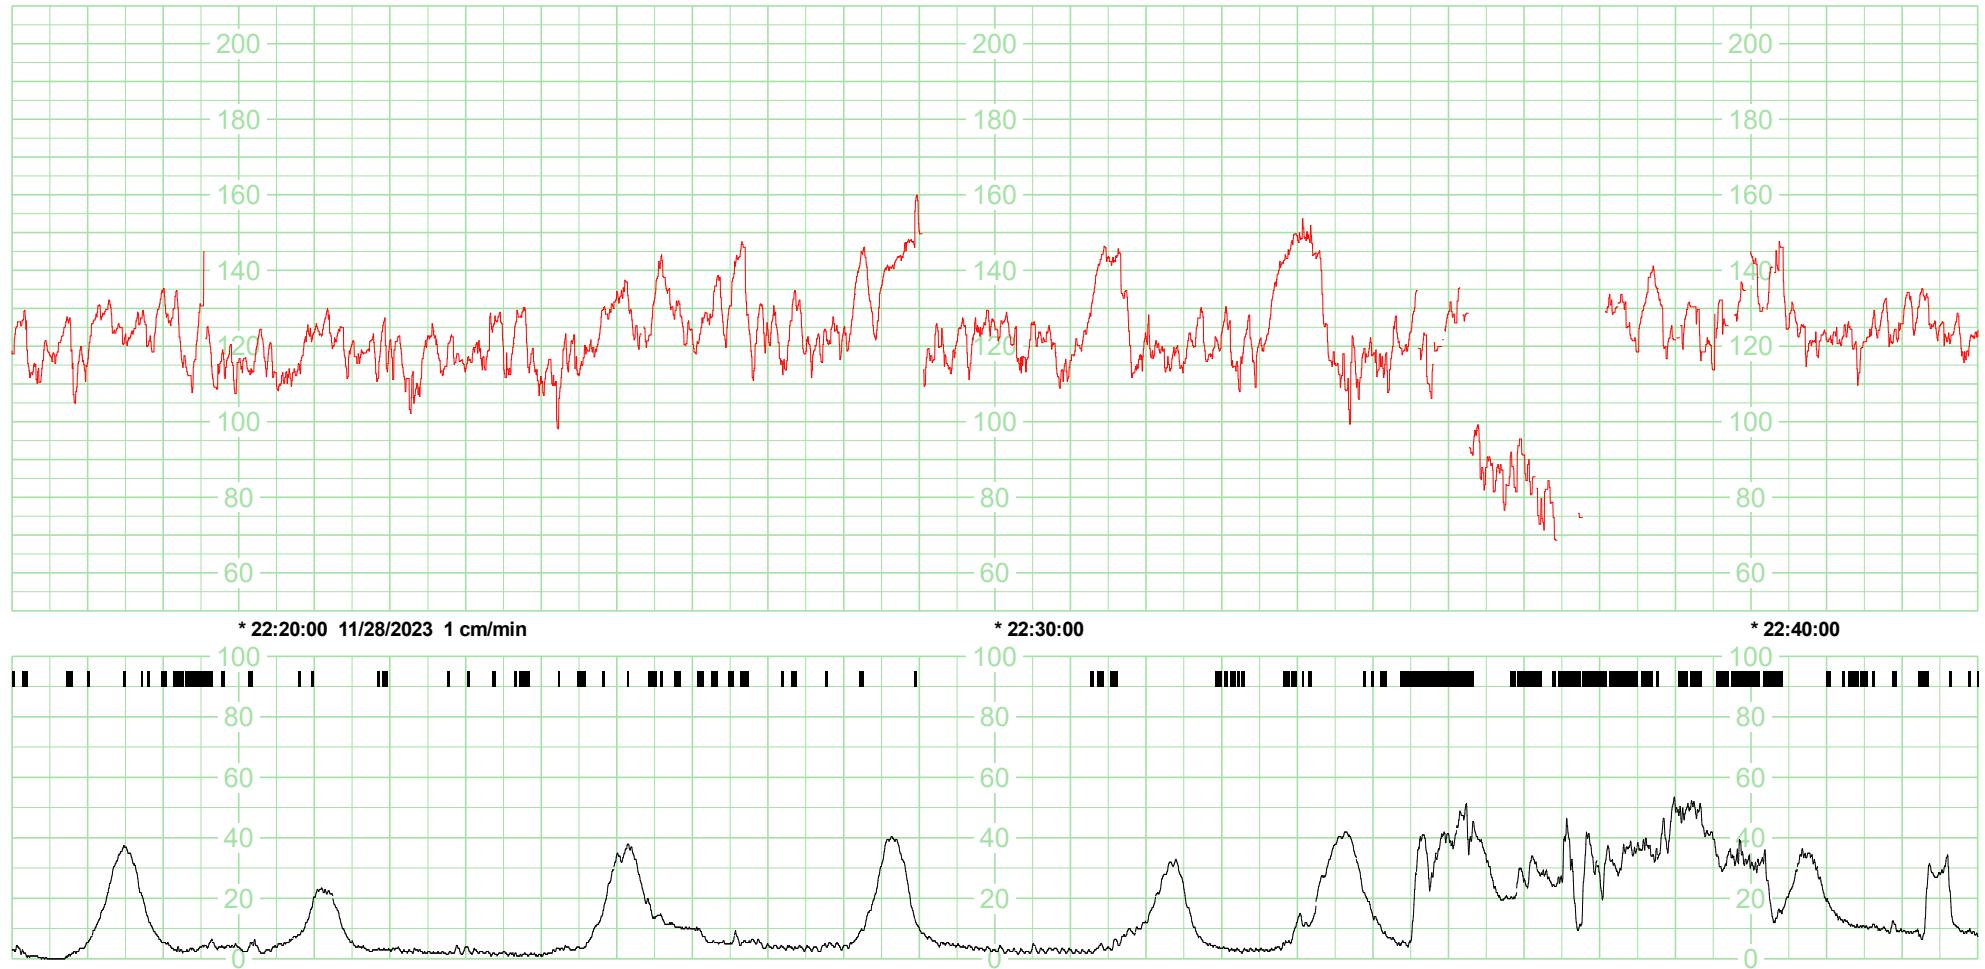


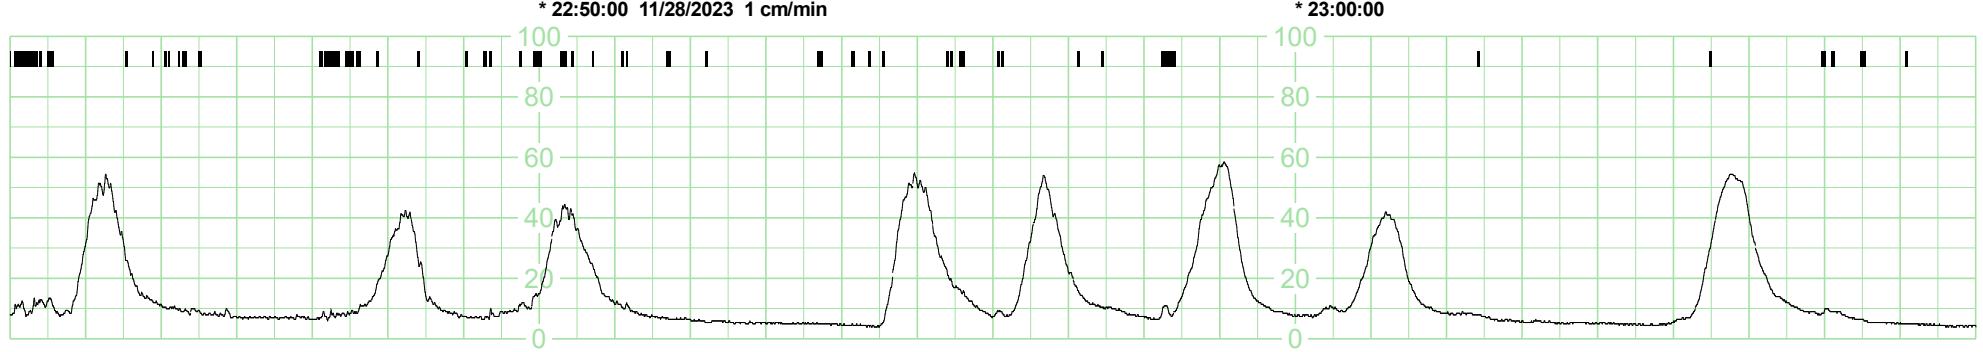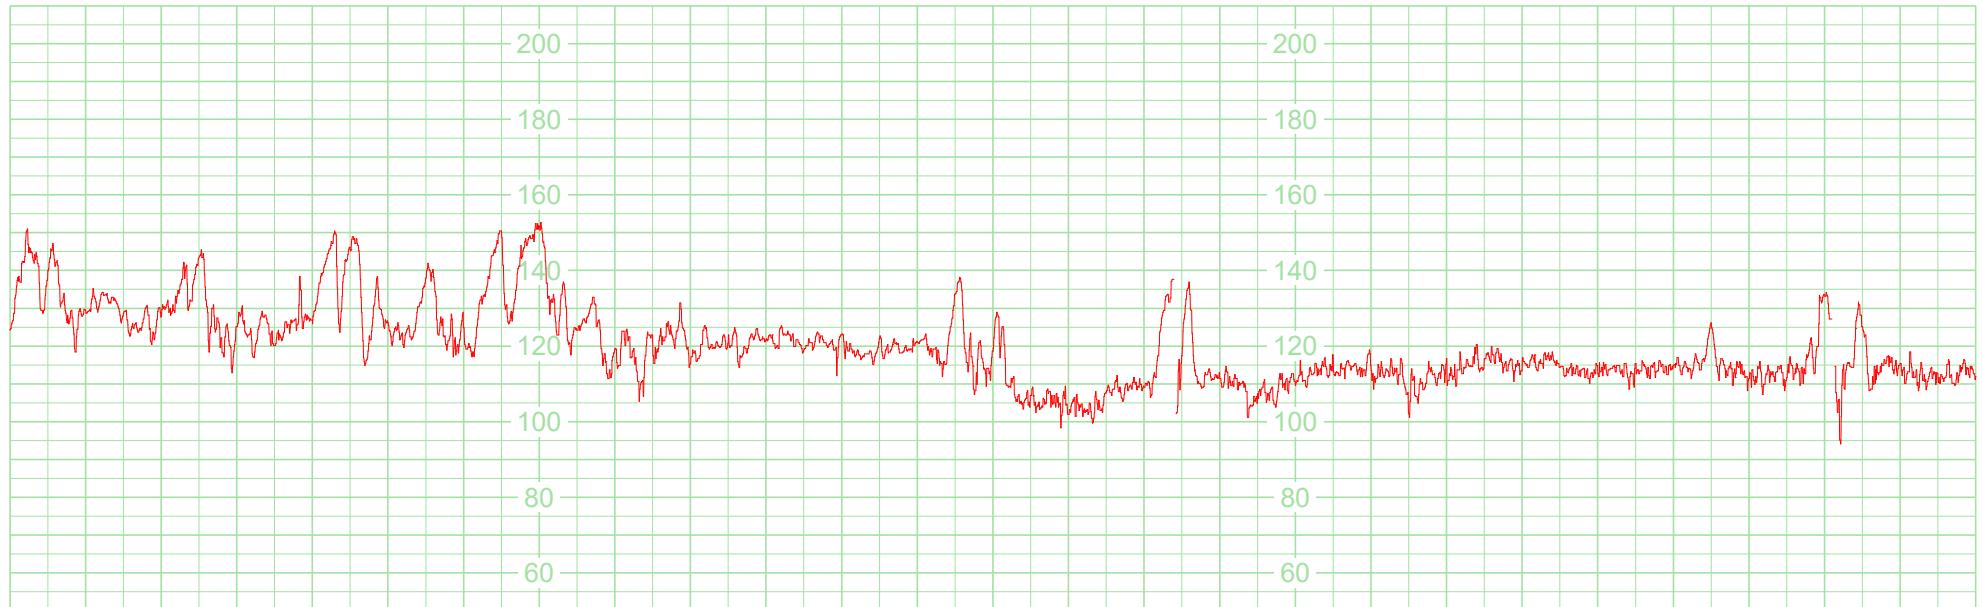



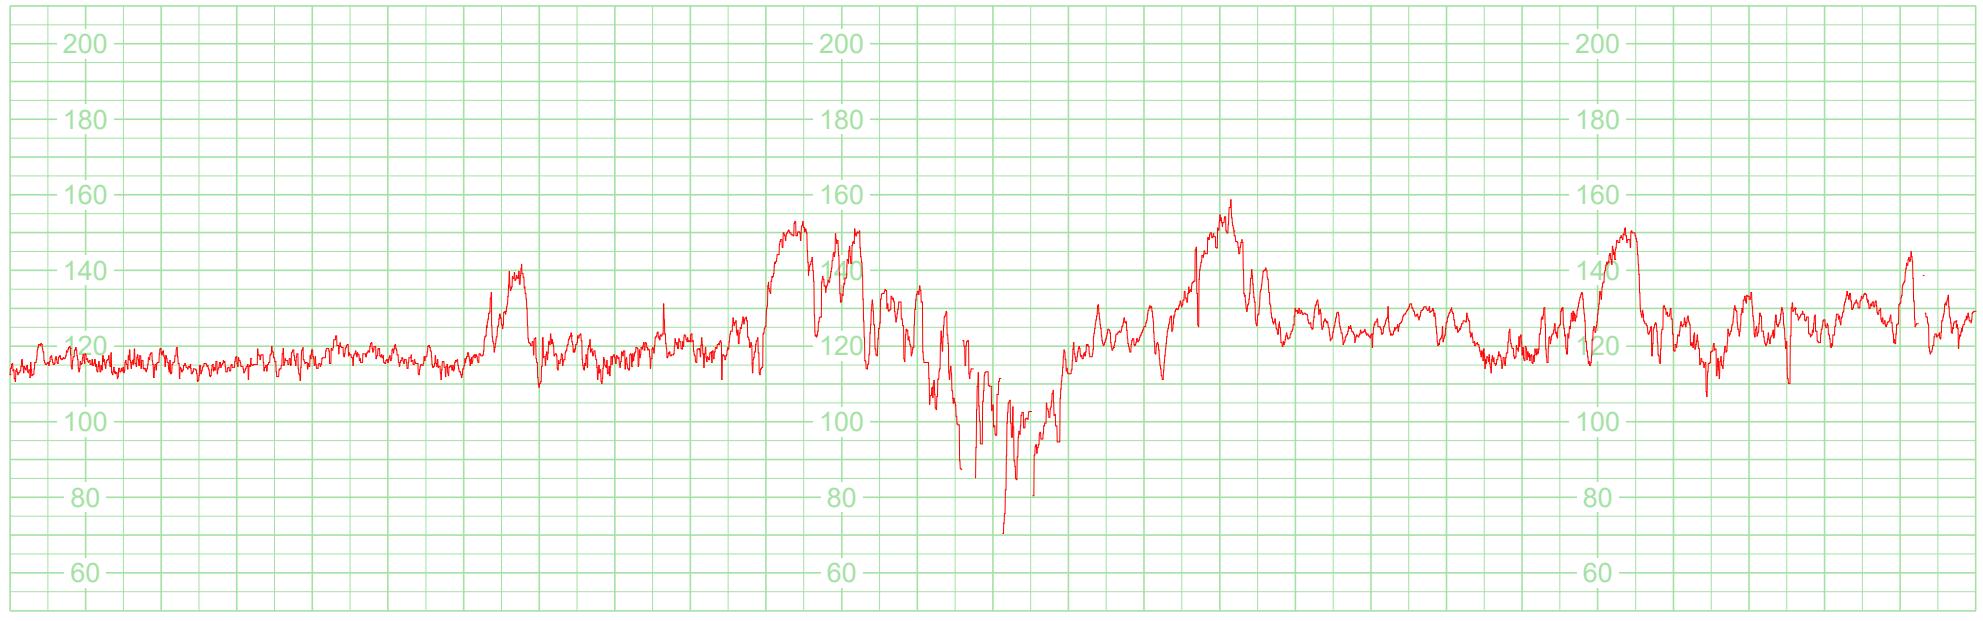



— ** FCF1: BRADICARDIA
— Alarma con acuse de recibo


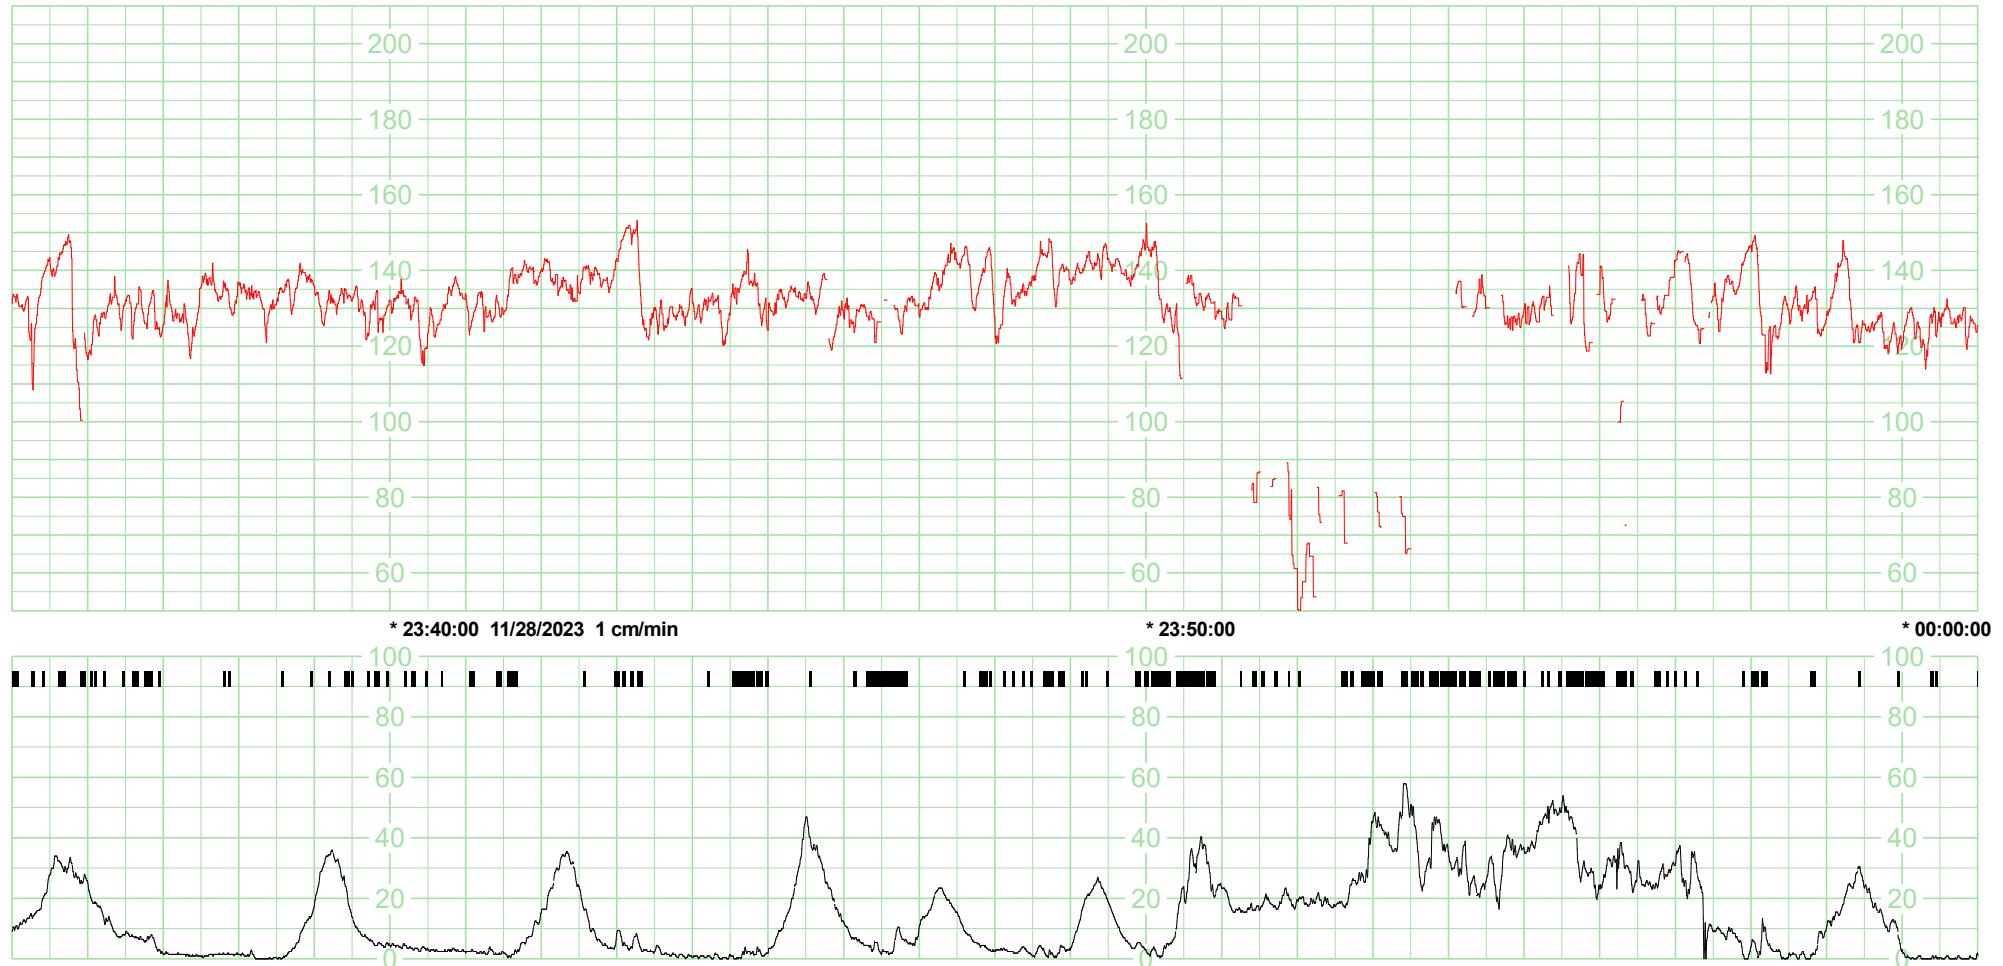


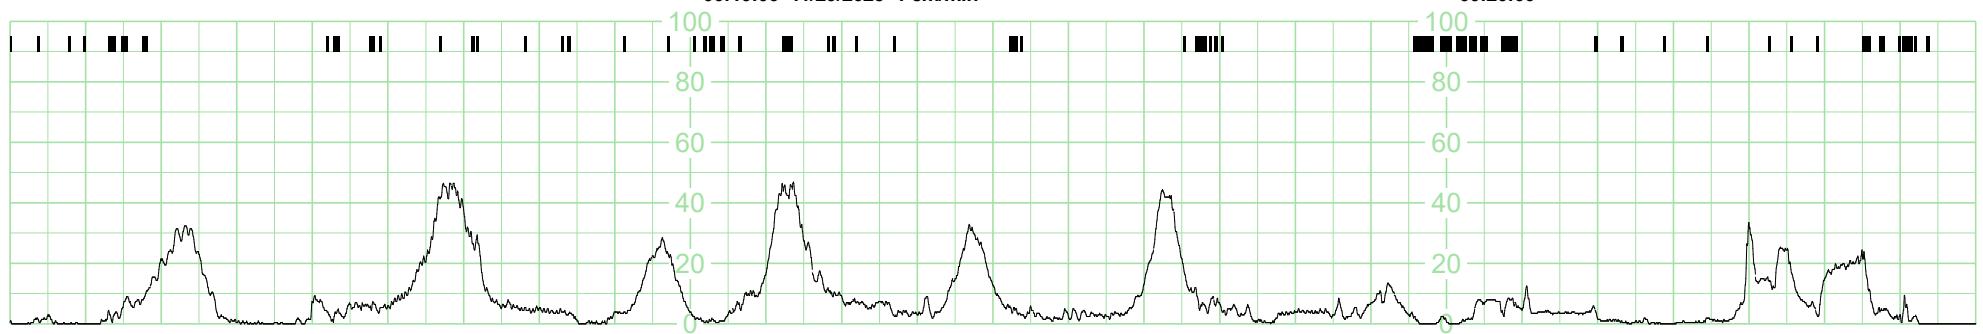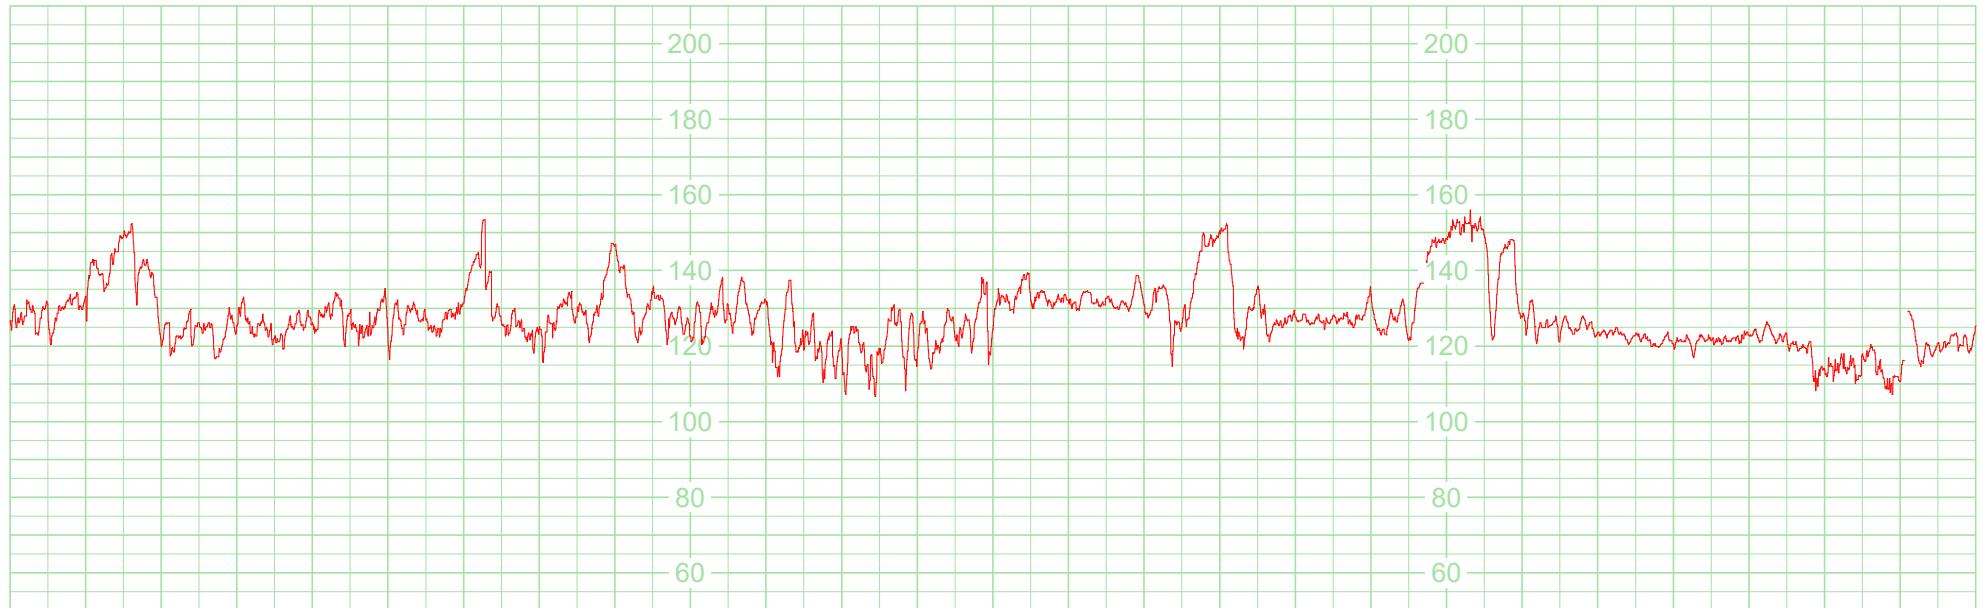


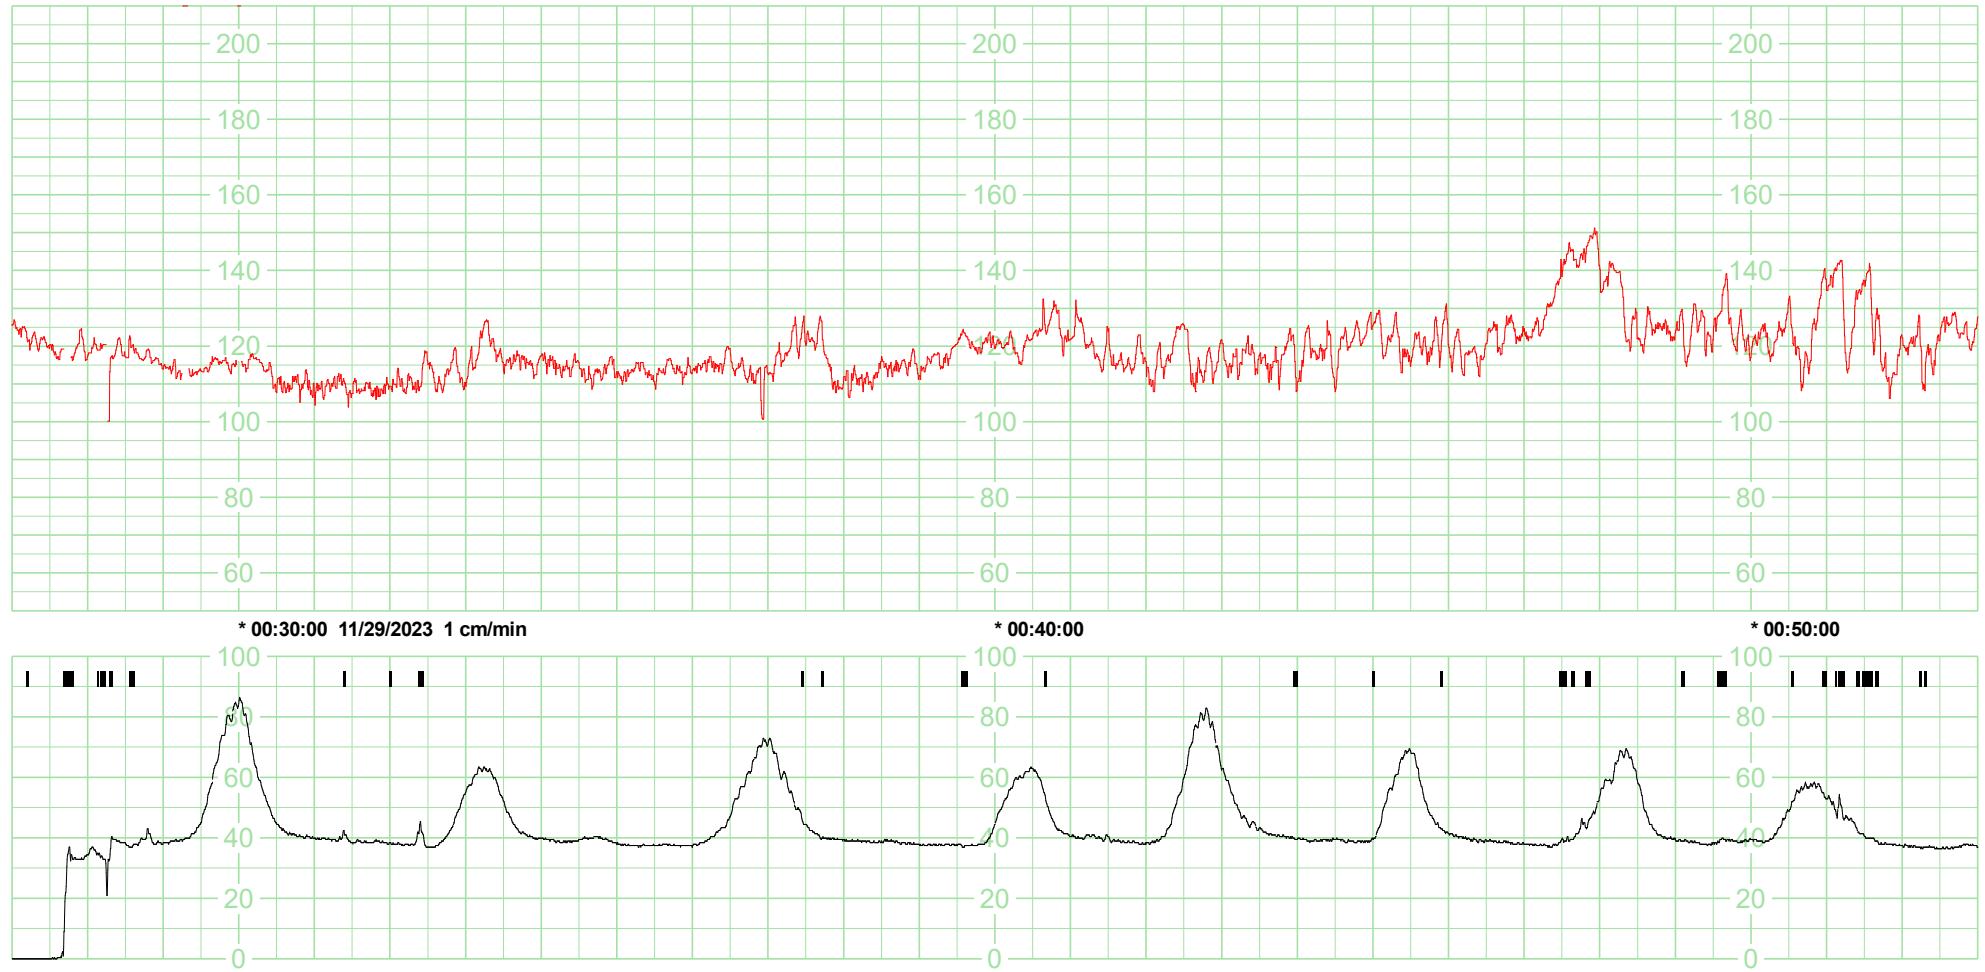

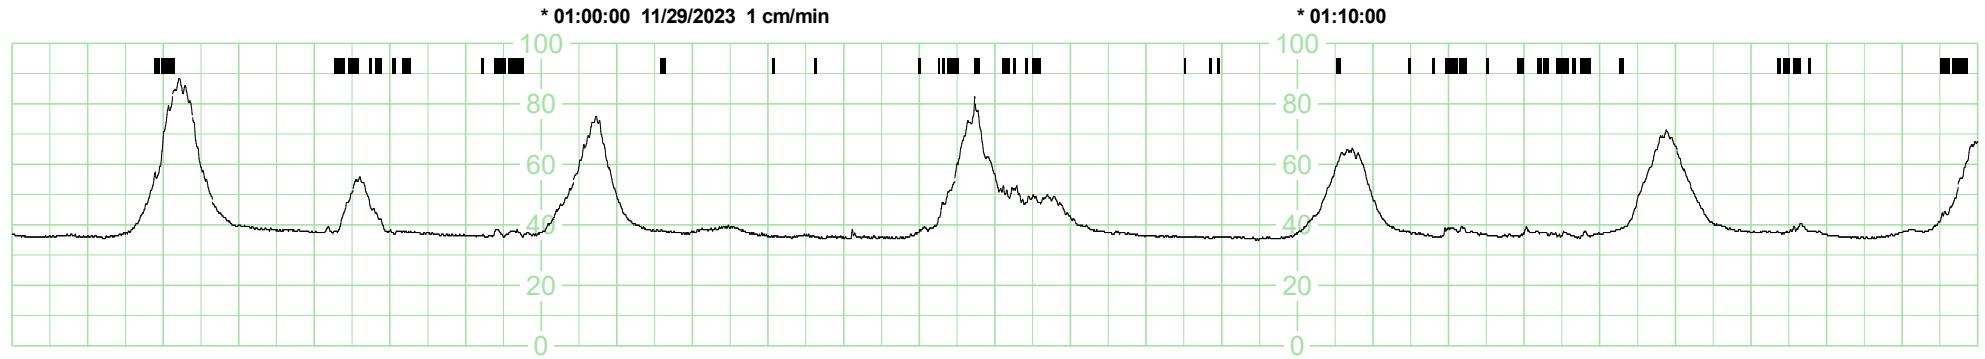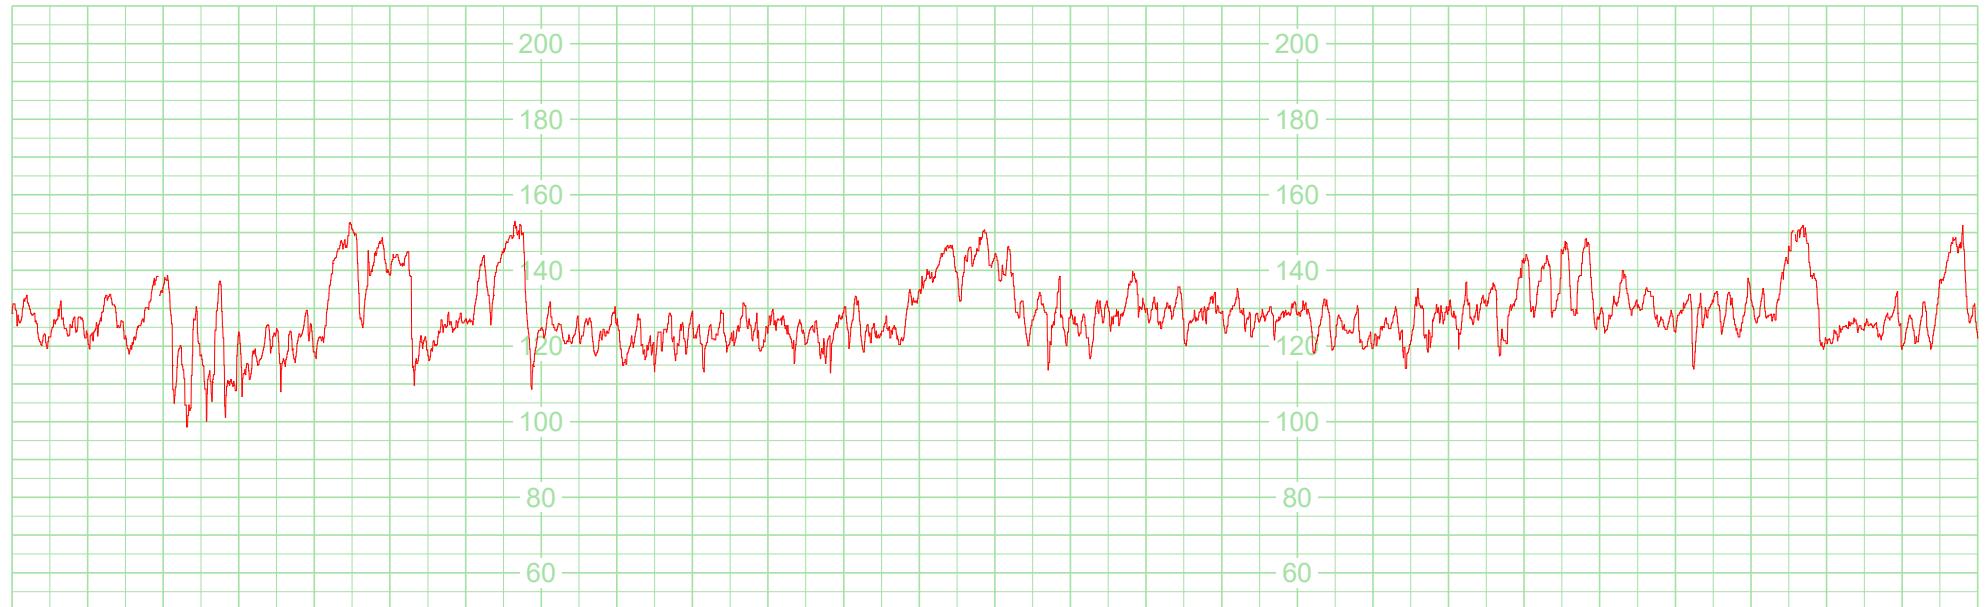


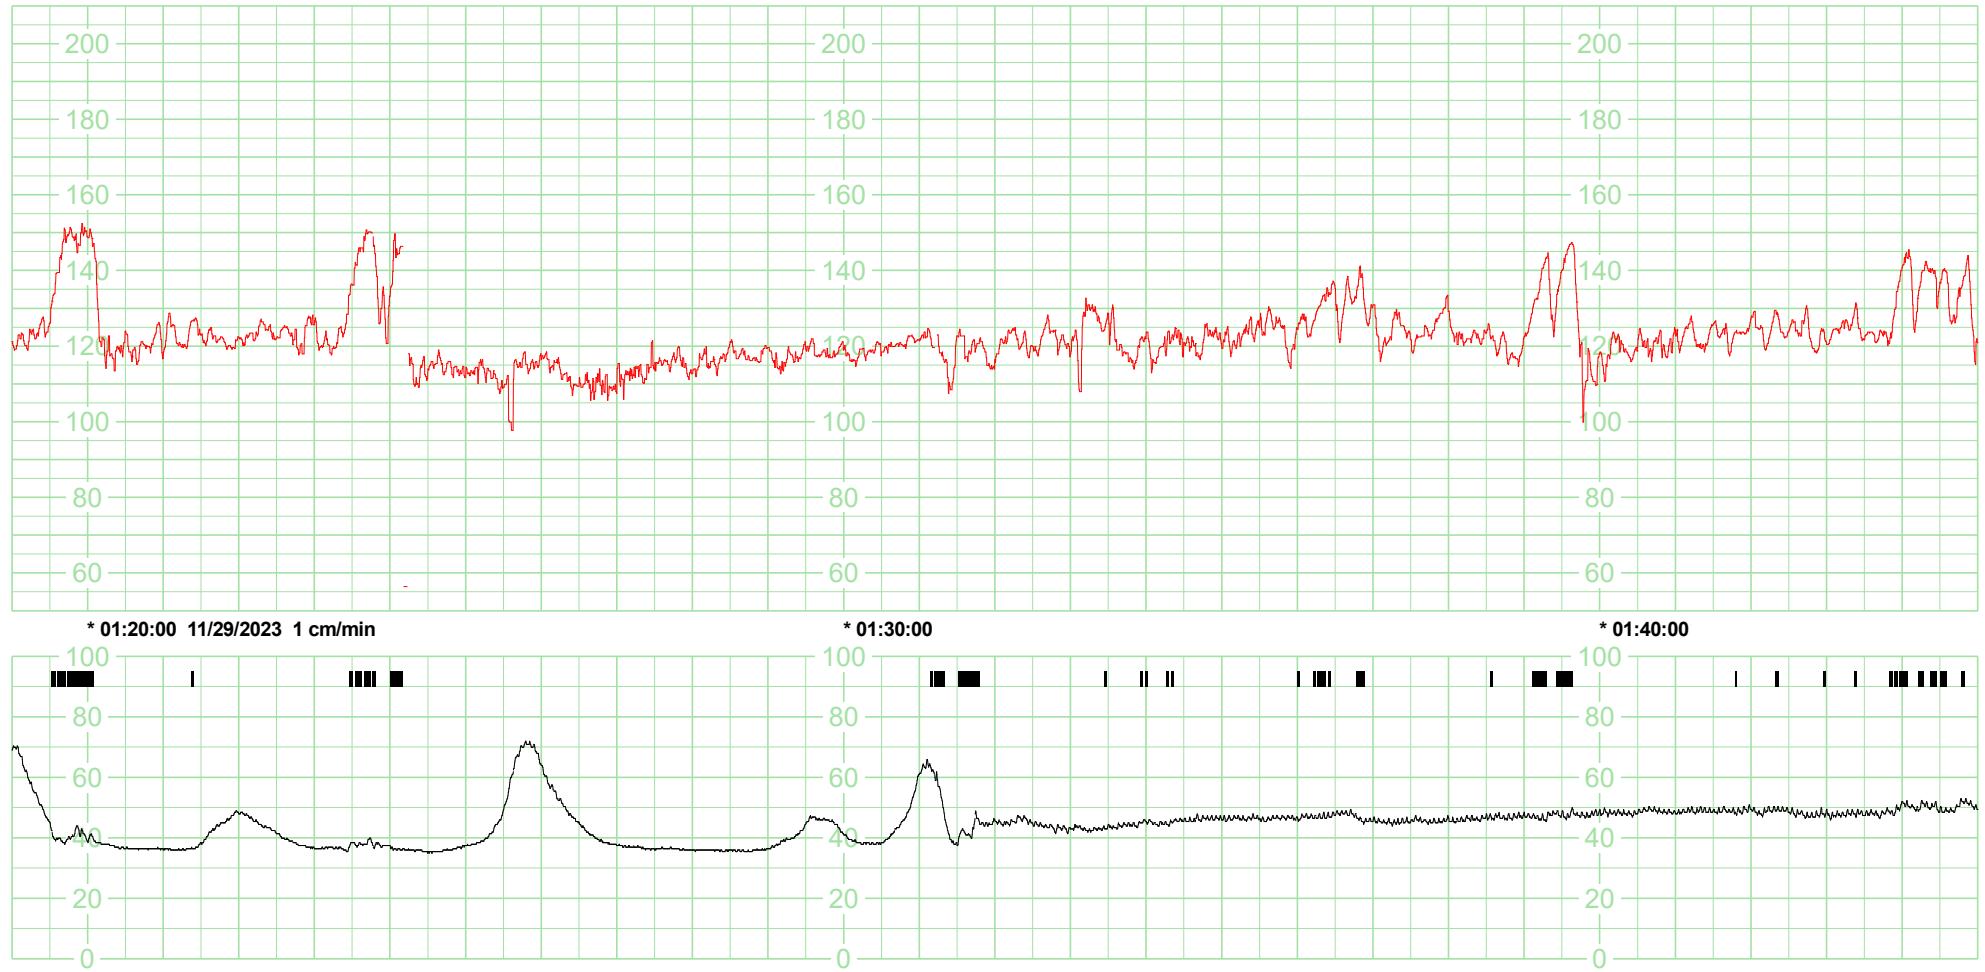

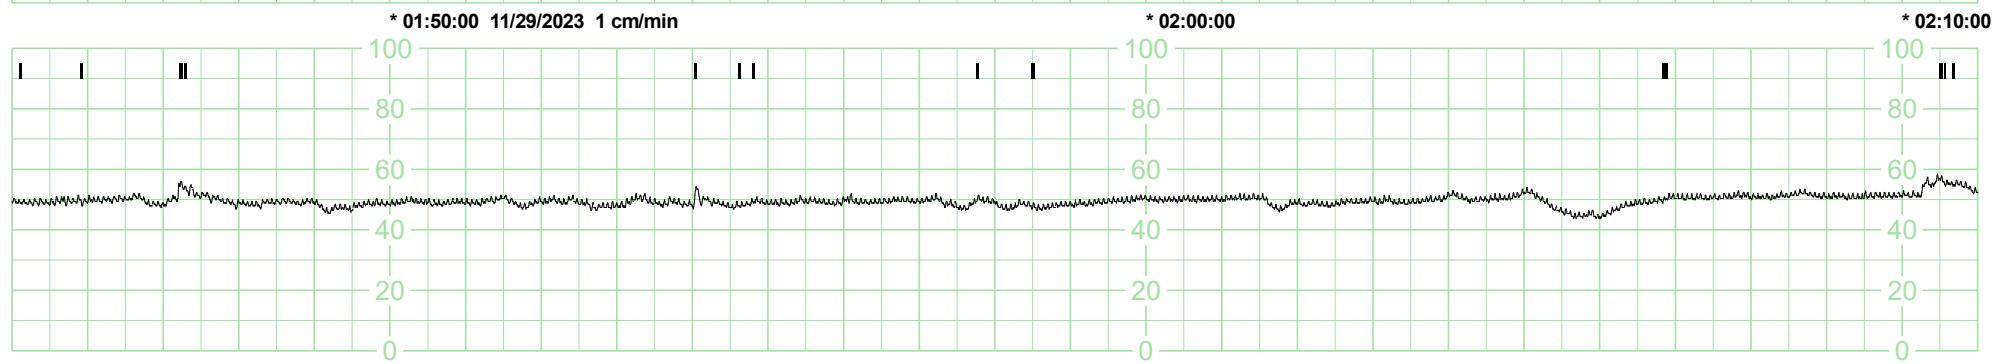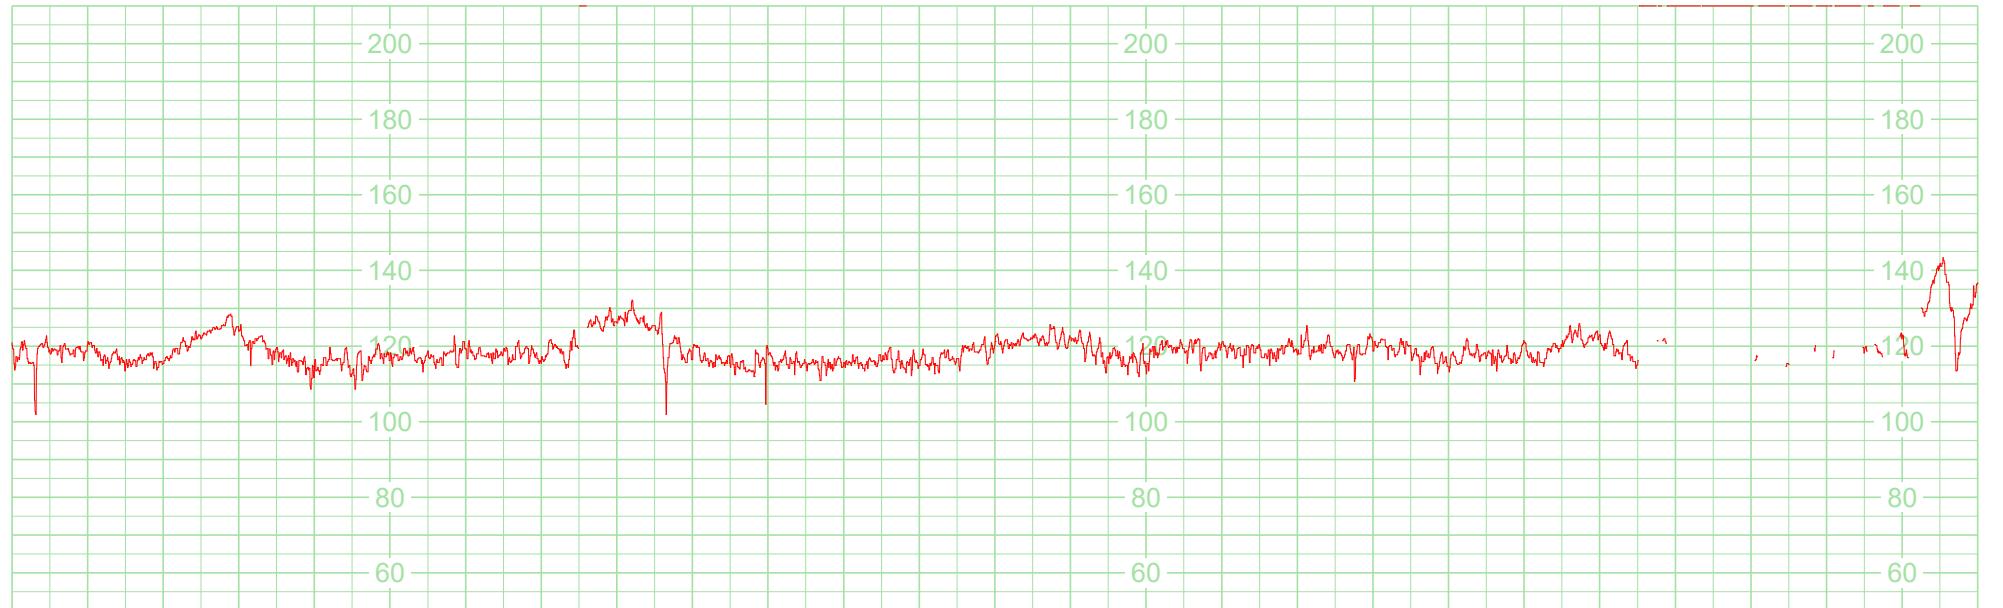

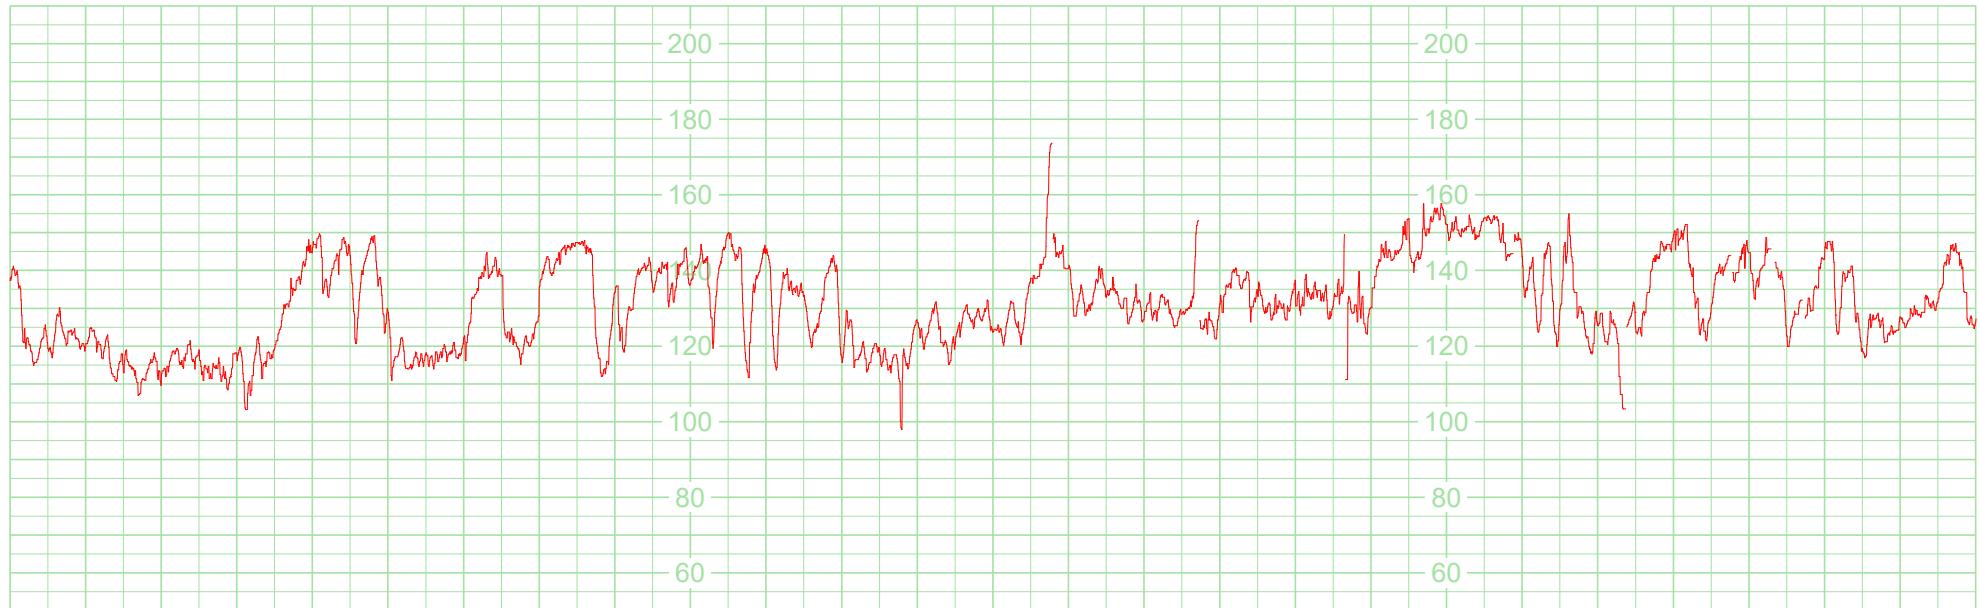



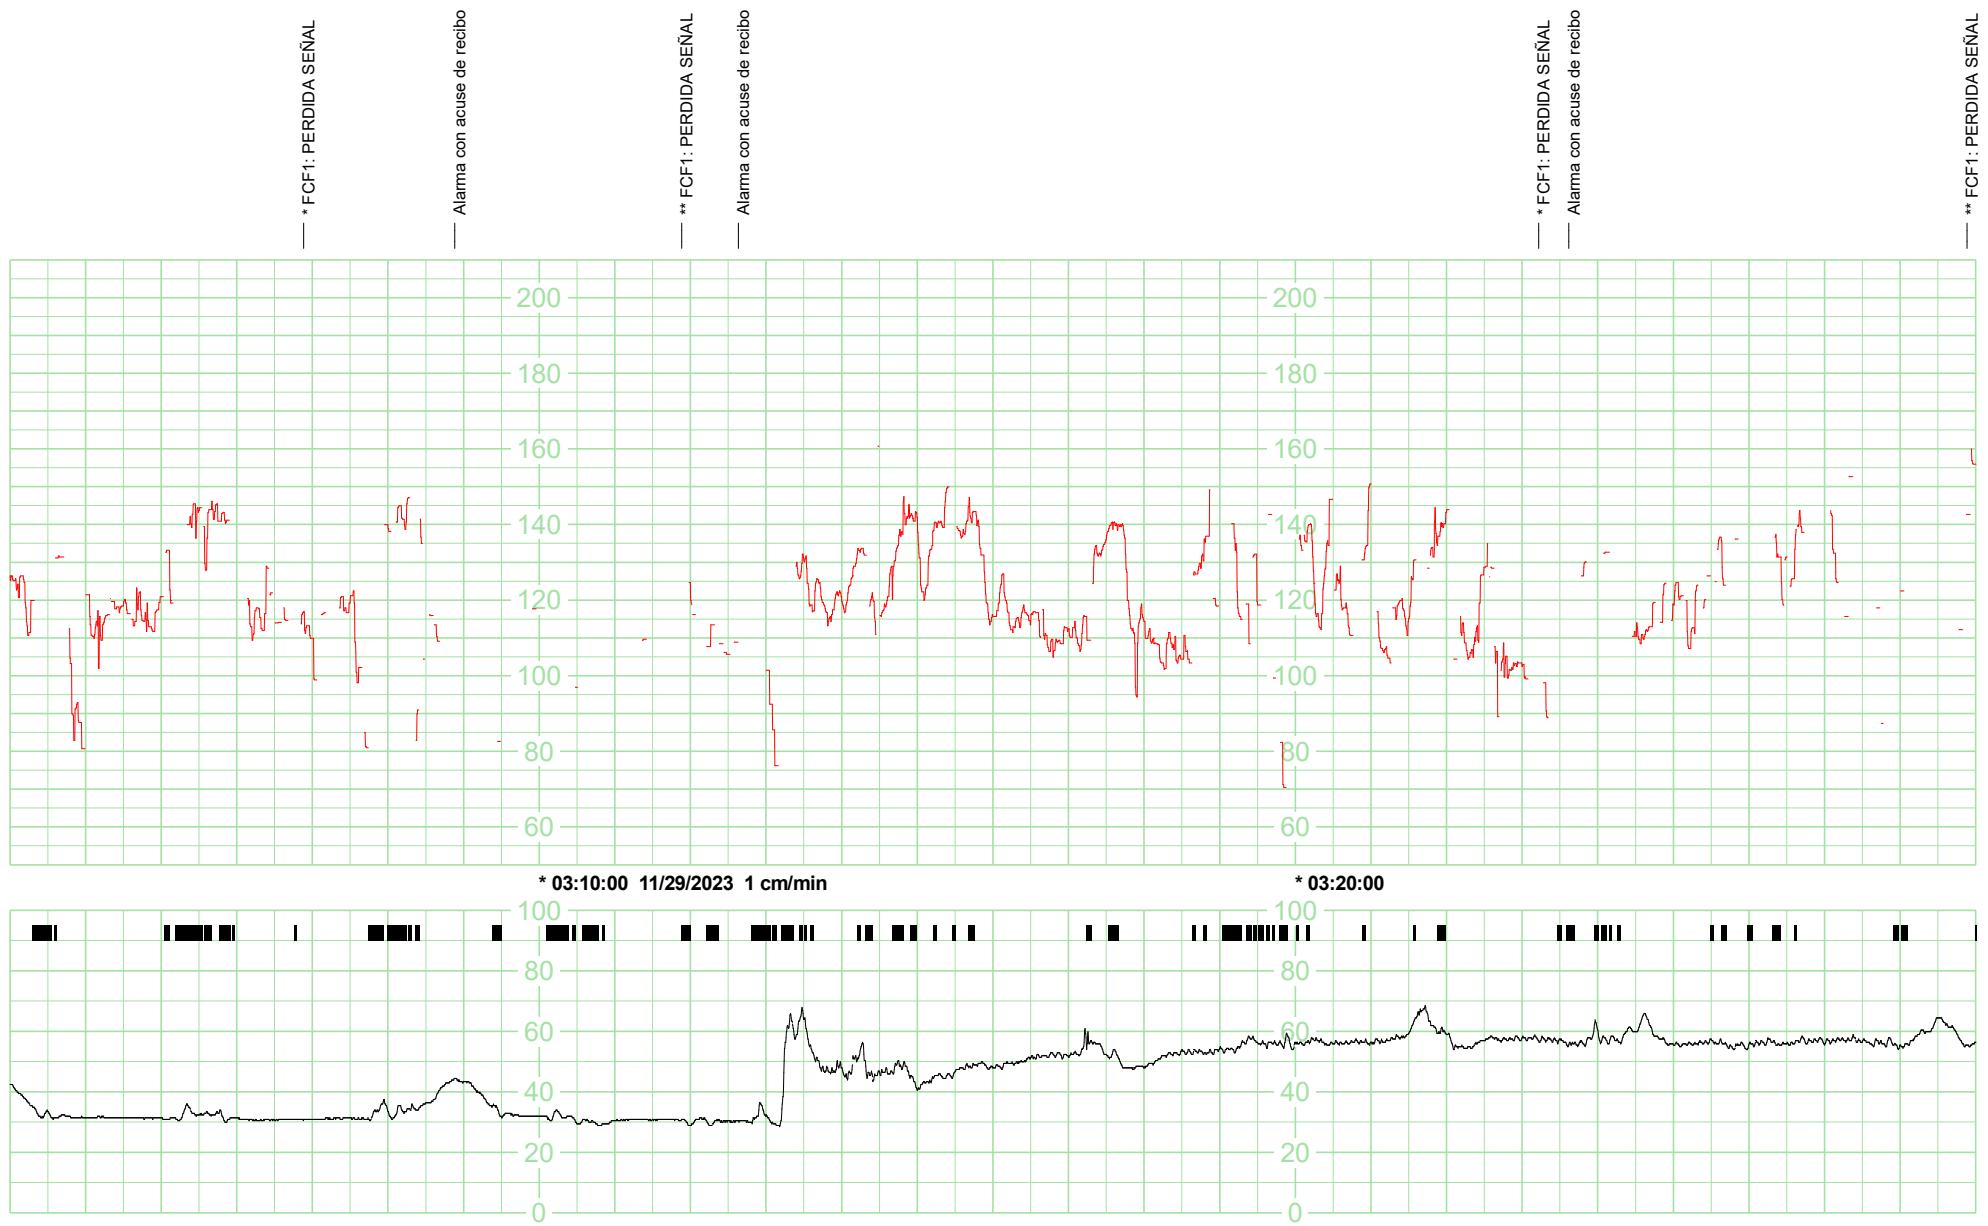



— Alarma con acuse de recibo

* FCF1: PERDIDA SEÑAL
— Alarma con acuse de recibo

** FCF1: BRADICARDIA
— Alarma con acuse de recibo

** FCF1: BRADICARDIA
— Alarma con acuse de recibo

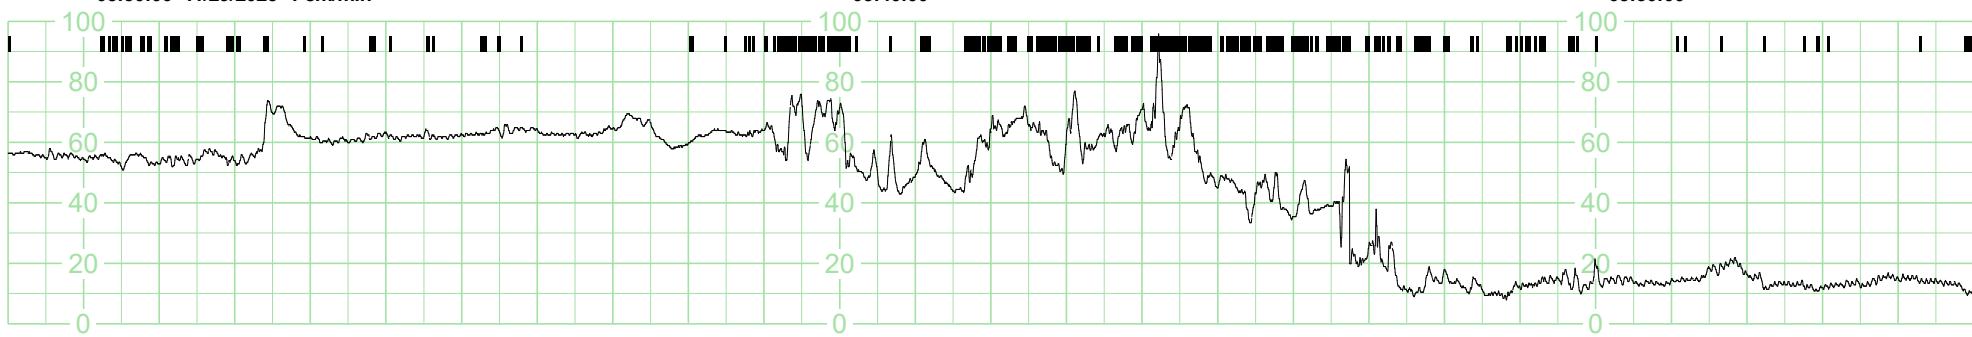


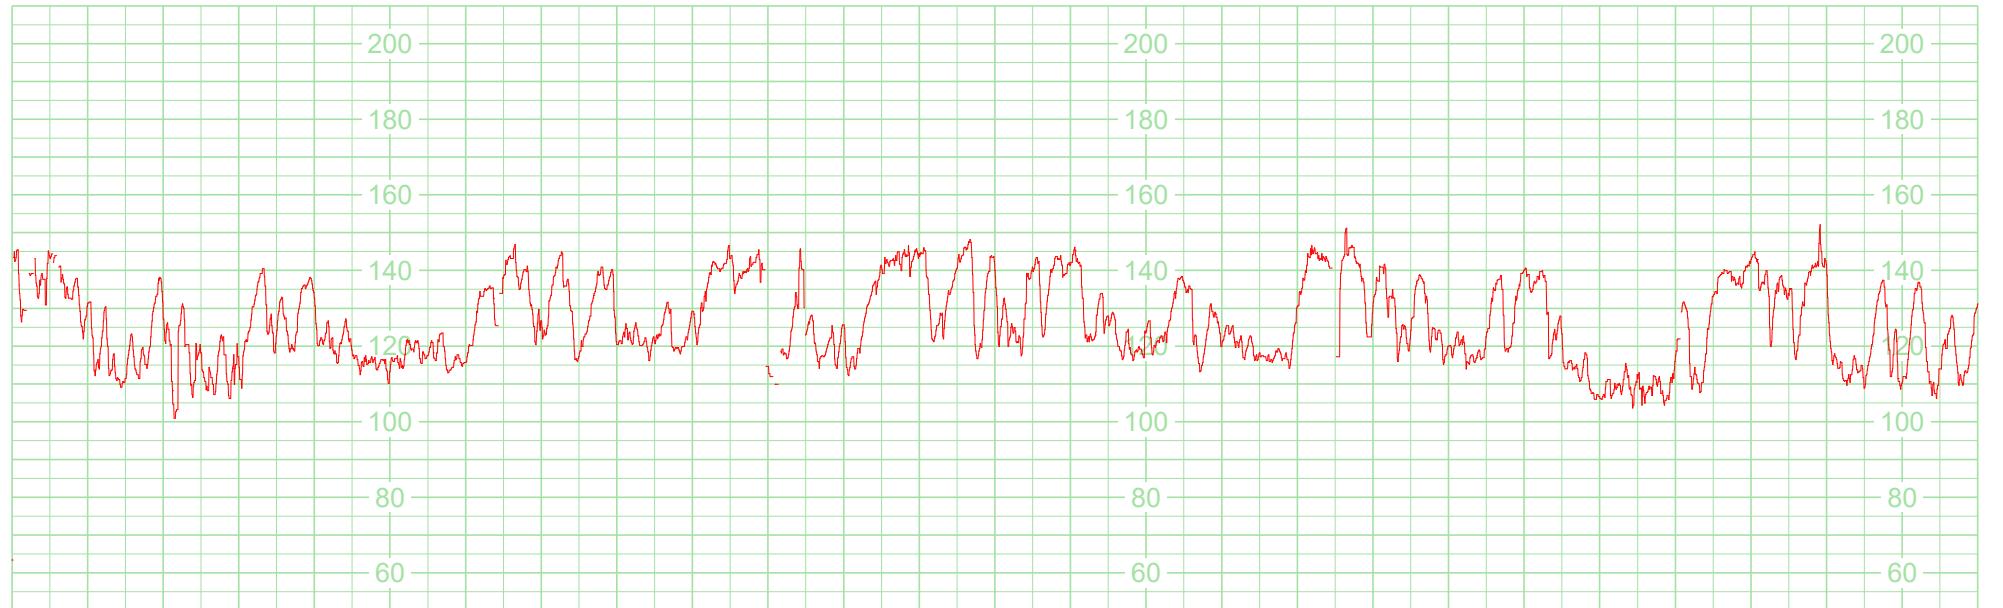




* 04:00:00 11/29/2023 1 cm/min

* 04:10:00

* 04:20:00

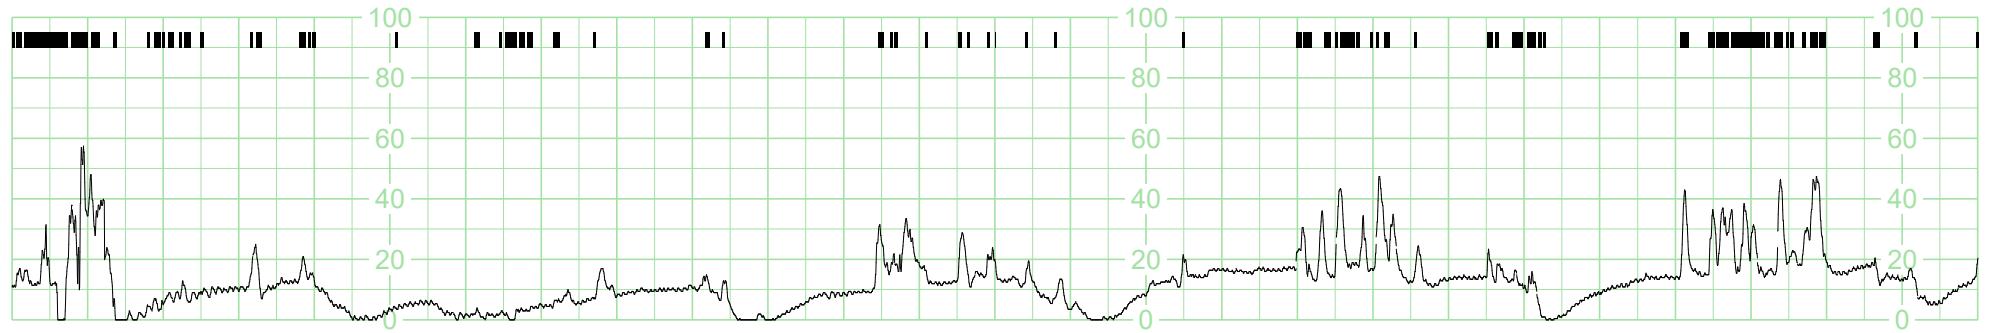


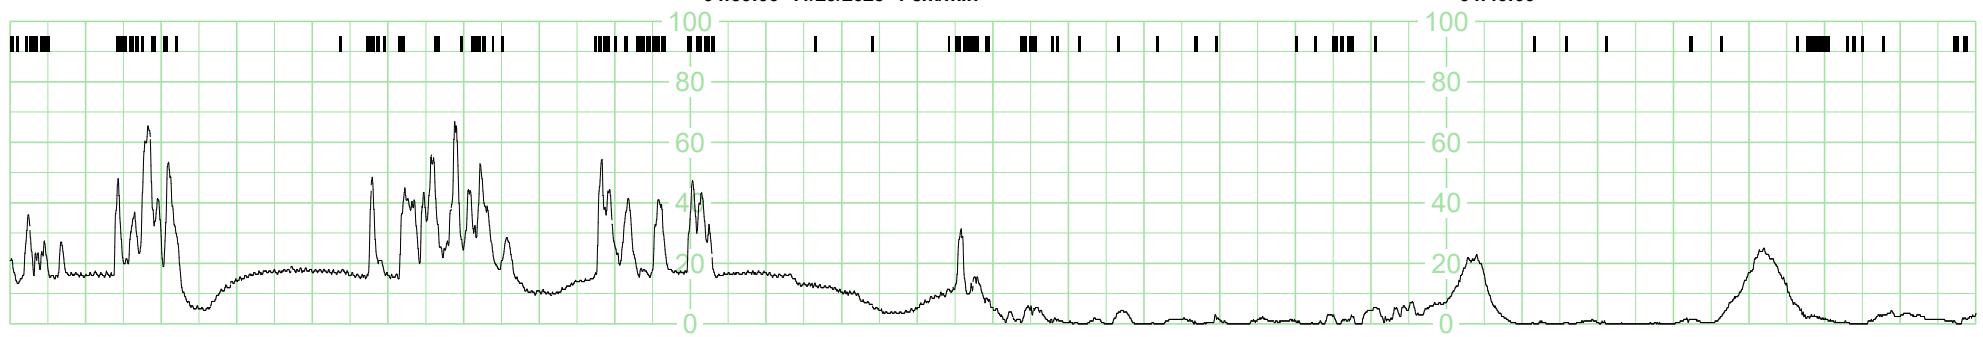


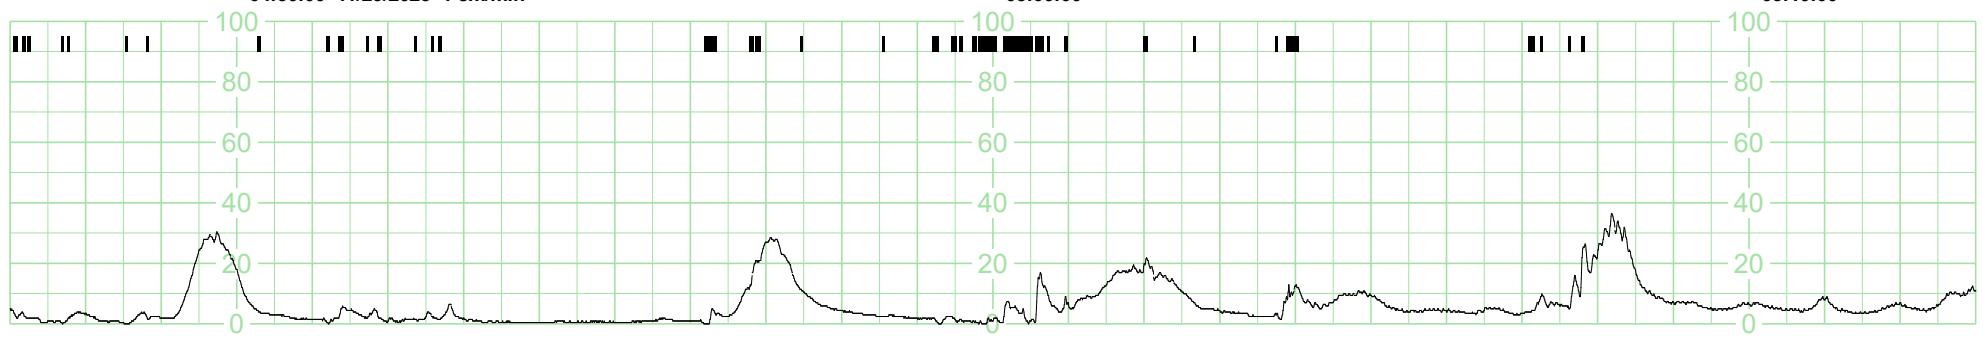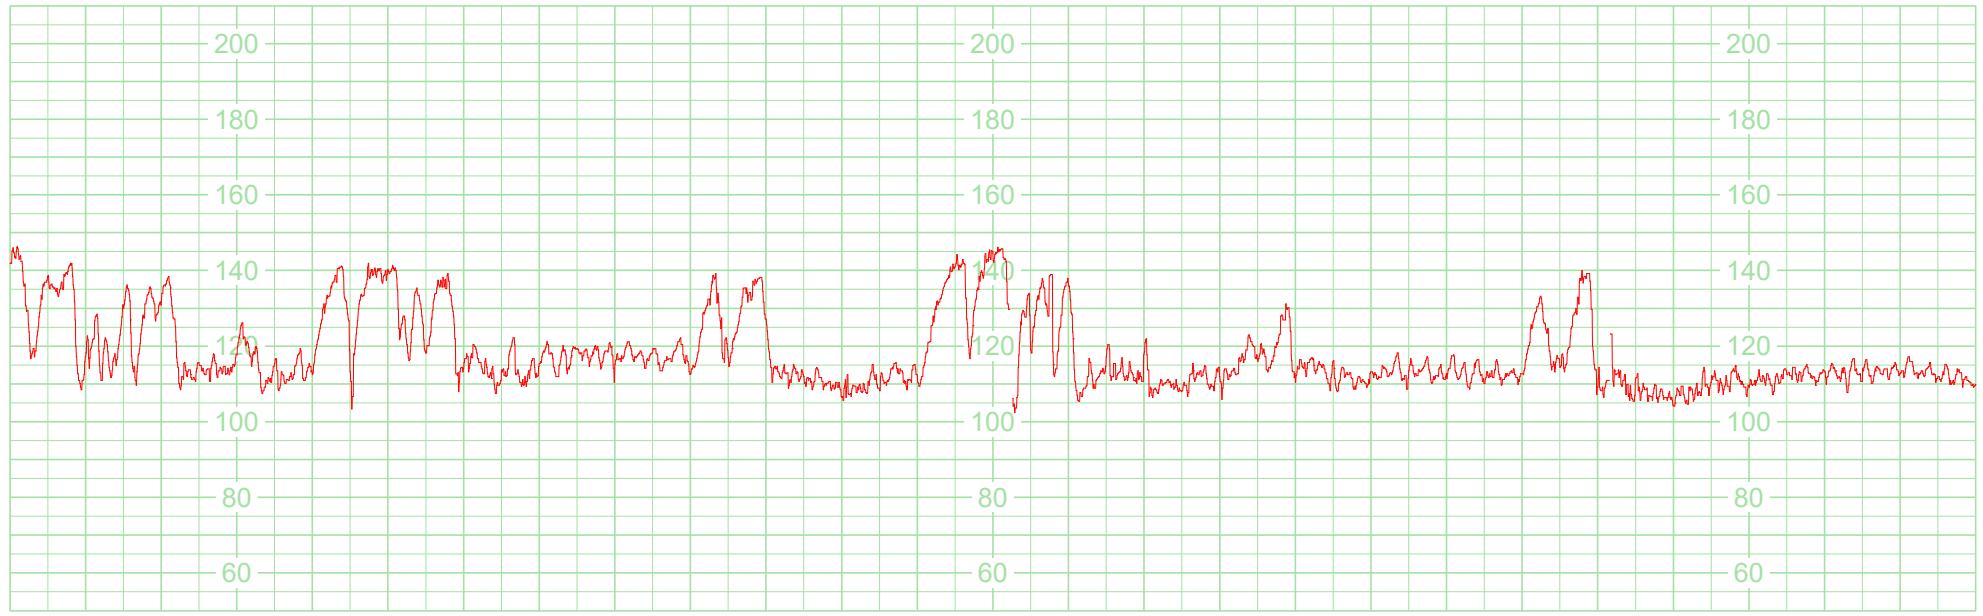








* 05:20:00 11/29/2023 1 cm/min

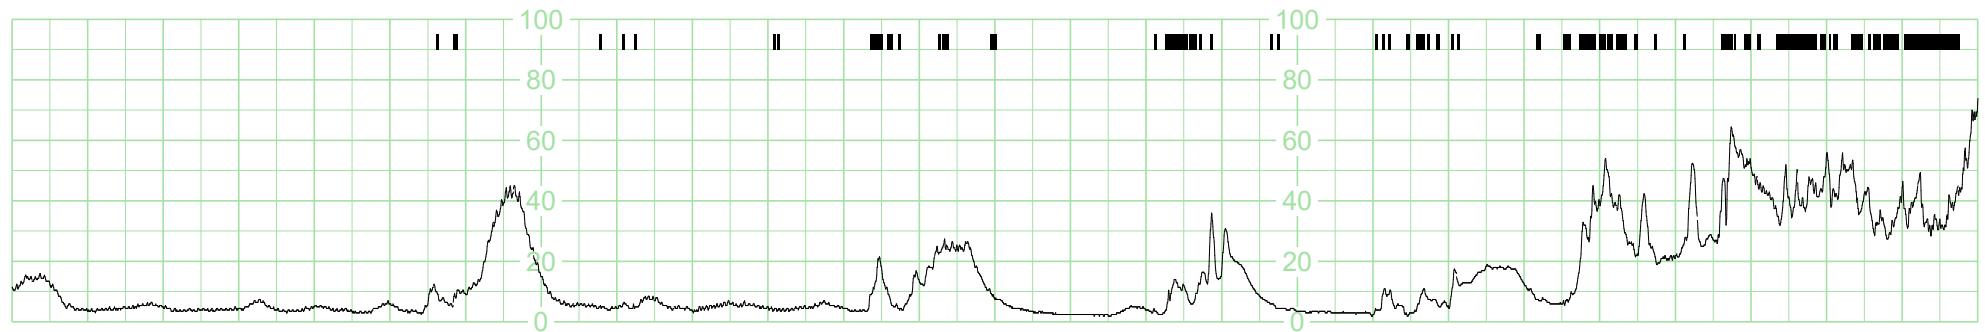

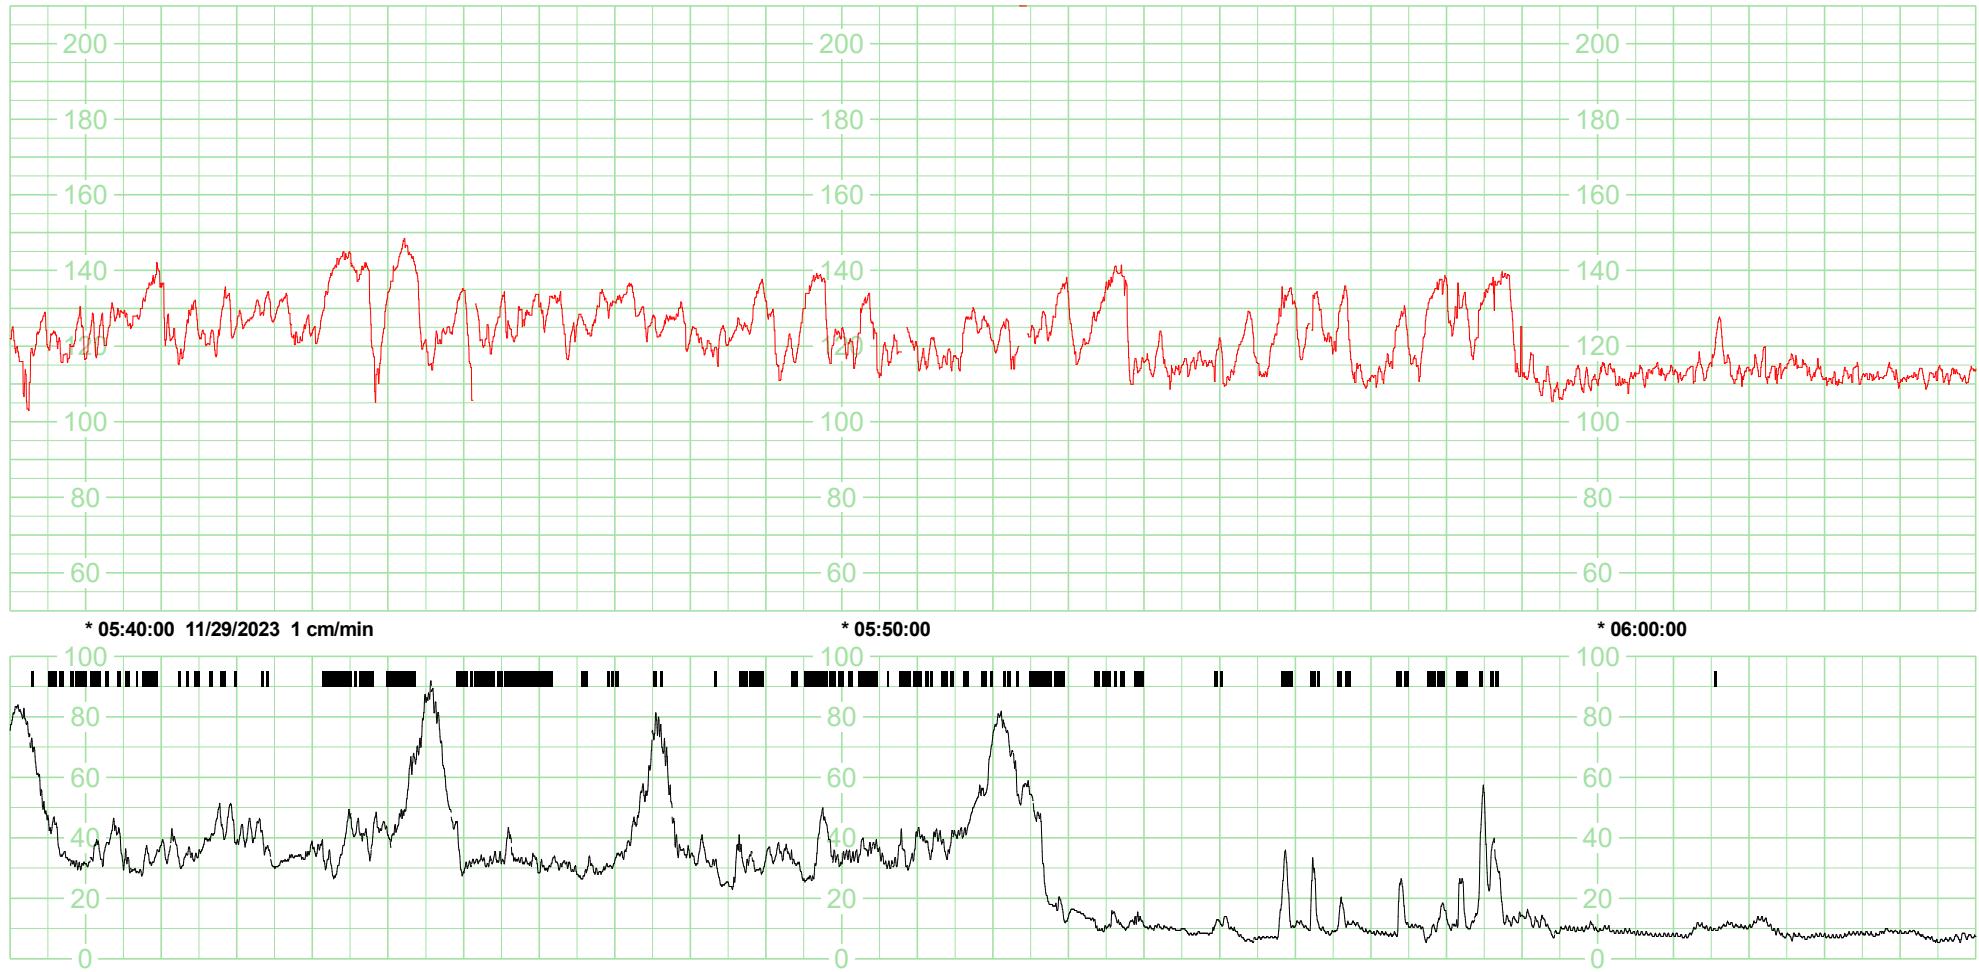

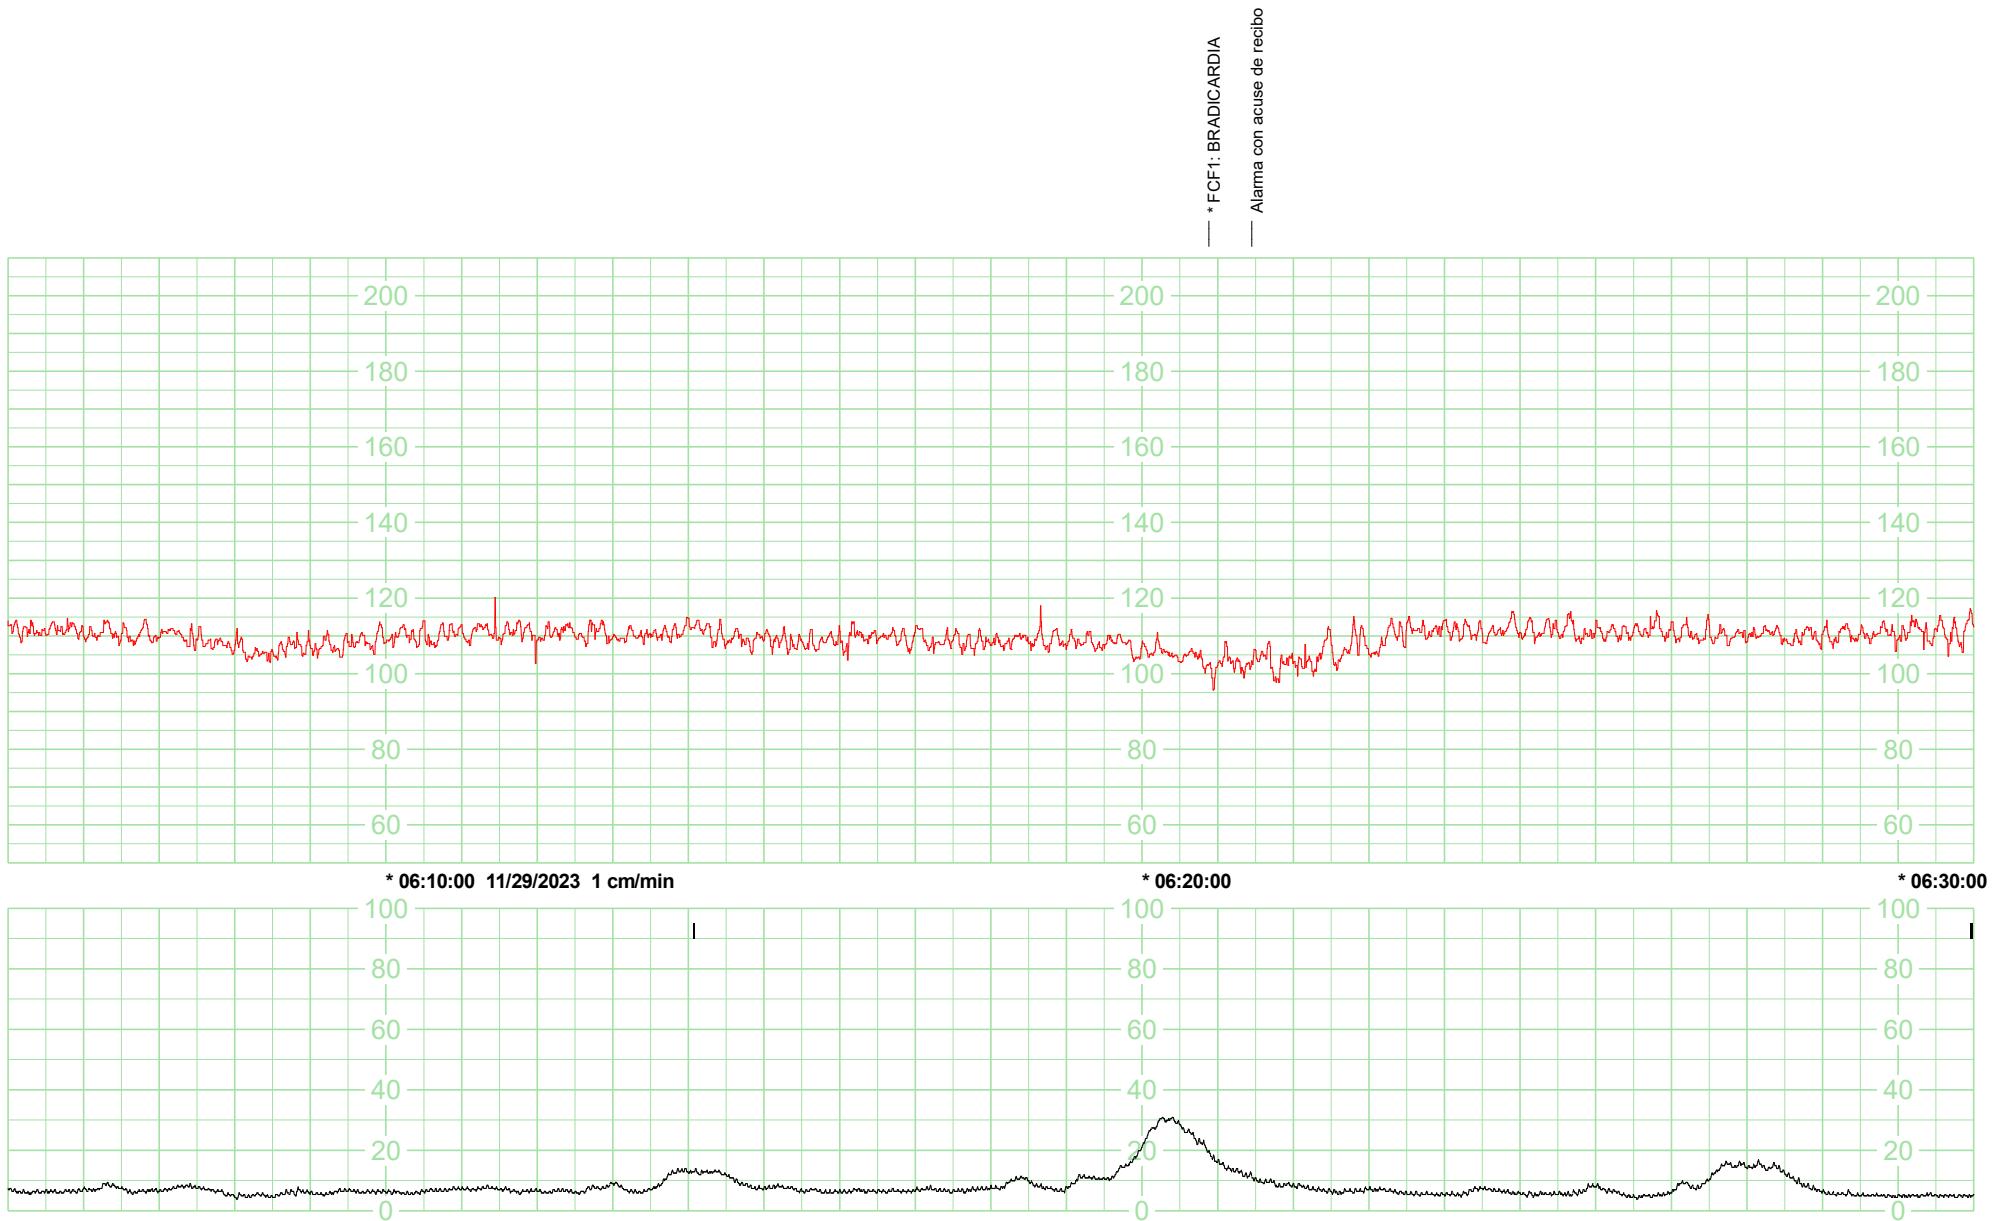

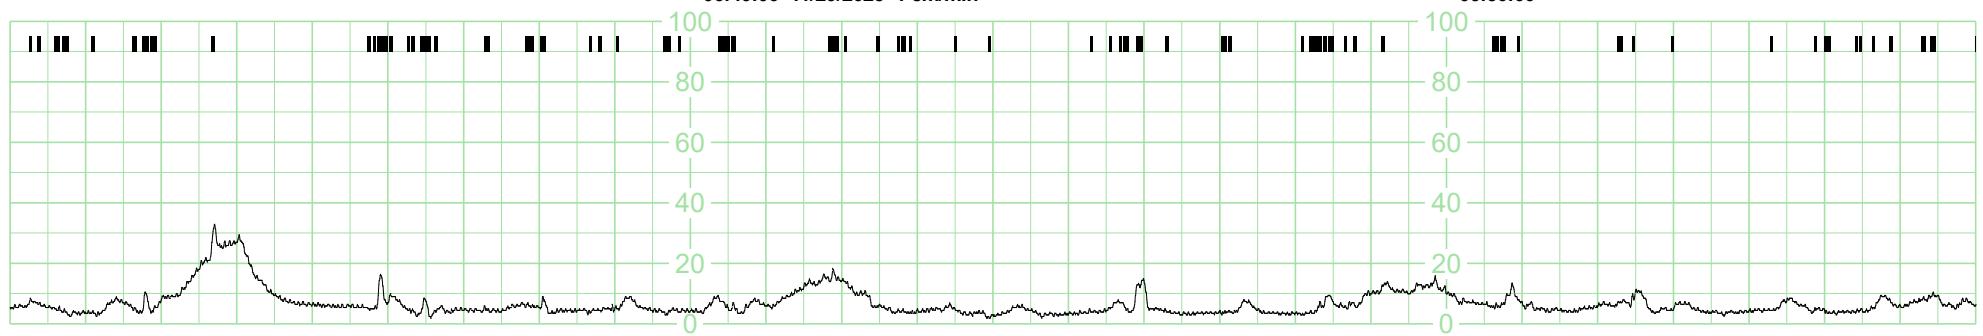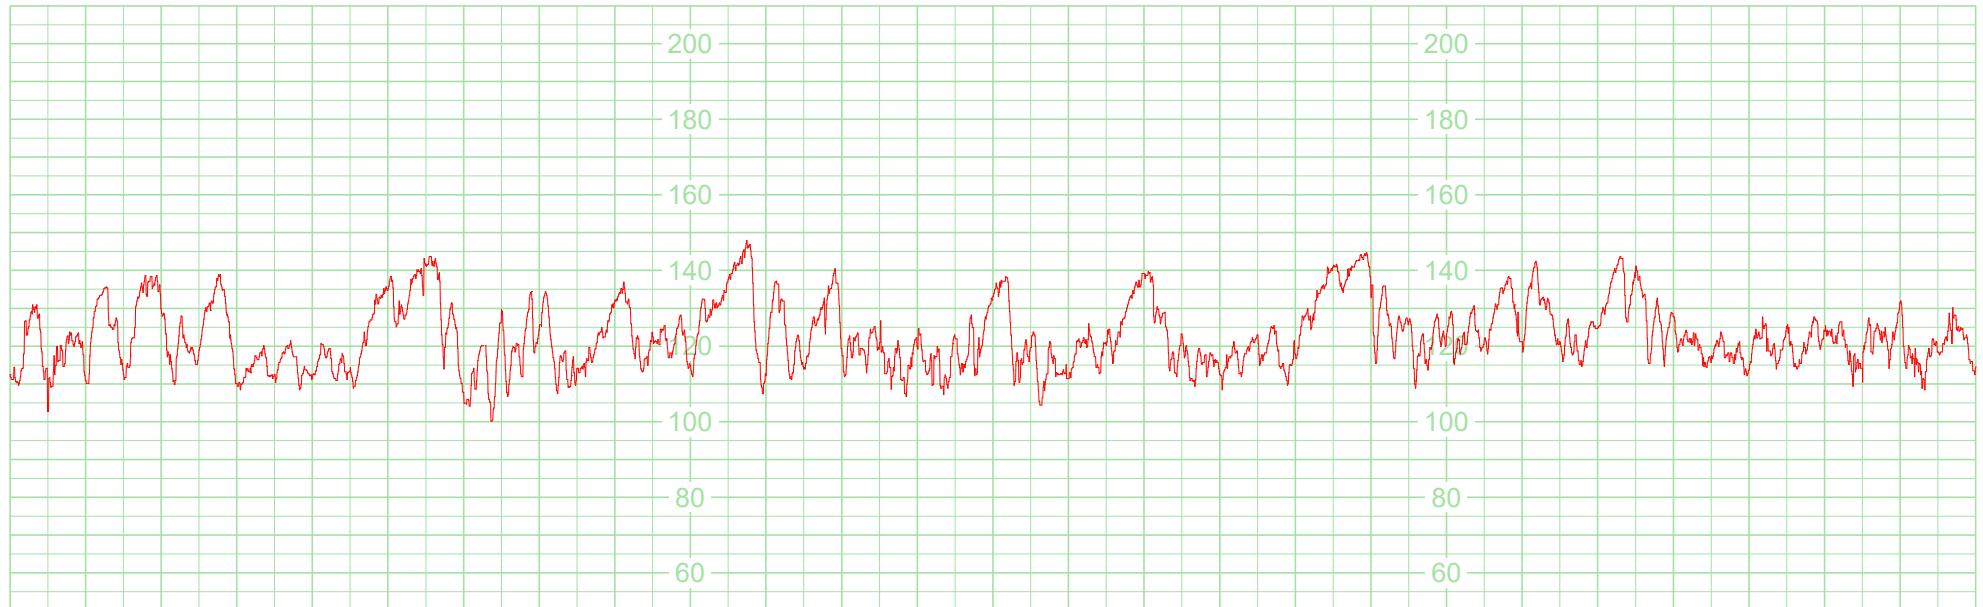


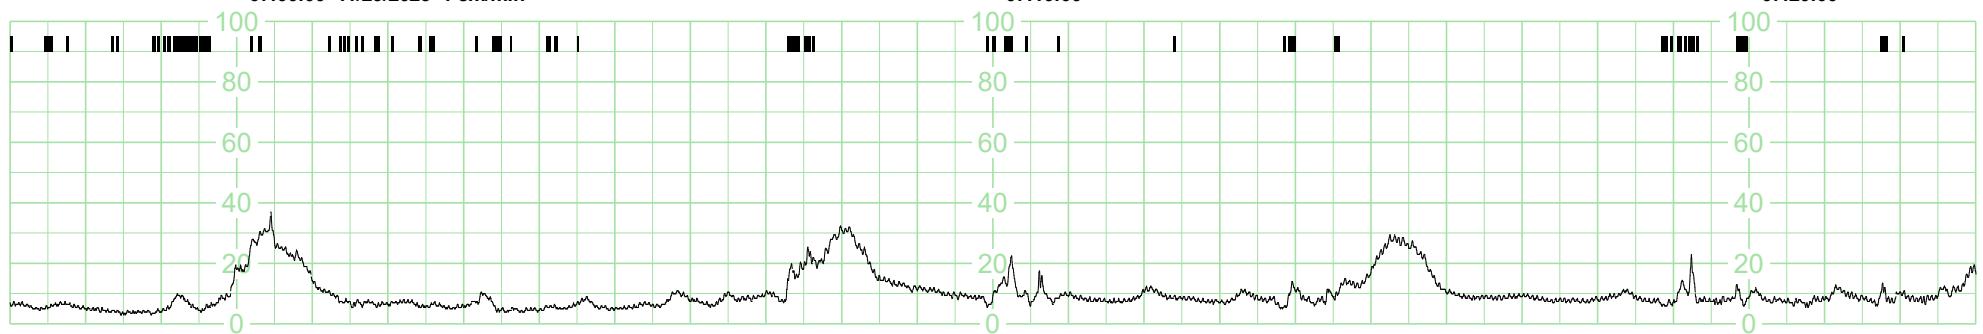
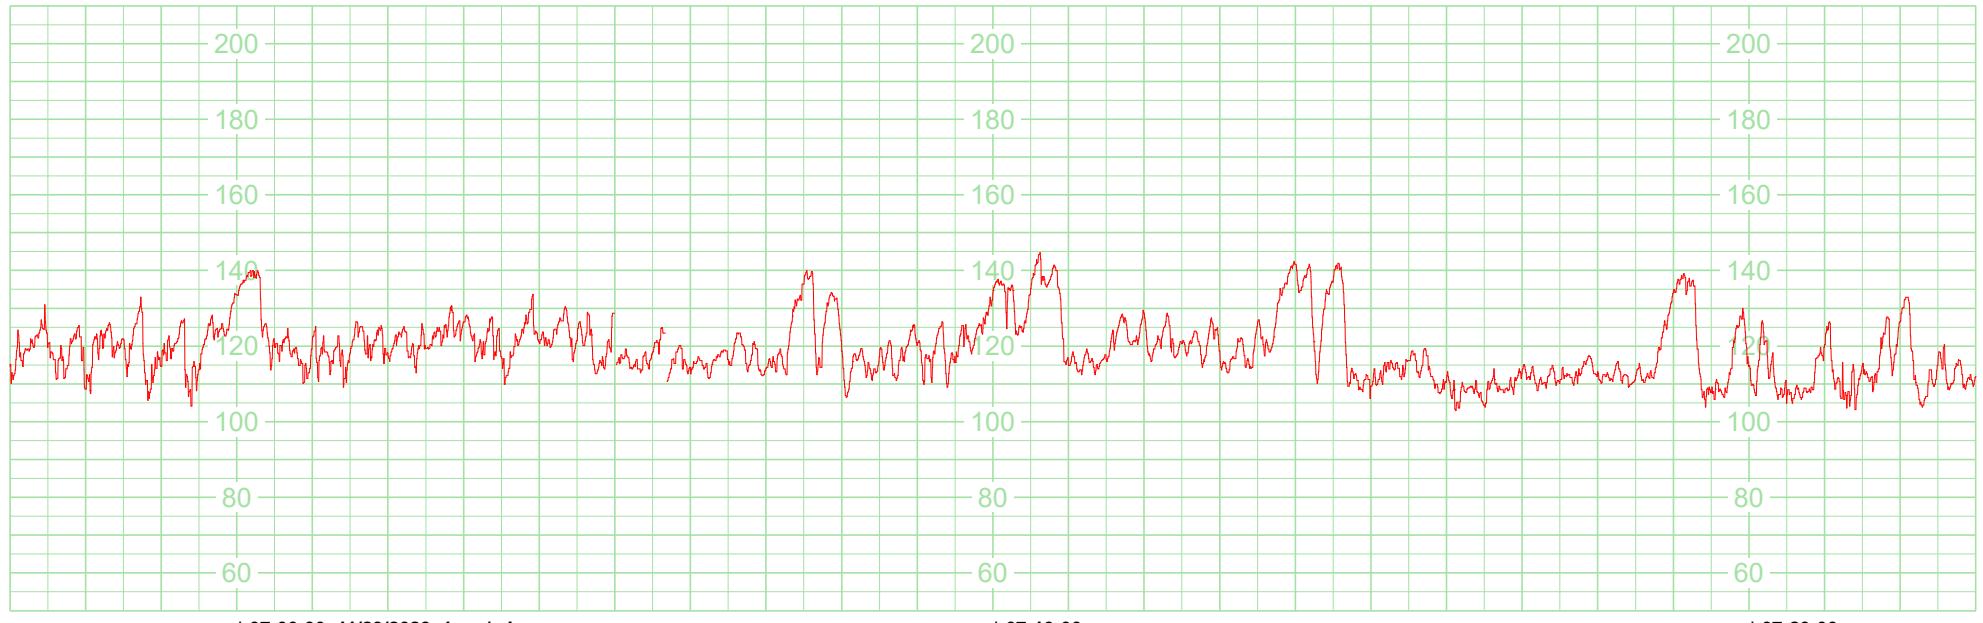





Estado del monitor: Activado
Estado del registrador: Activado
Estado de la telemetría: Activado
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
Modo Toco: externo
* FCF1: PERDIDA SEÑAL


— Alarma con acuse de recibo


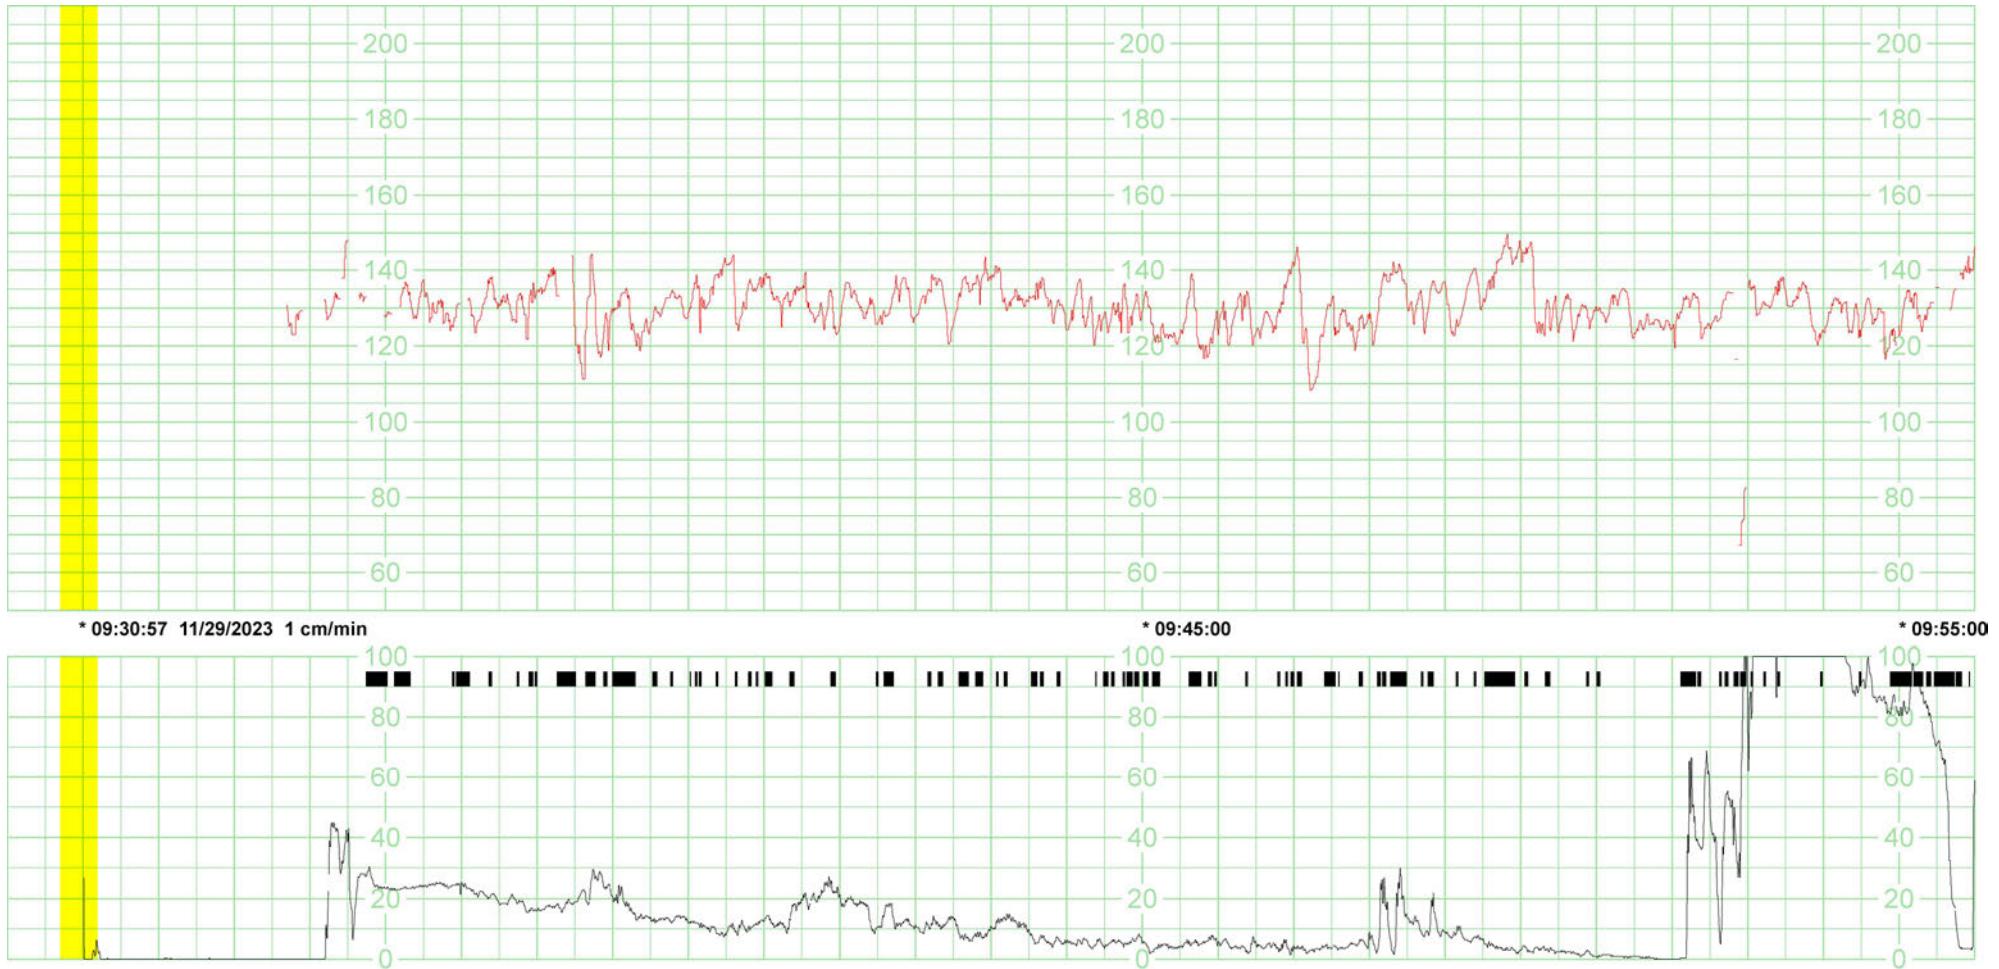


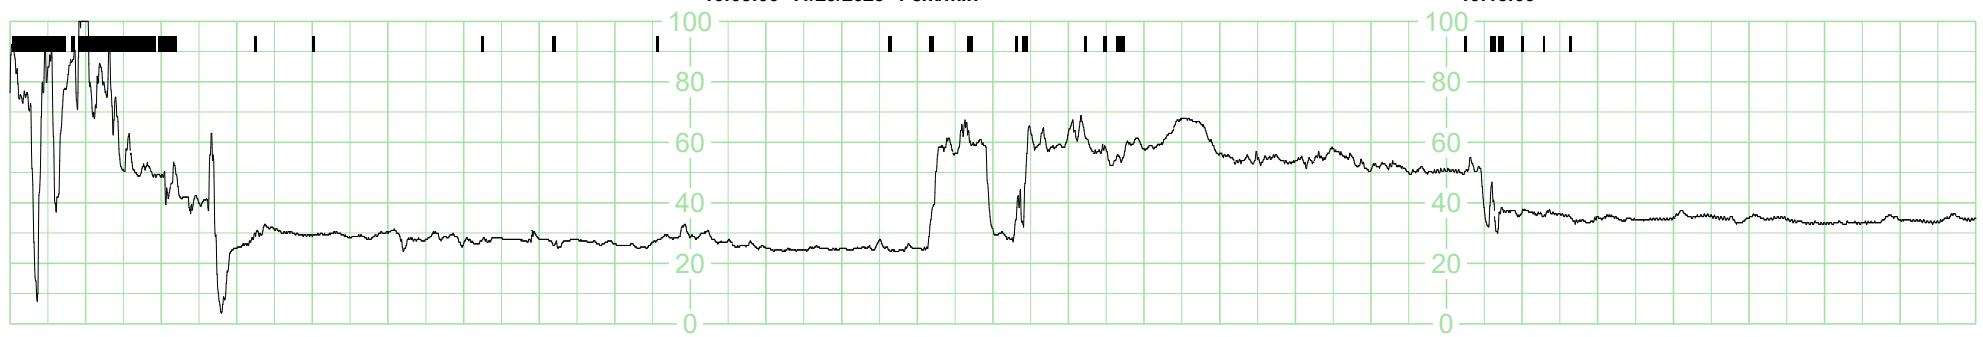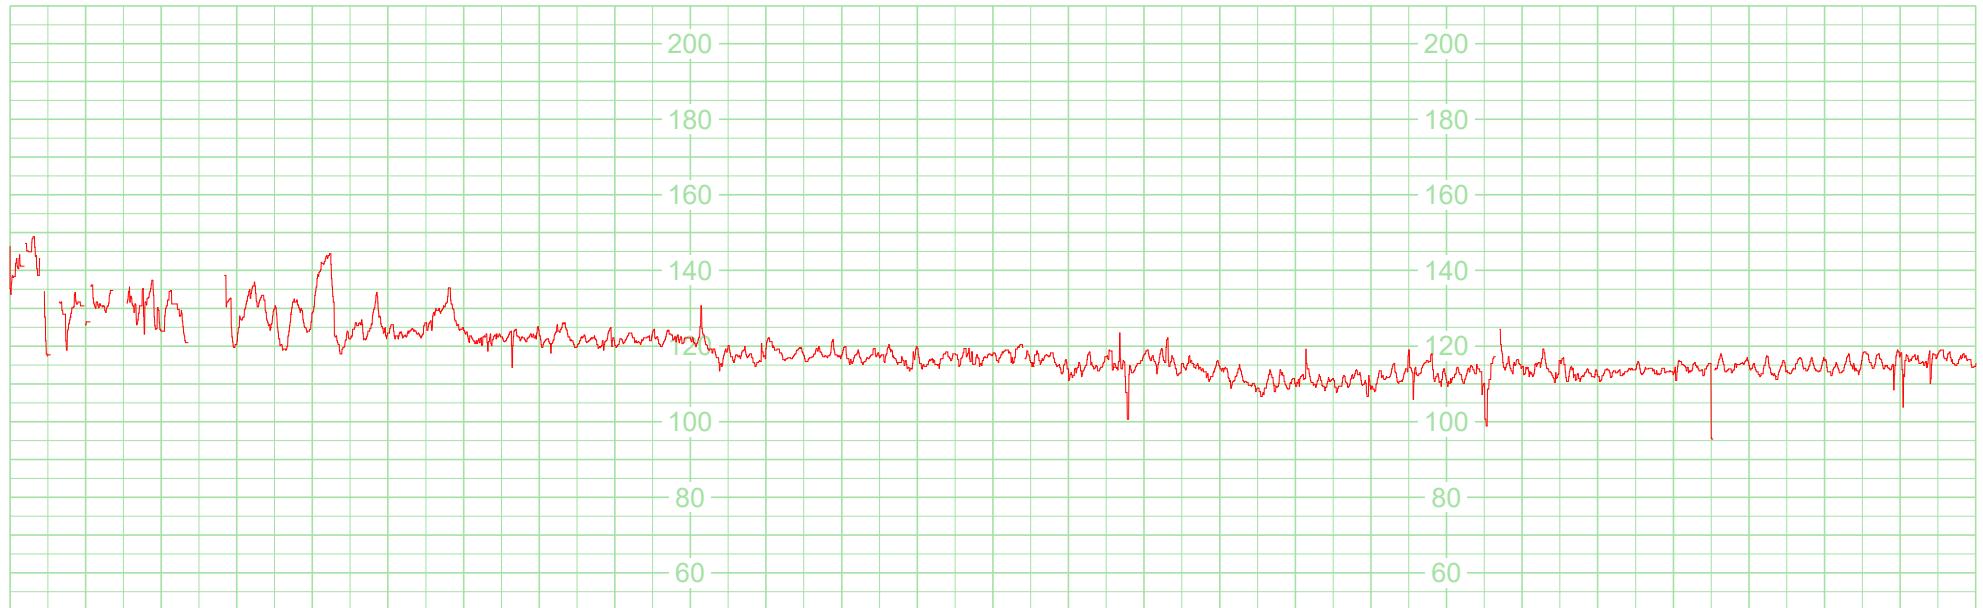


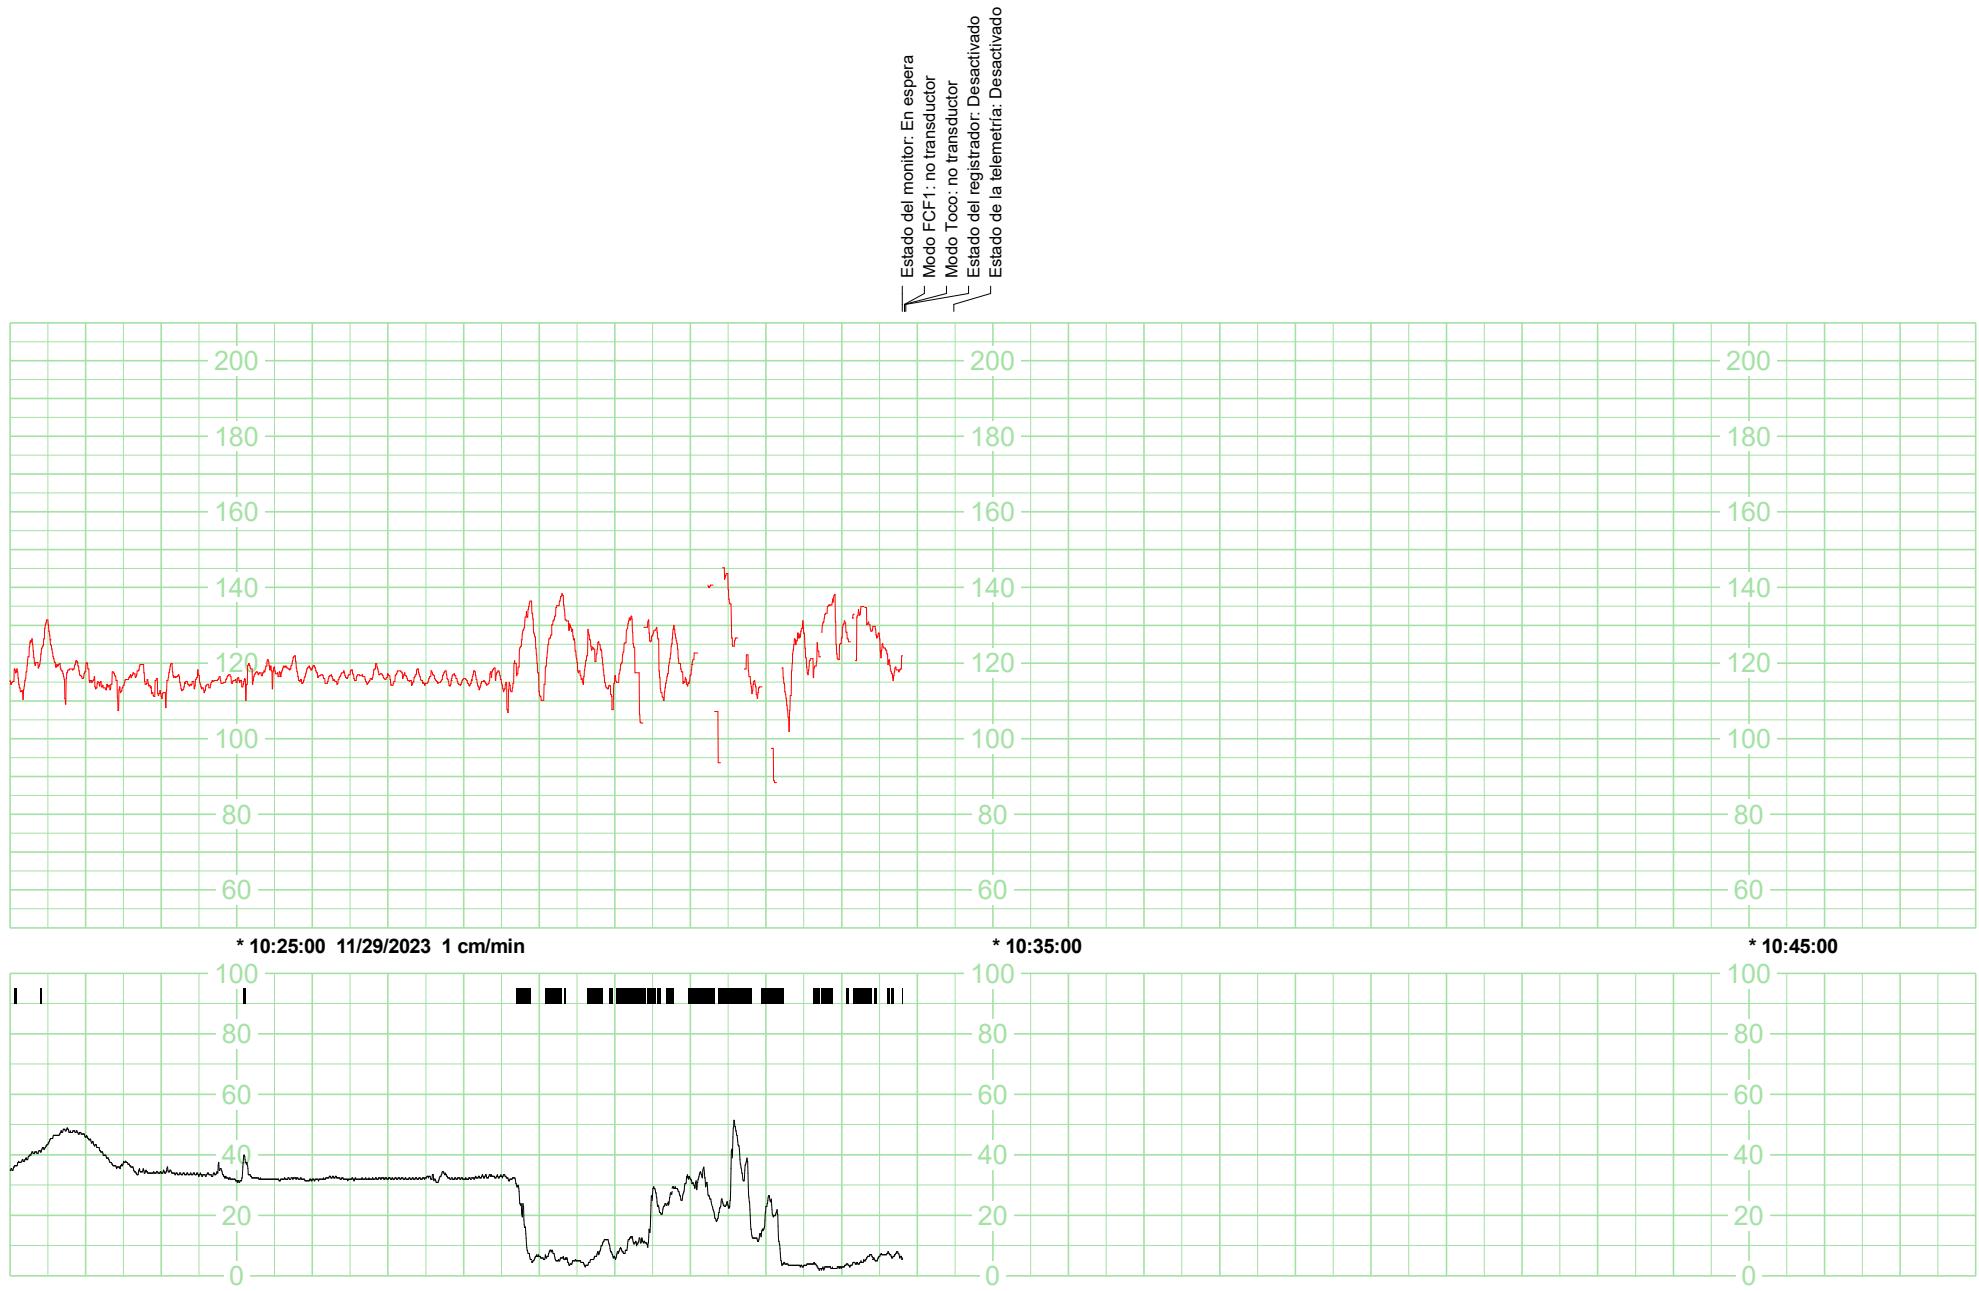


Estado del registrador: Activado
Estado de la telemetría: Activado
Modo FCF: US
Estado del FMP: Activado
Modo Toco: externo

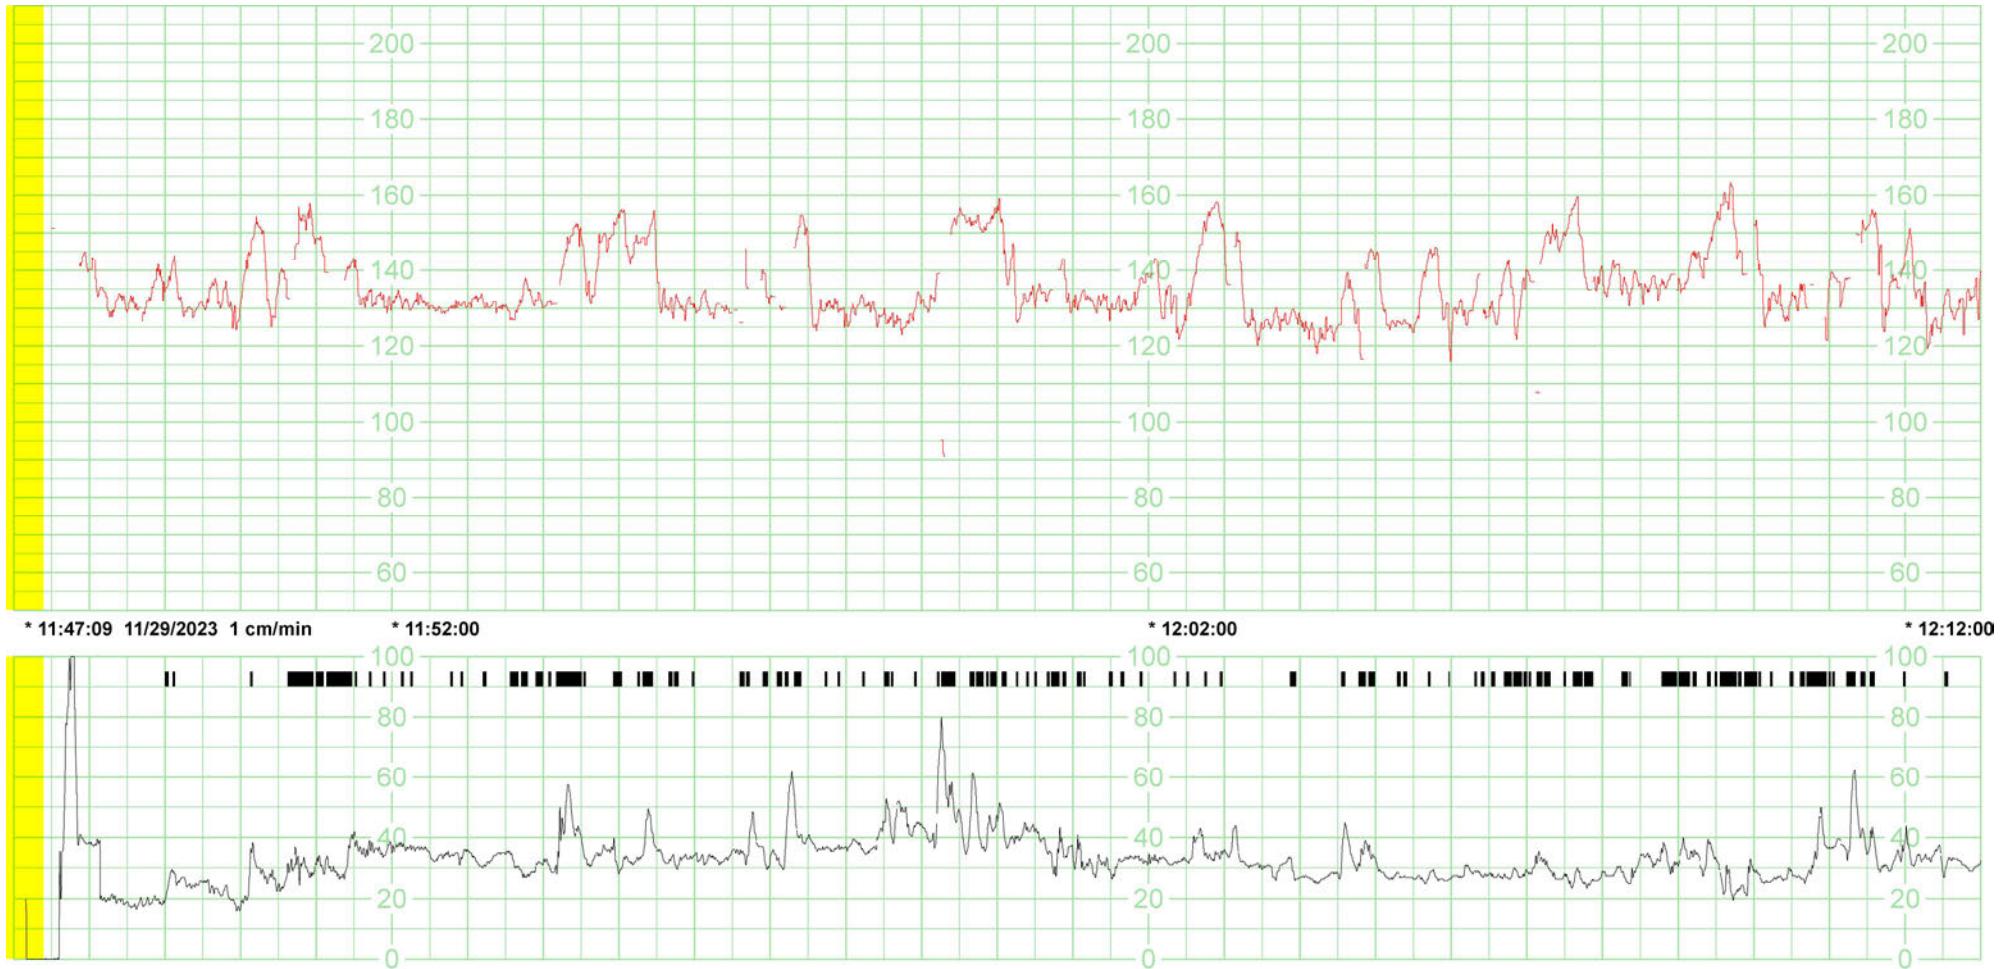


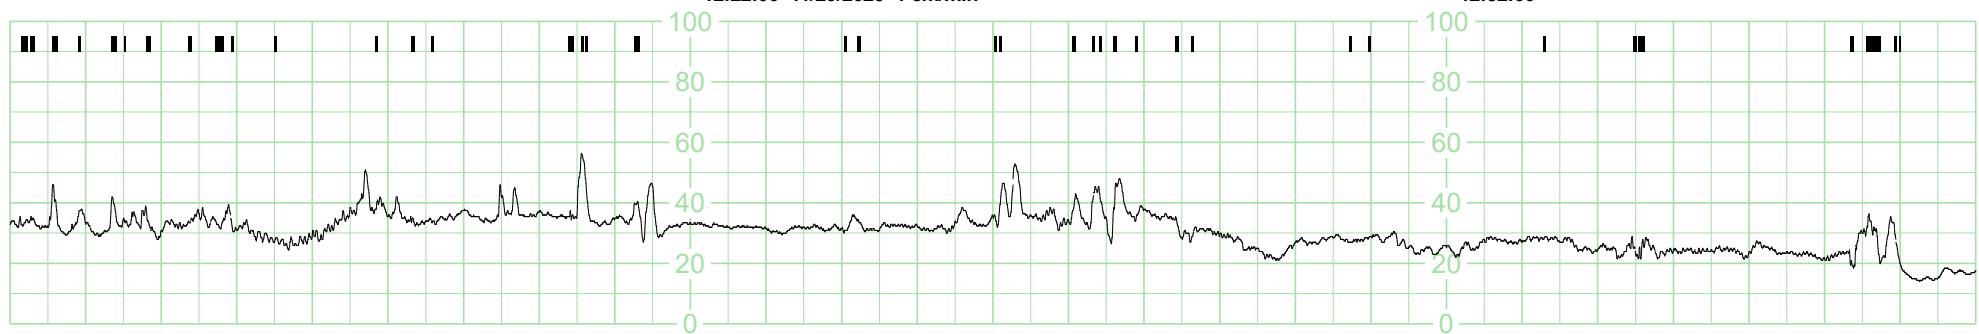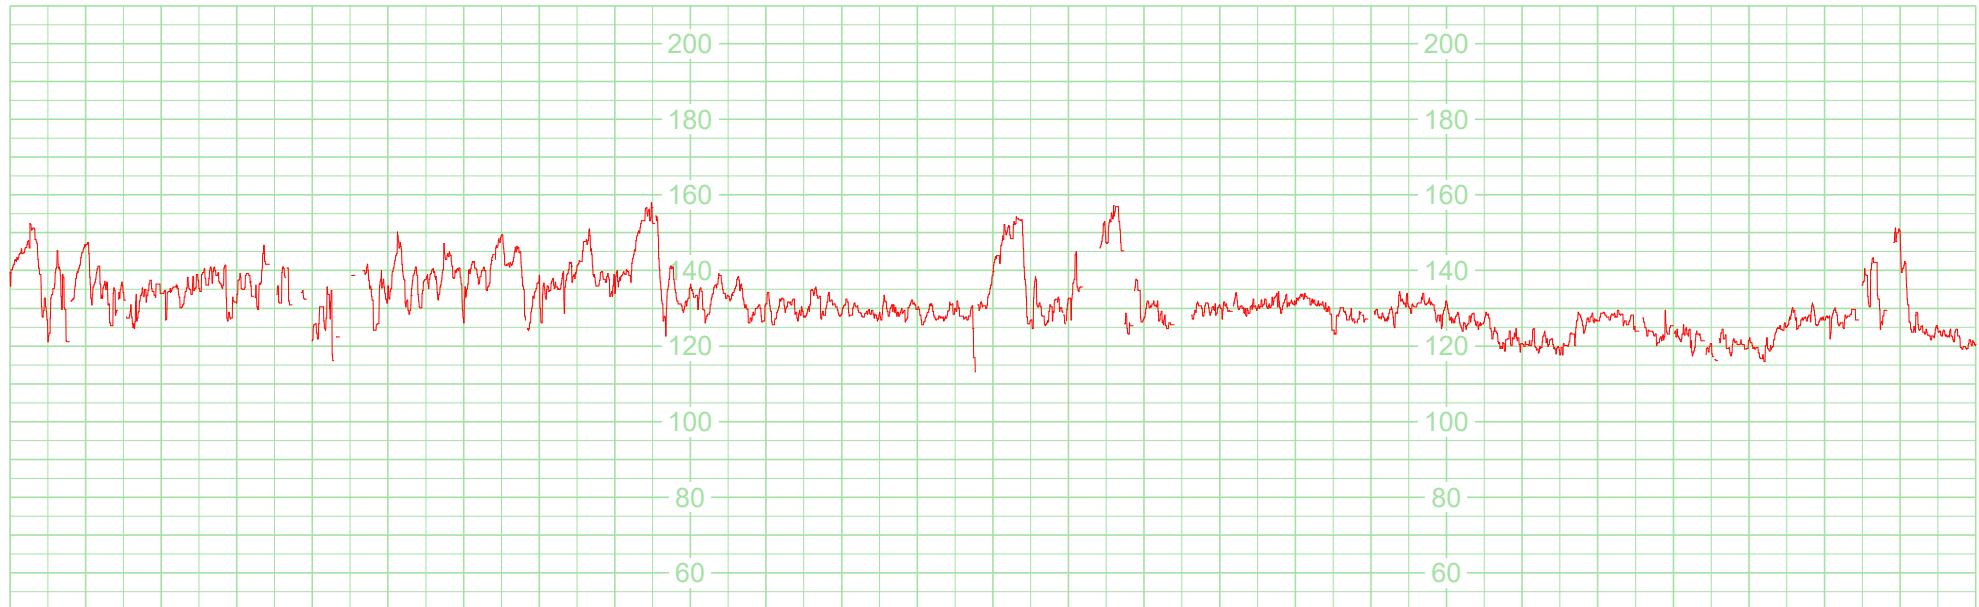

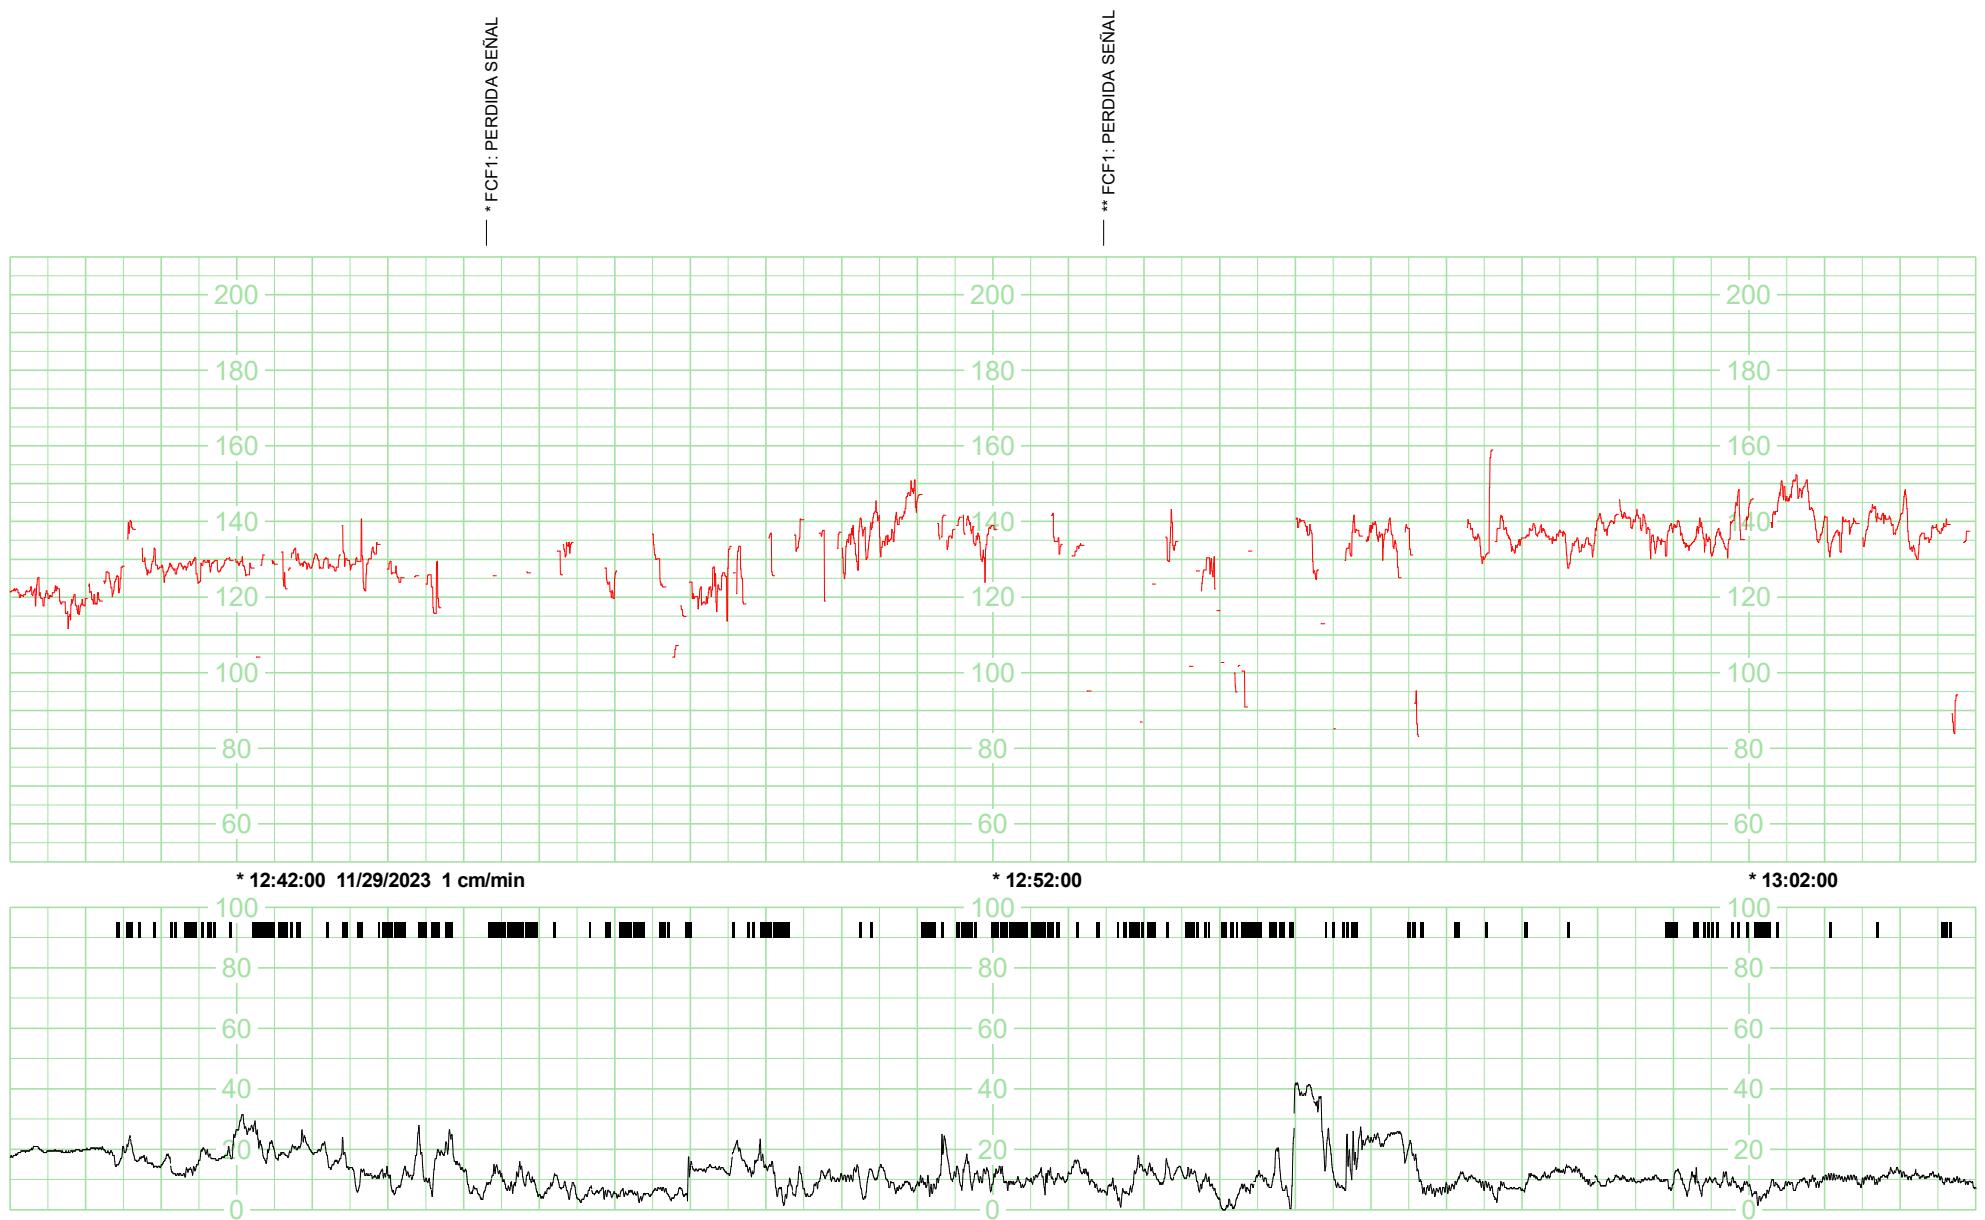





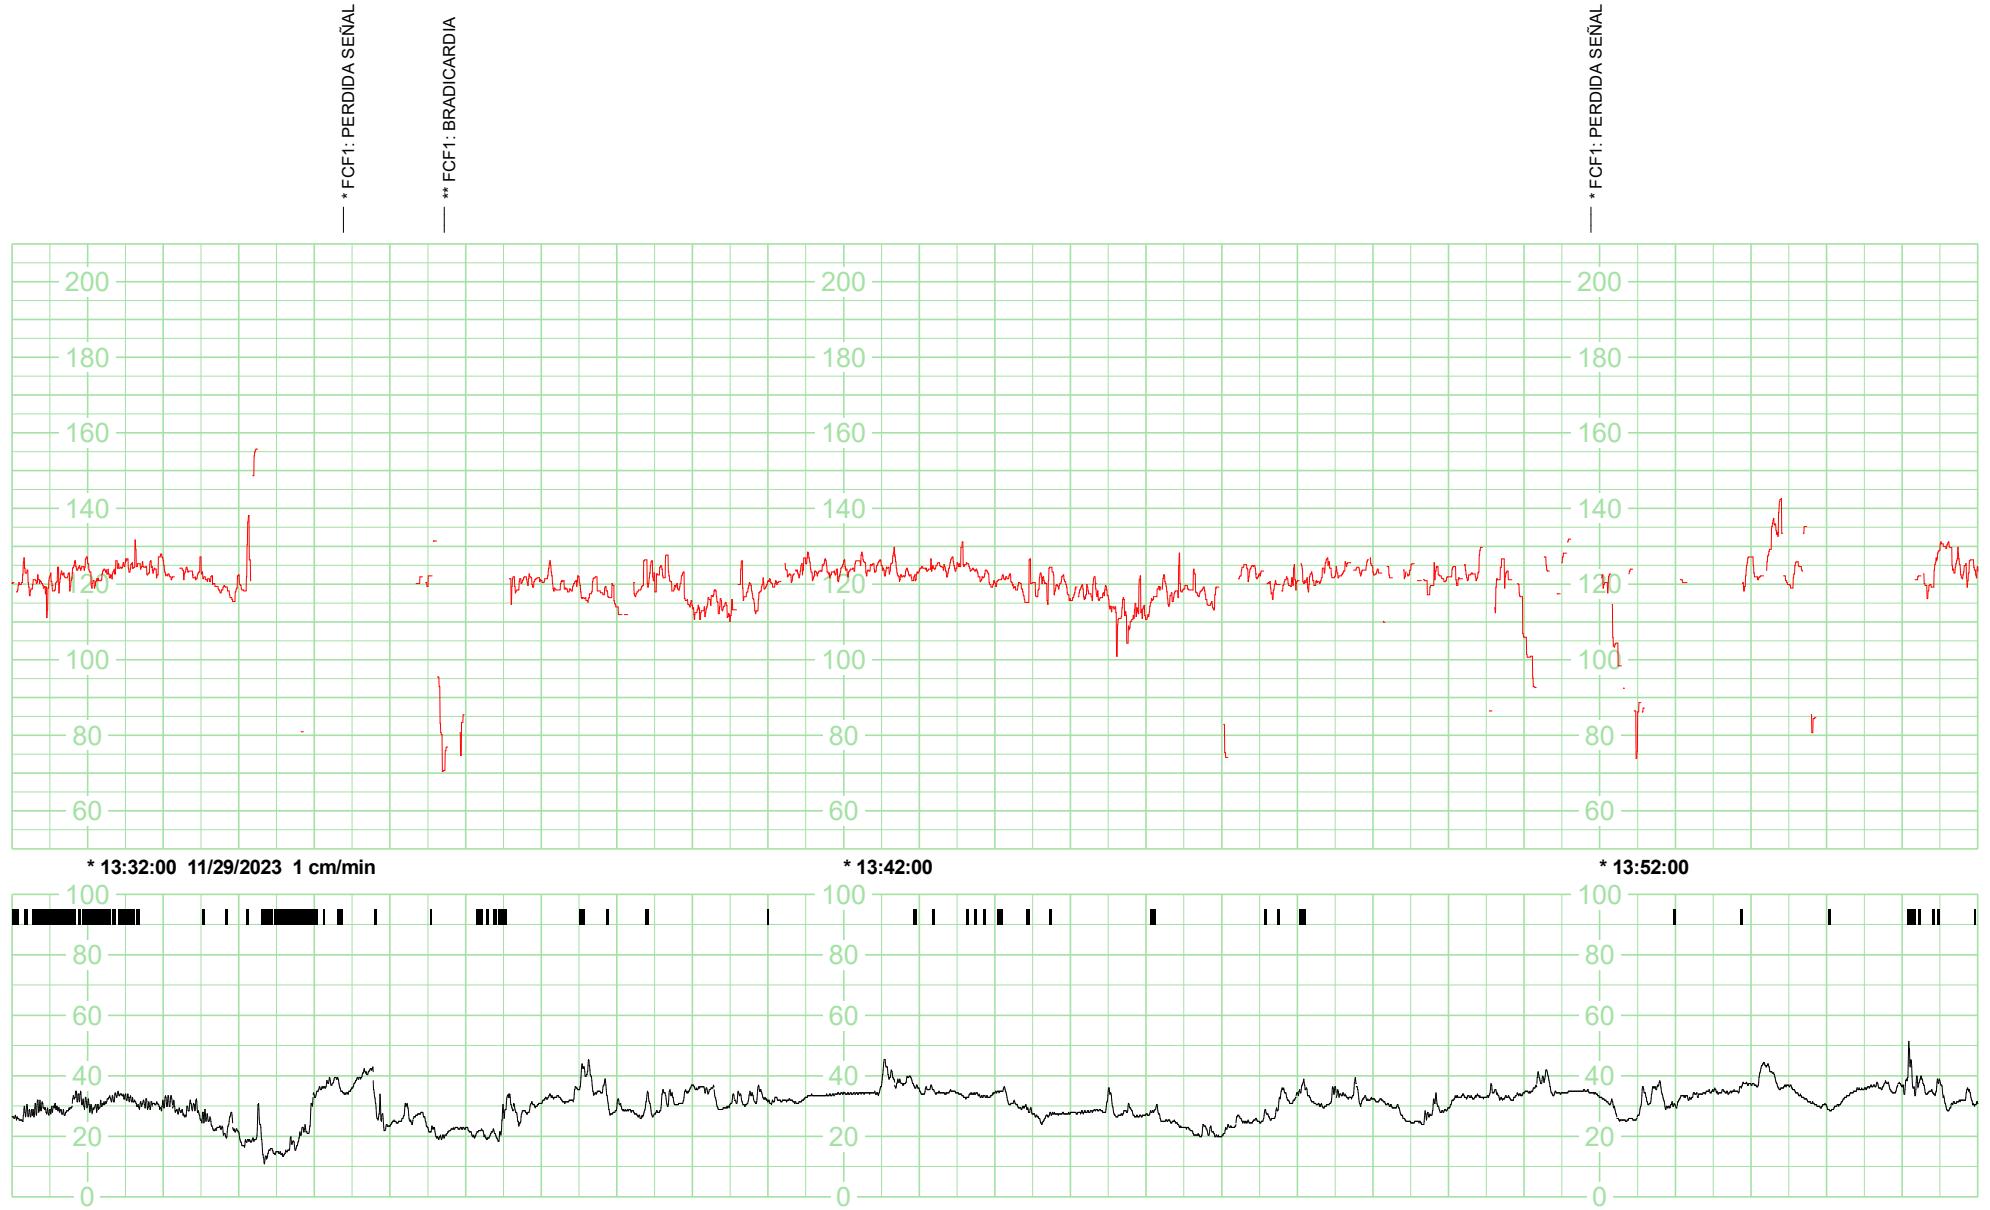



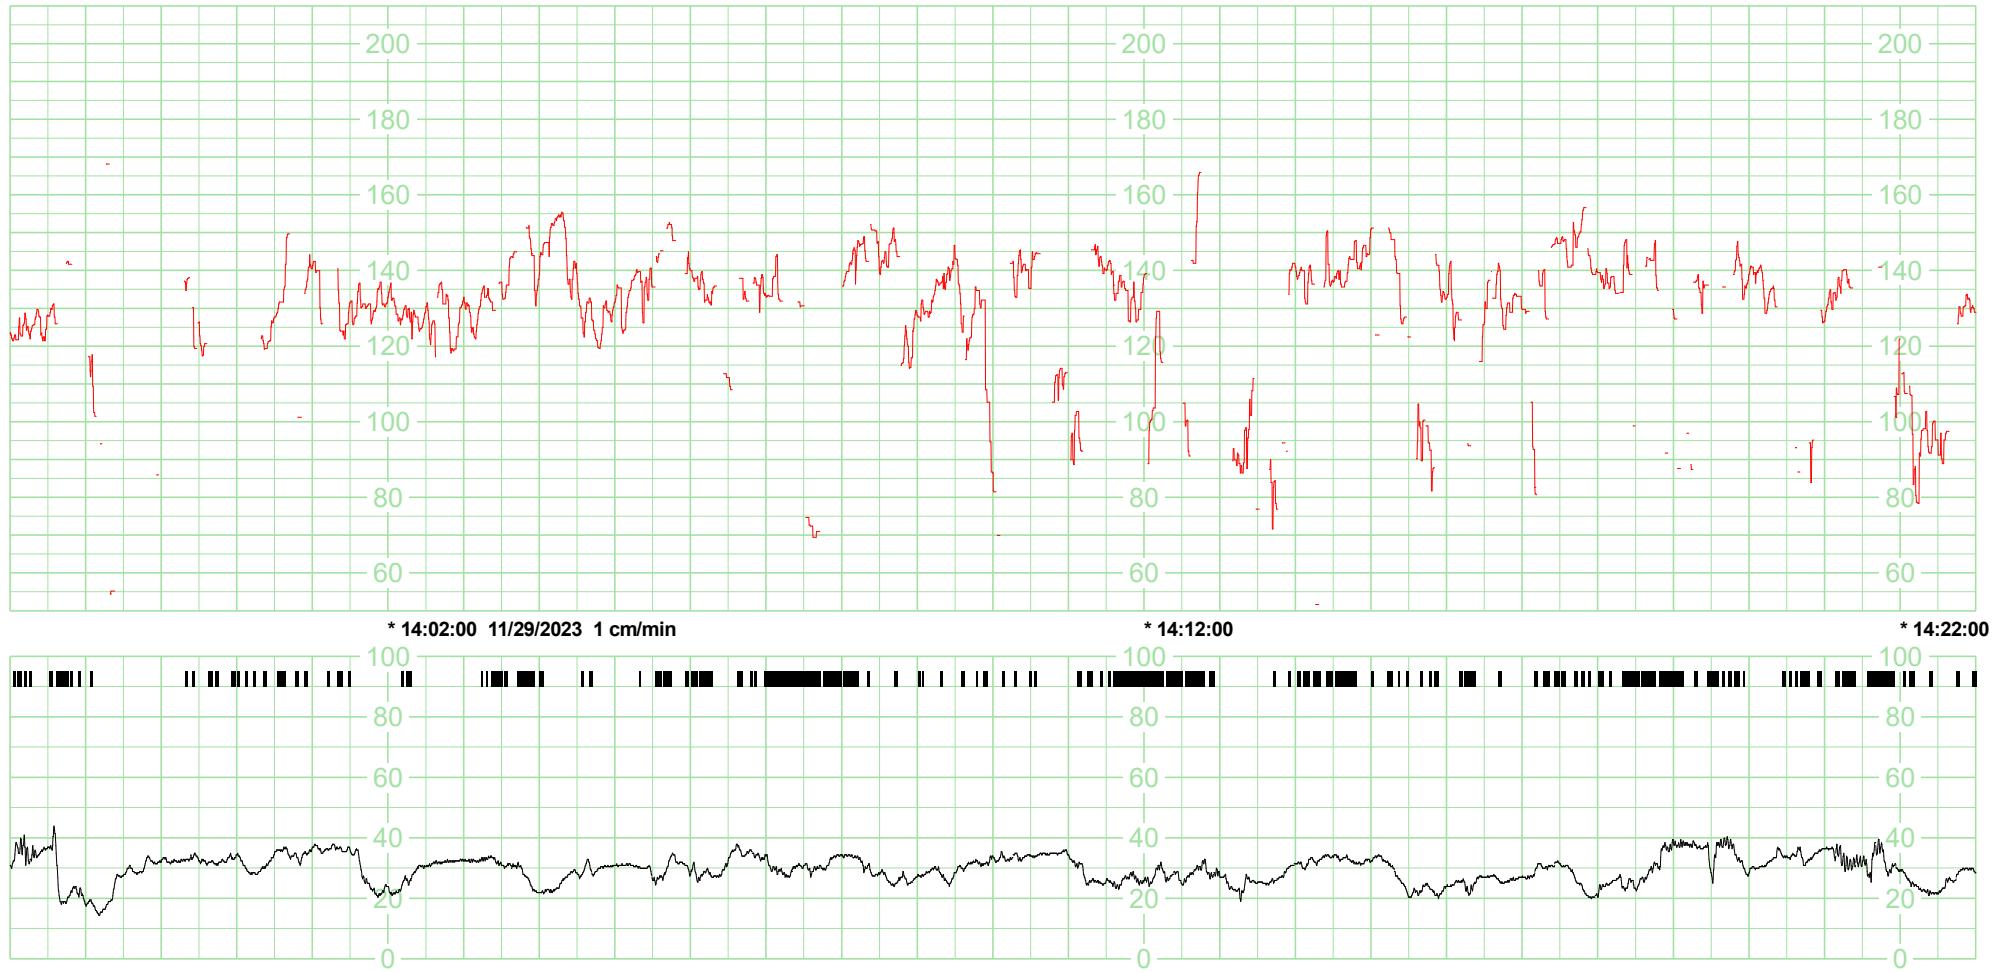


— * FCF1: PERDIDA SEÑAL

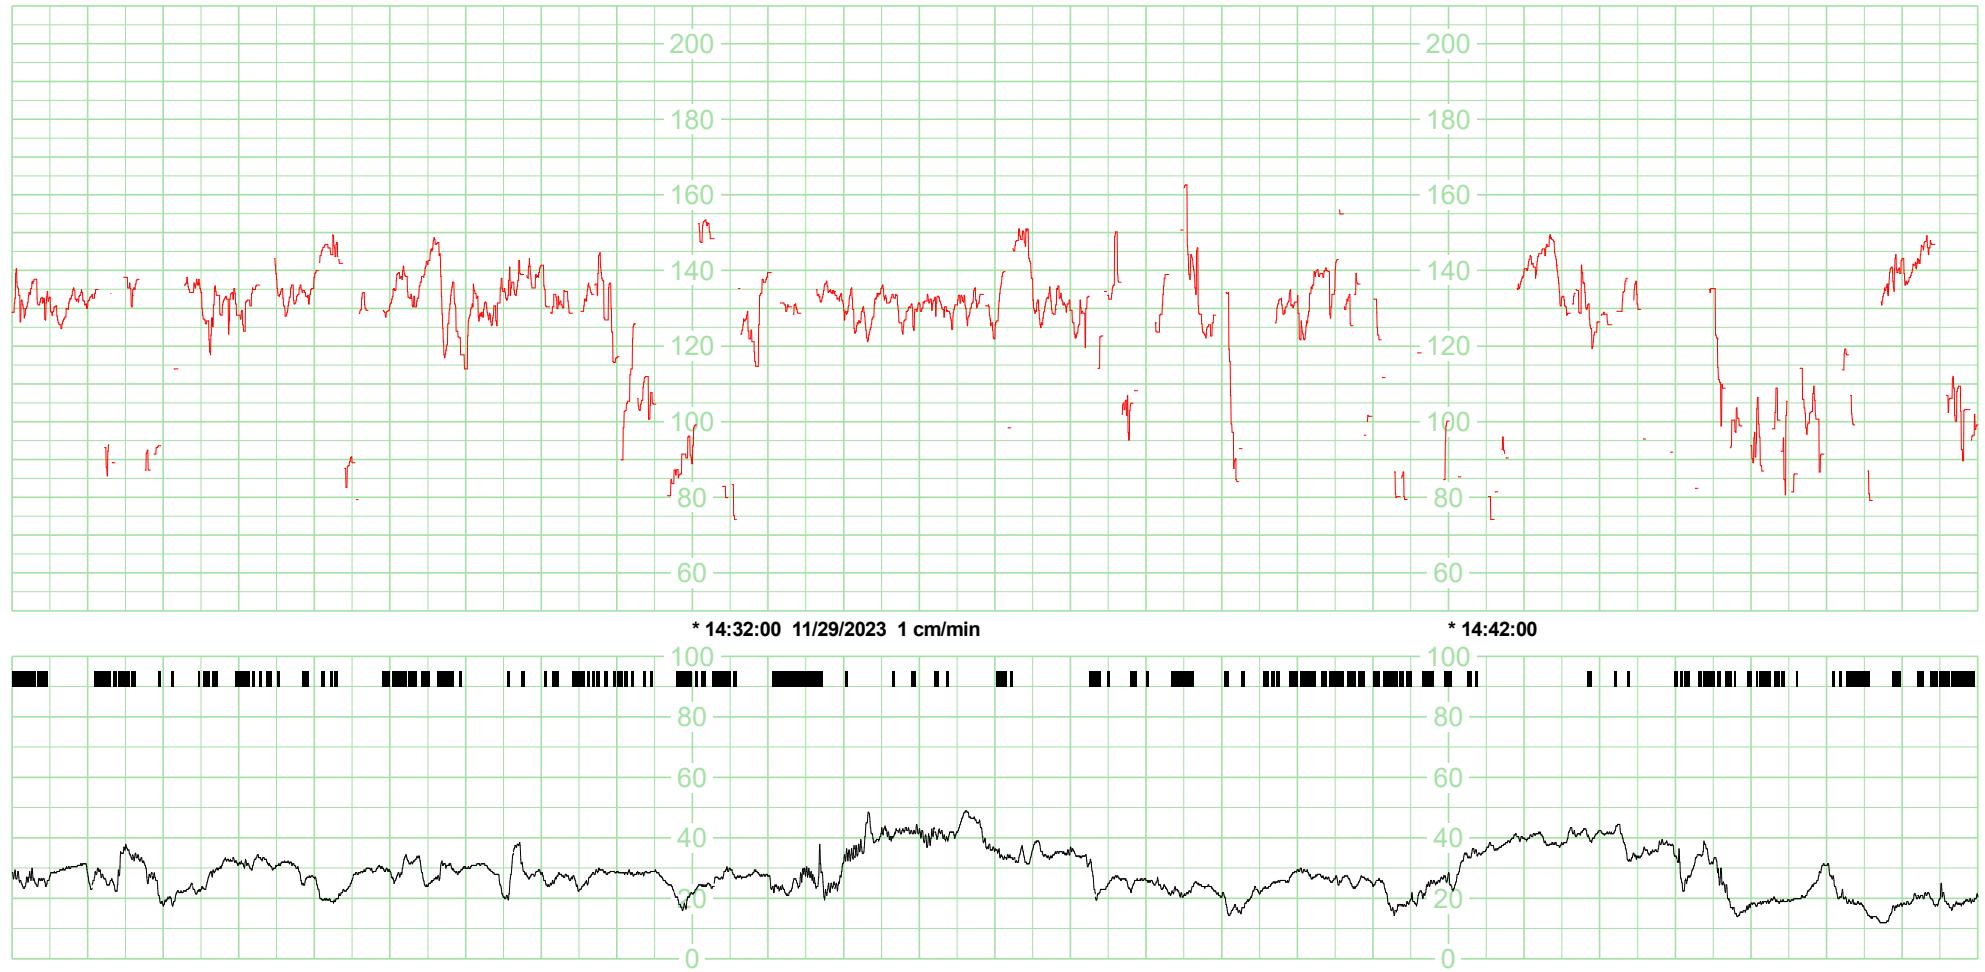

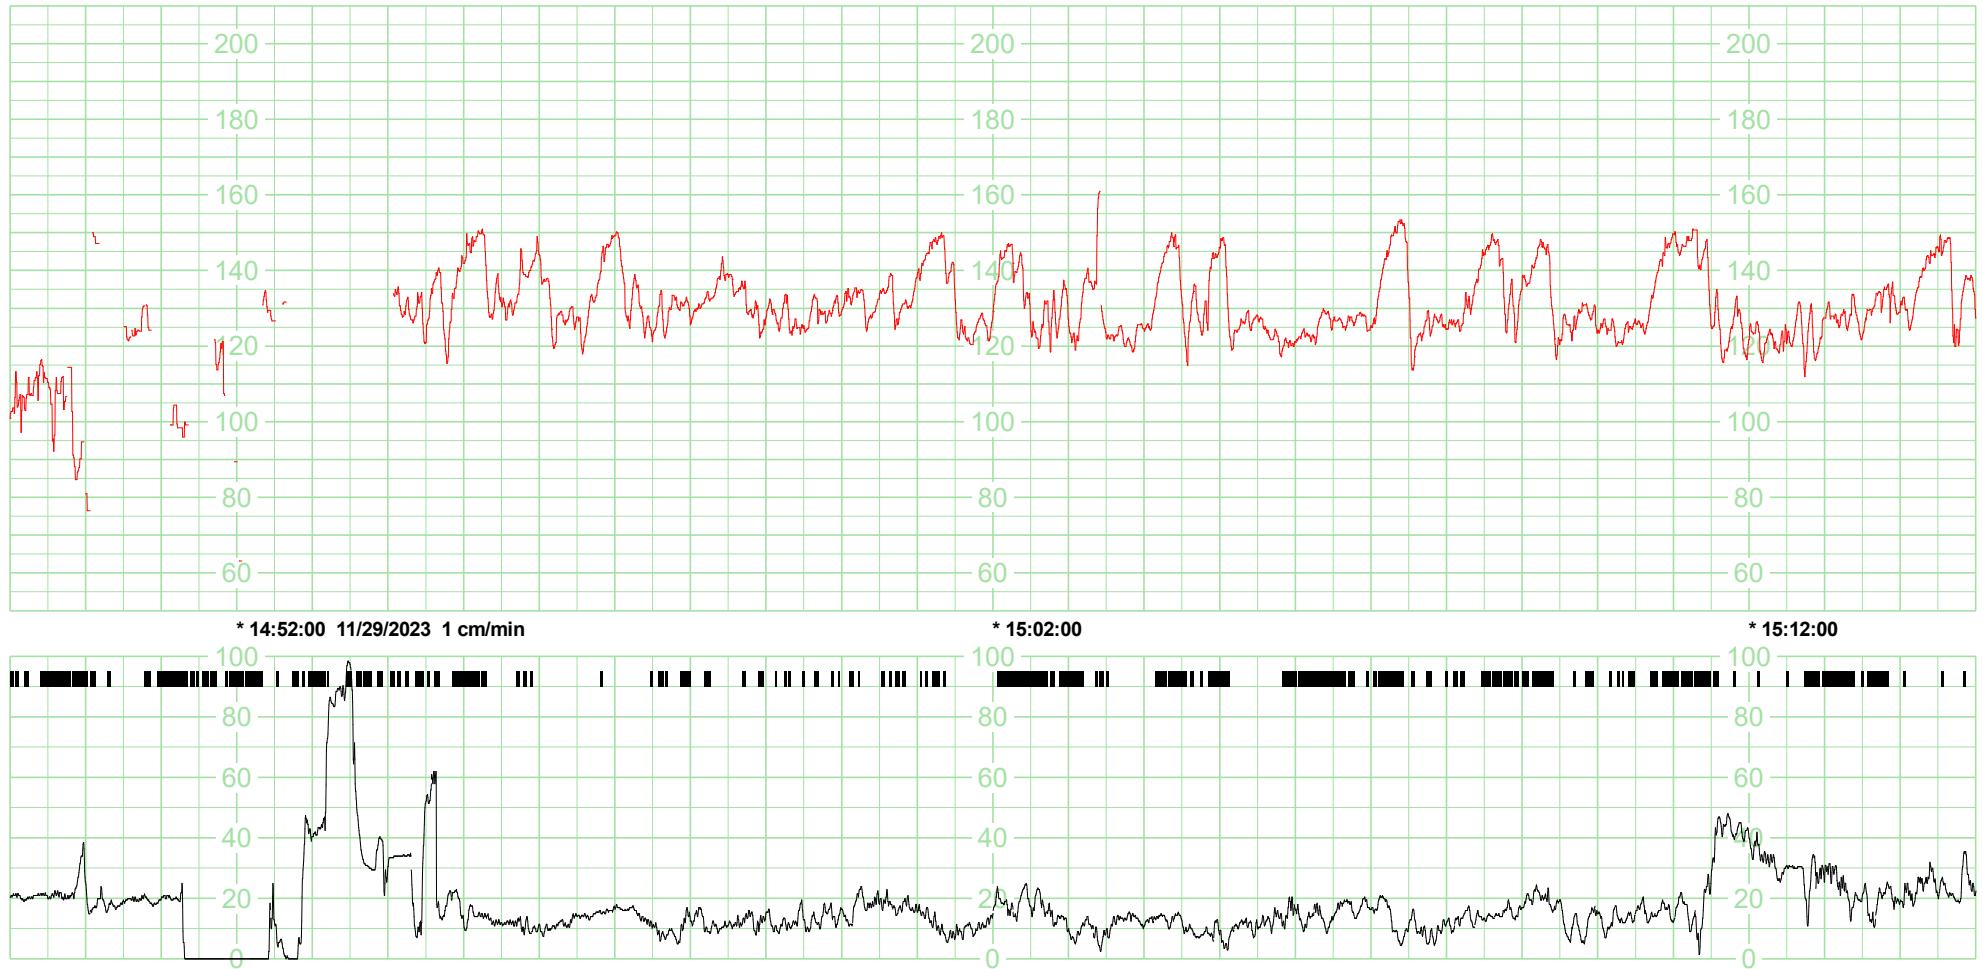

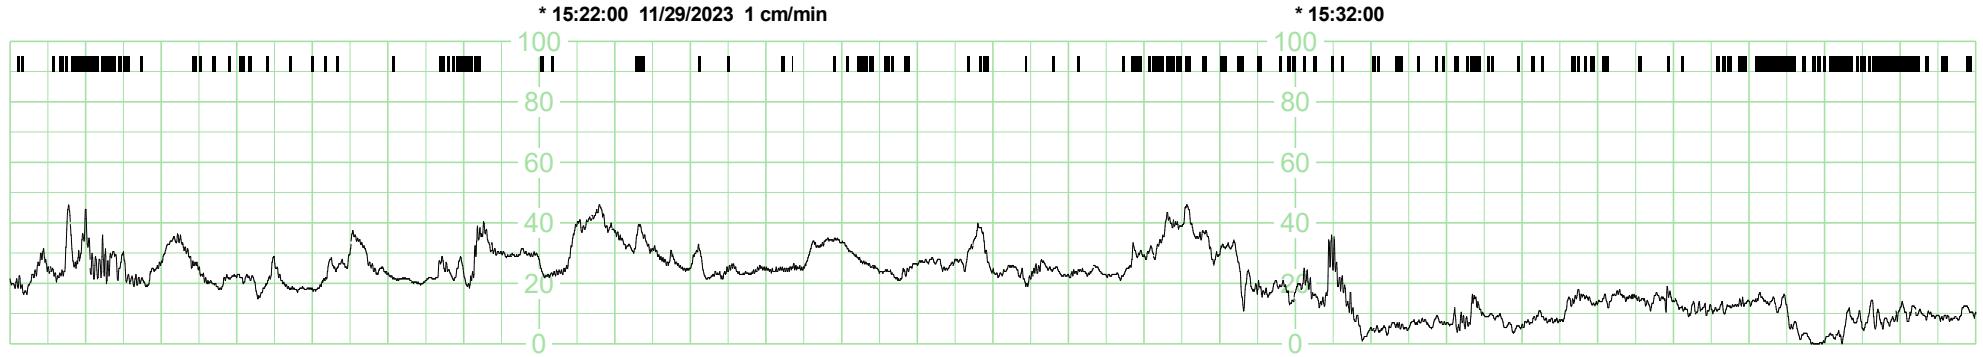


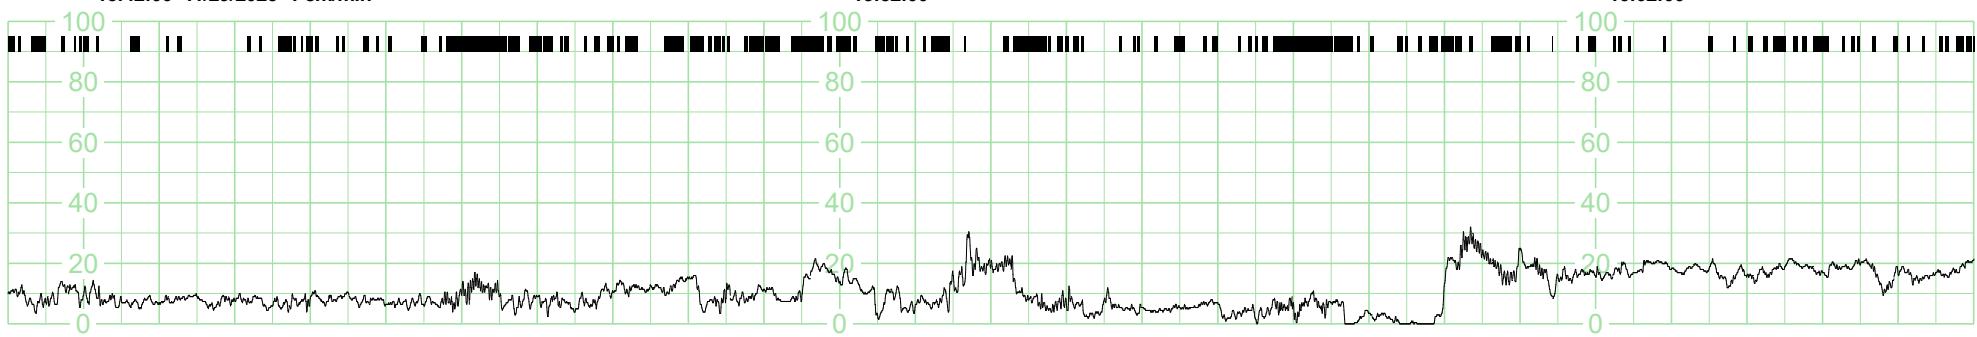
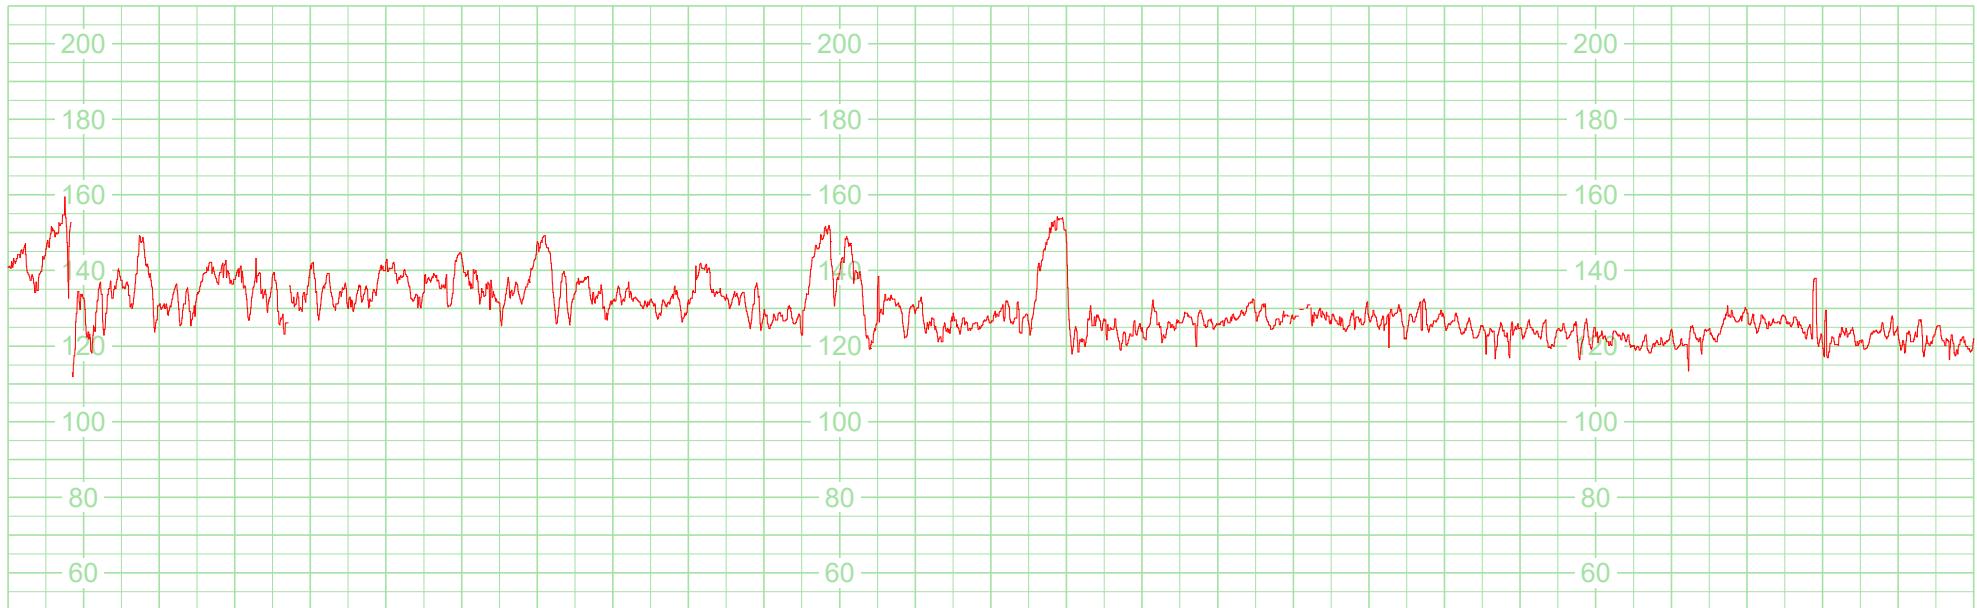




— Estado del registrador: Activado




— Alarma con acuse de recibo

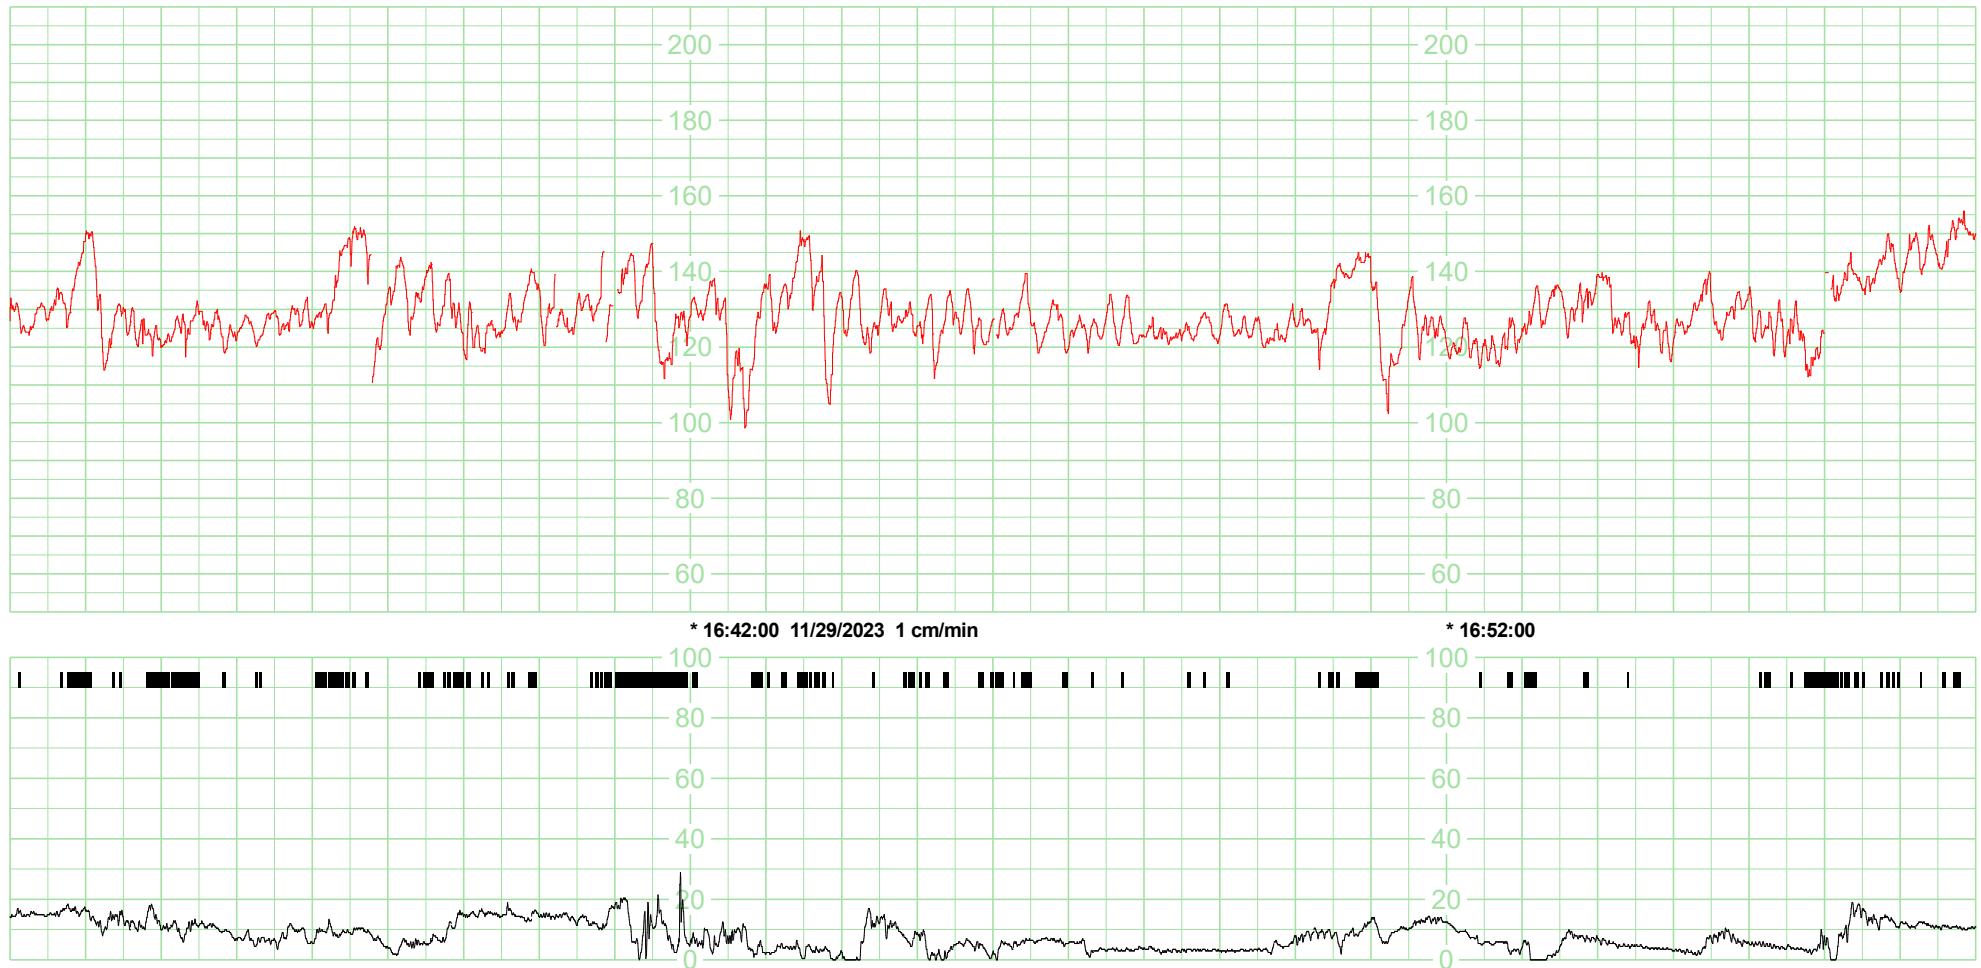


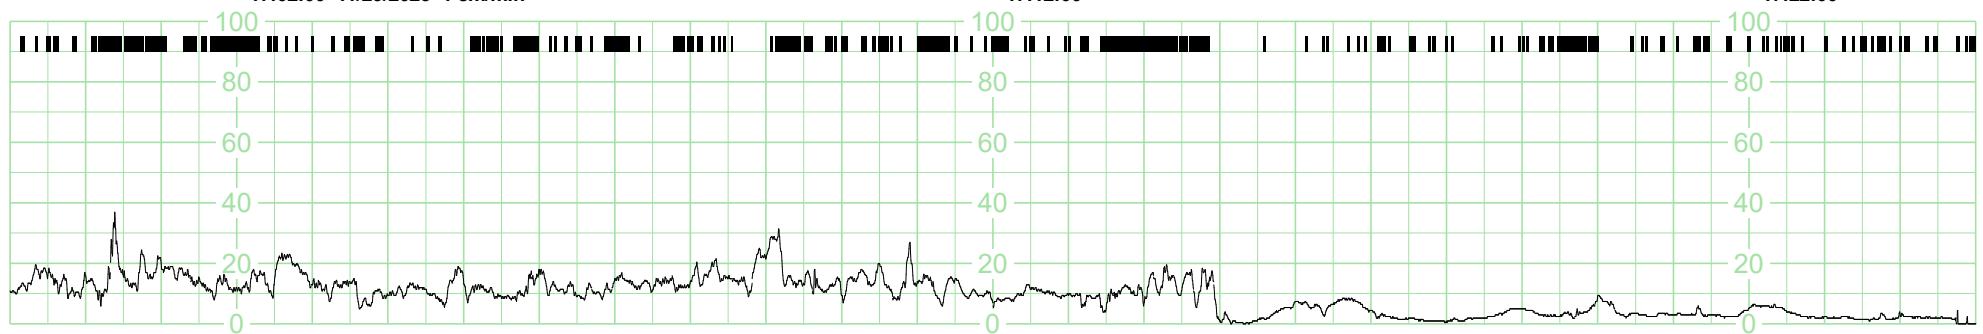
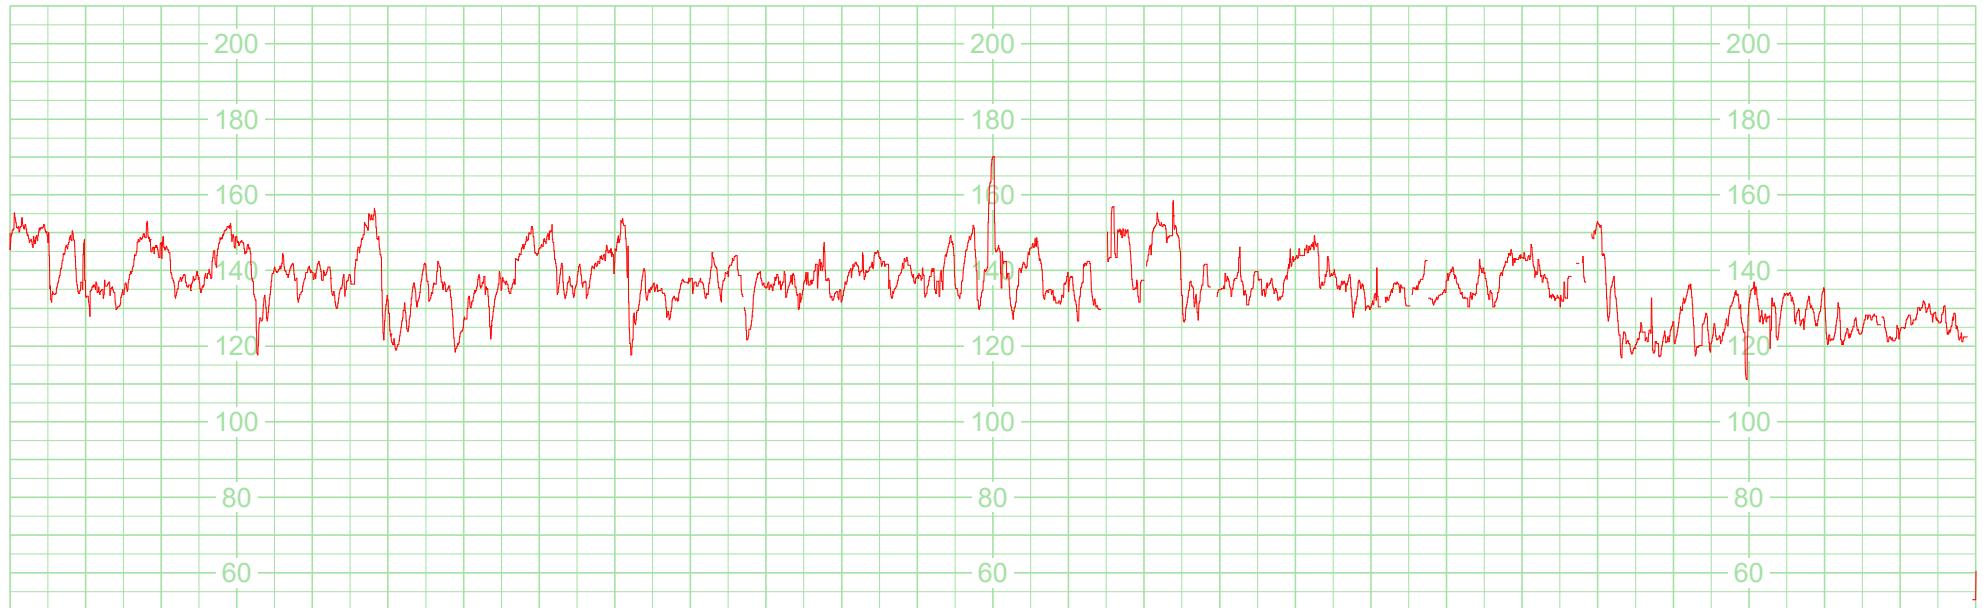


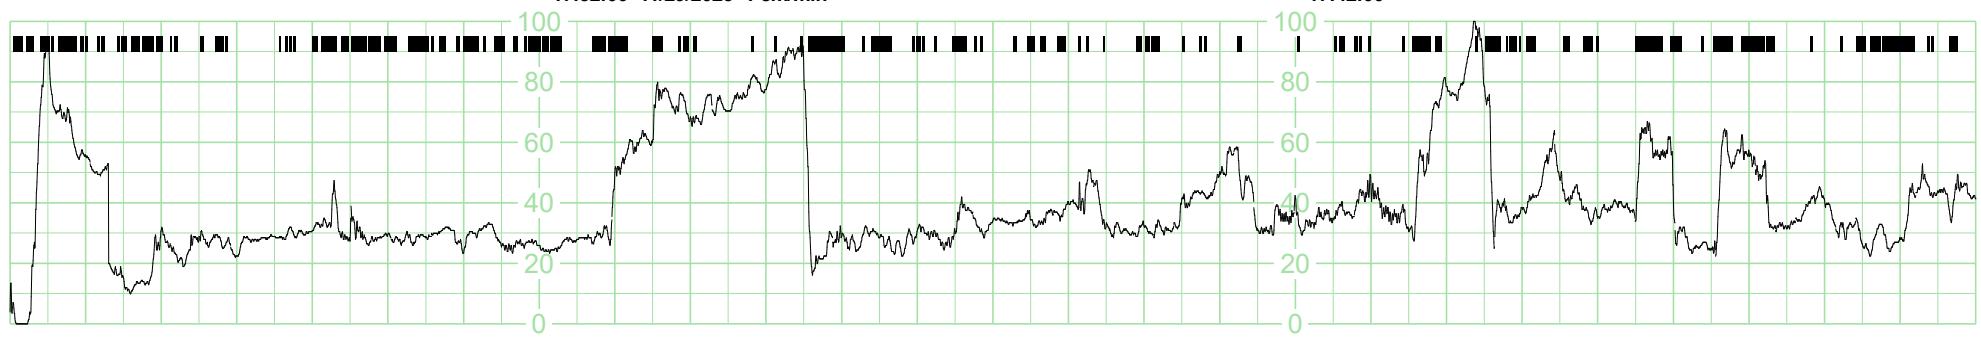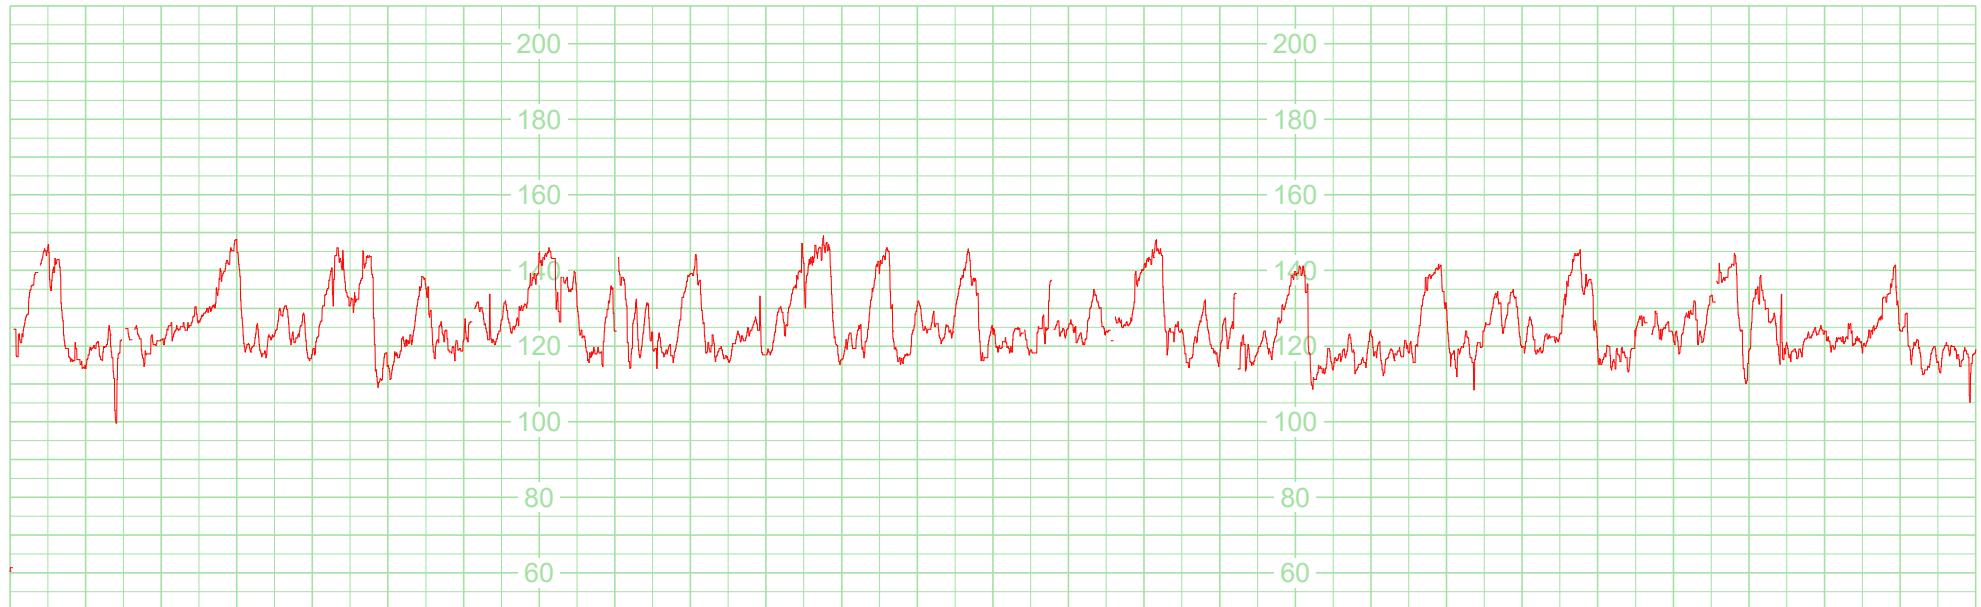

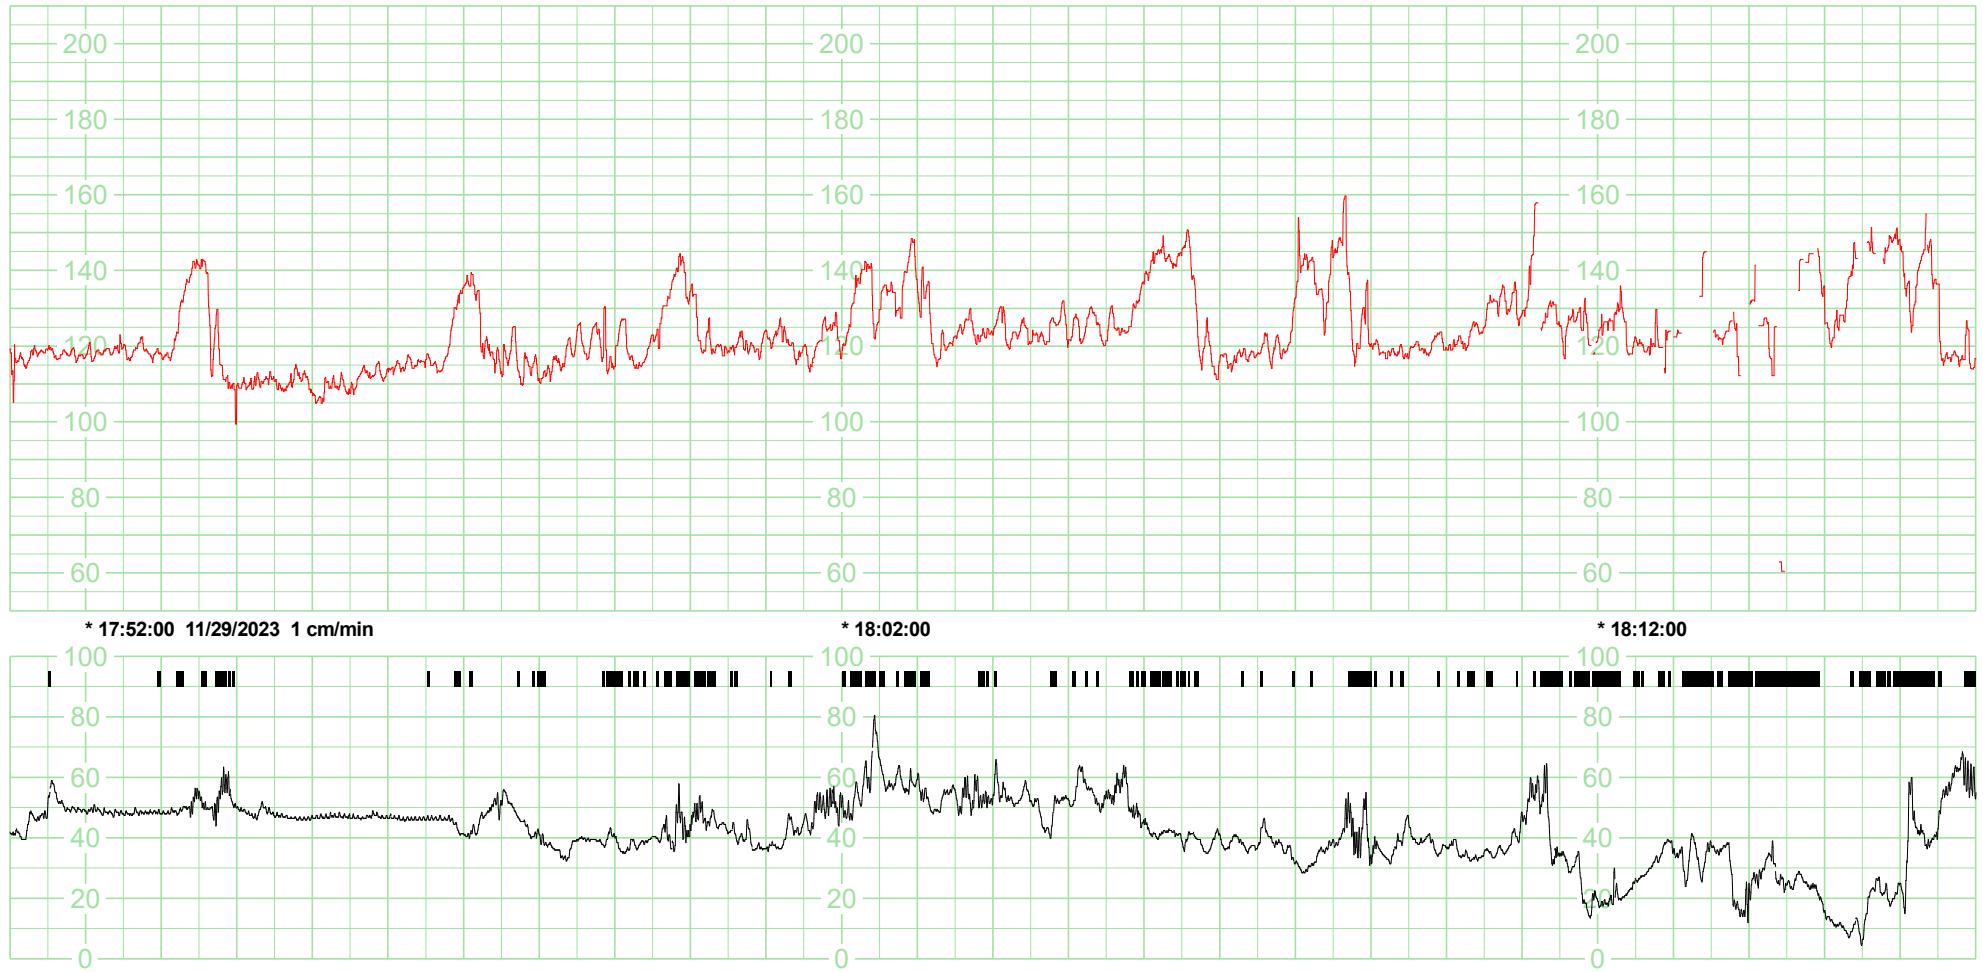

— * FCF1: PERDIDA SEÑAL

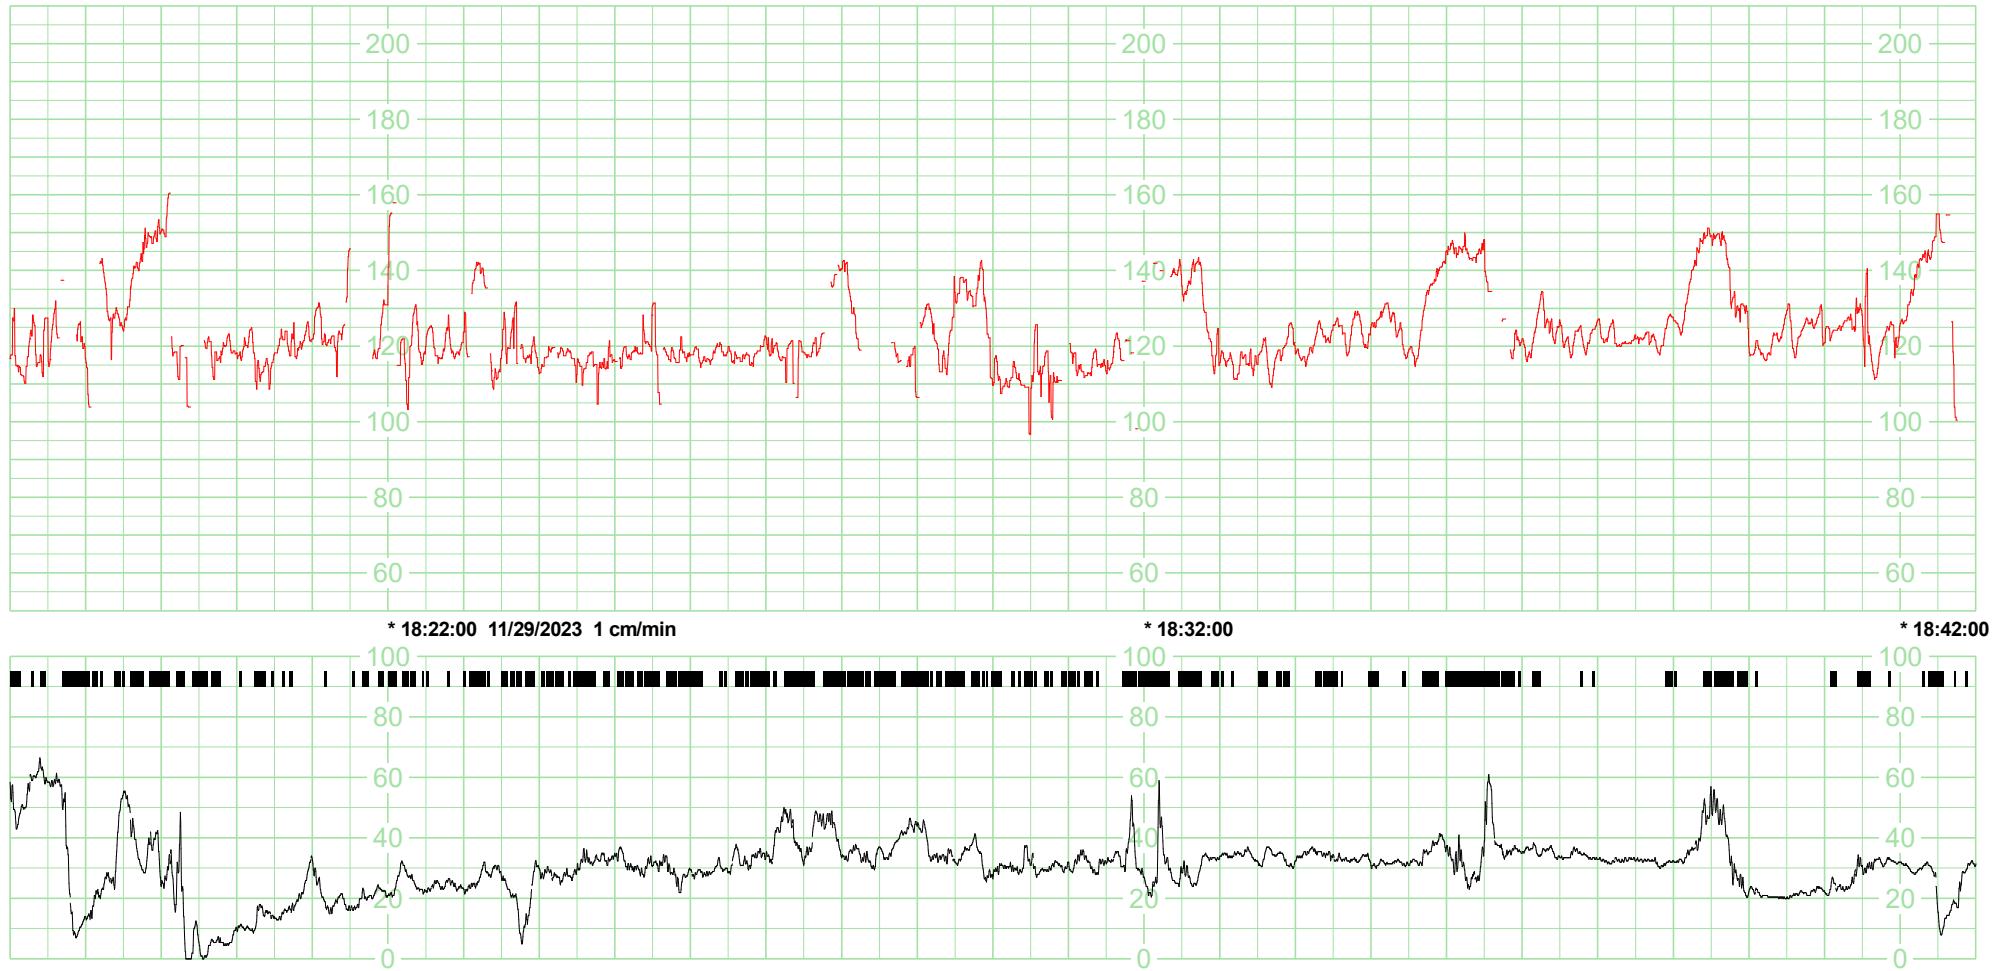

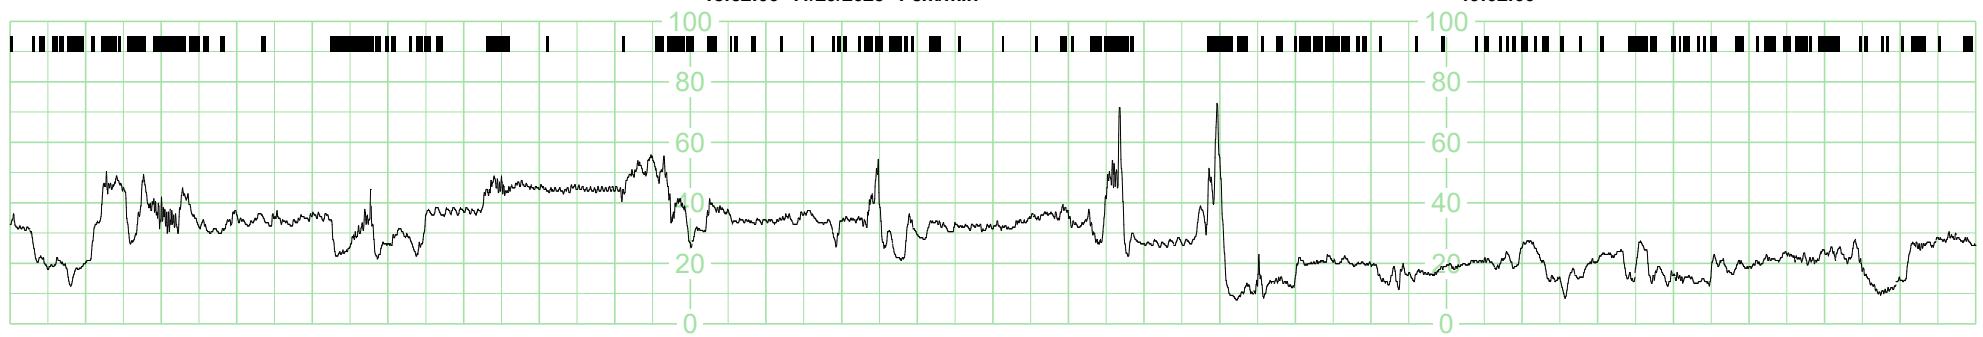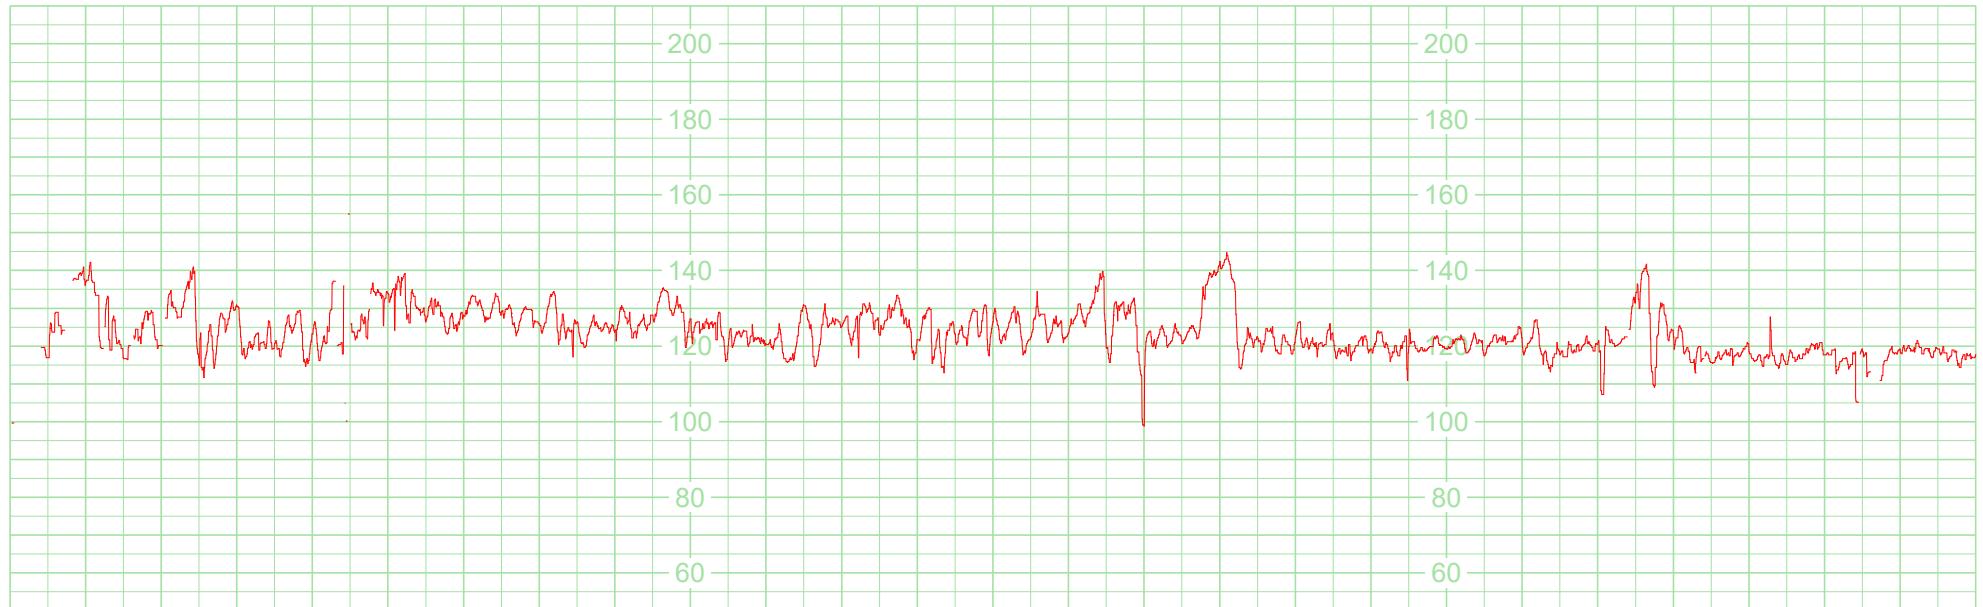

* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Estado de la telemetría: Desactivado
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del monitor: En espera
Estado del registrador: Desactivado

— Alarma con acuse de recibo

