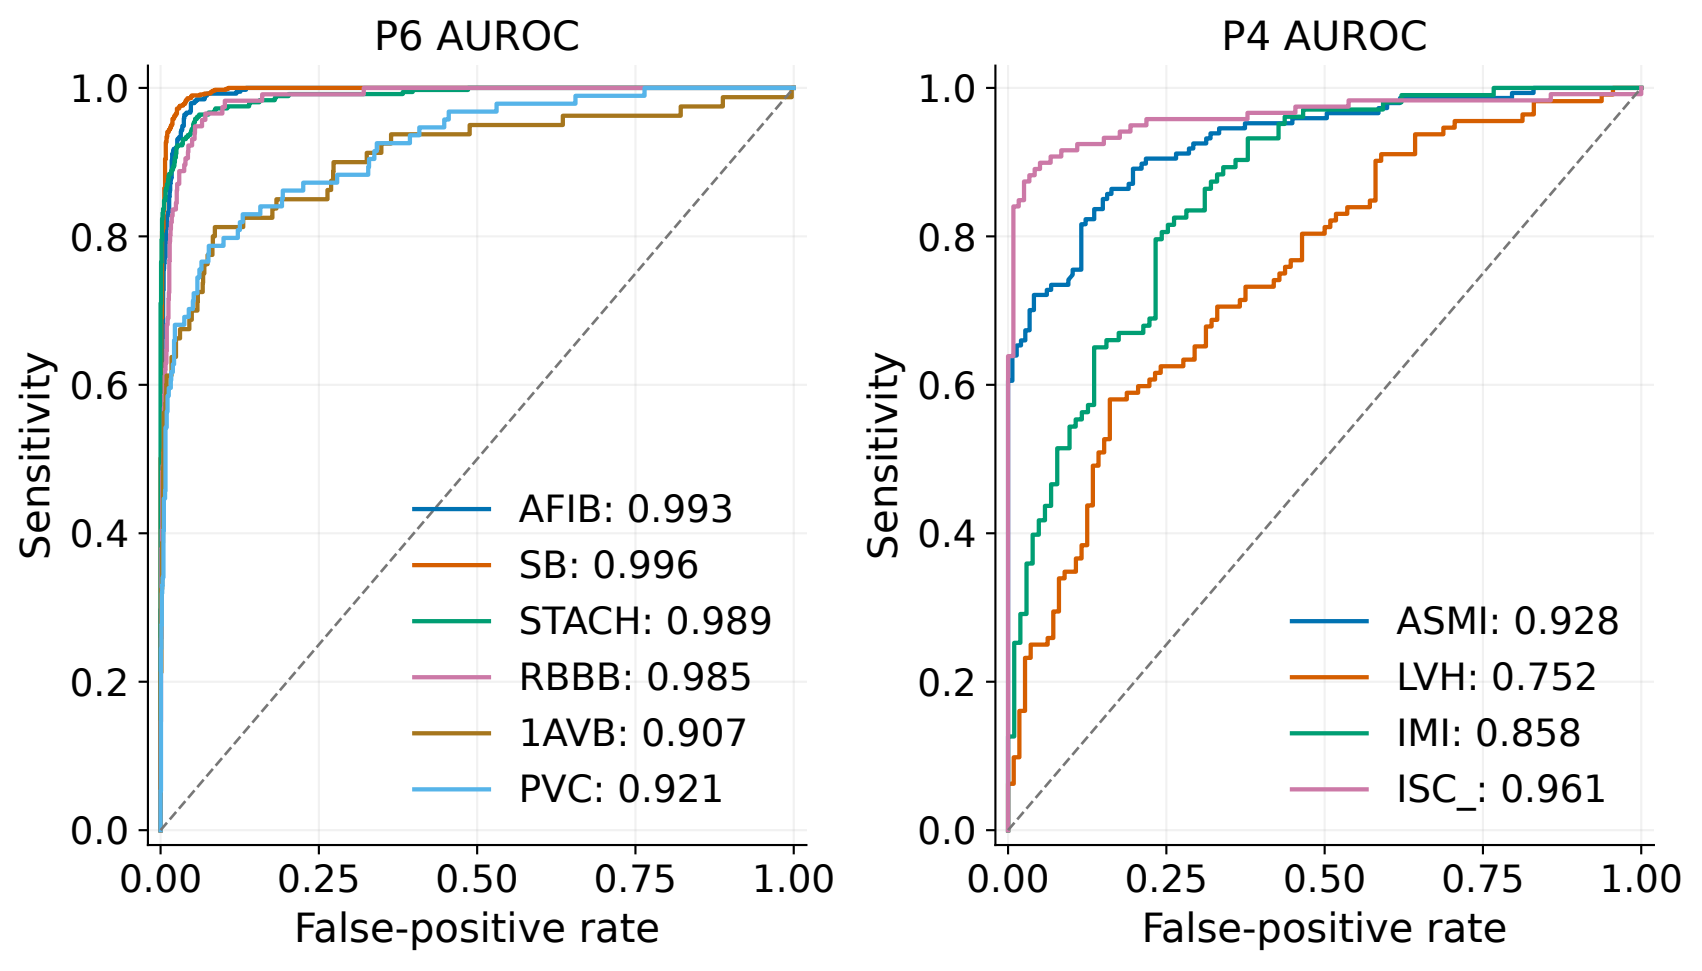
P6 AUROC
Sensitivity
False-positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
AFIB: 0.993
SB: 0.996
STACH: 0.989
RBBB: 0.985
1AVB: 0.907
PVC: 0.921
P4 AUROC
Sensitivity
False-positive rate
ASMI: 0.928
LVH: 0.752
IMI: 0.858
ISC_: 0.961