


DATAPATH

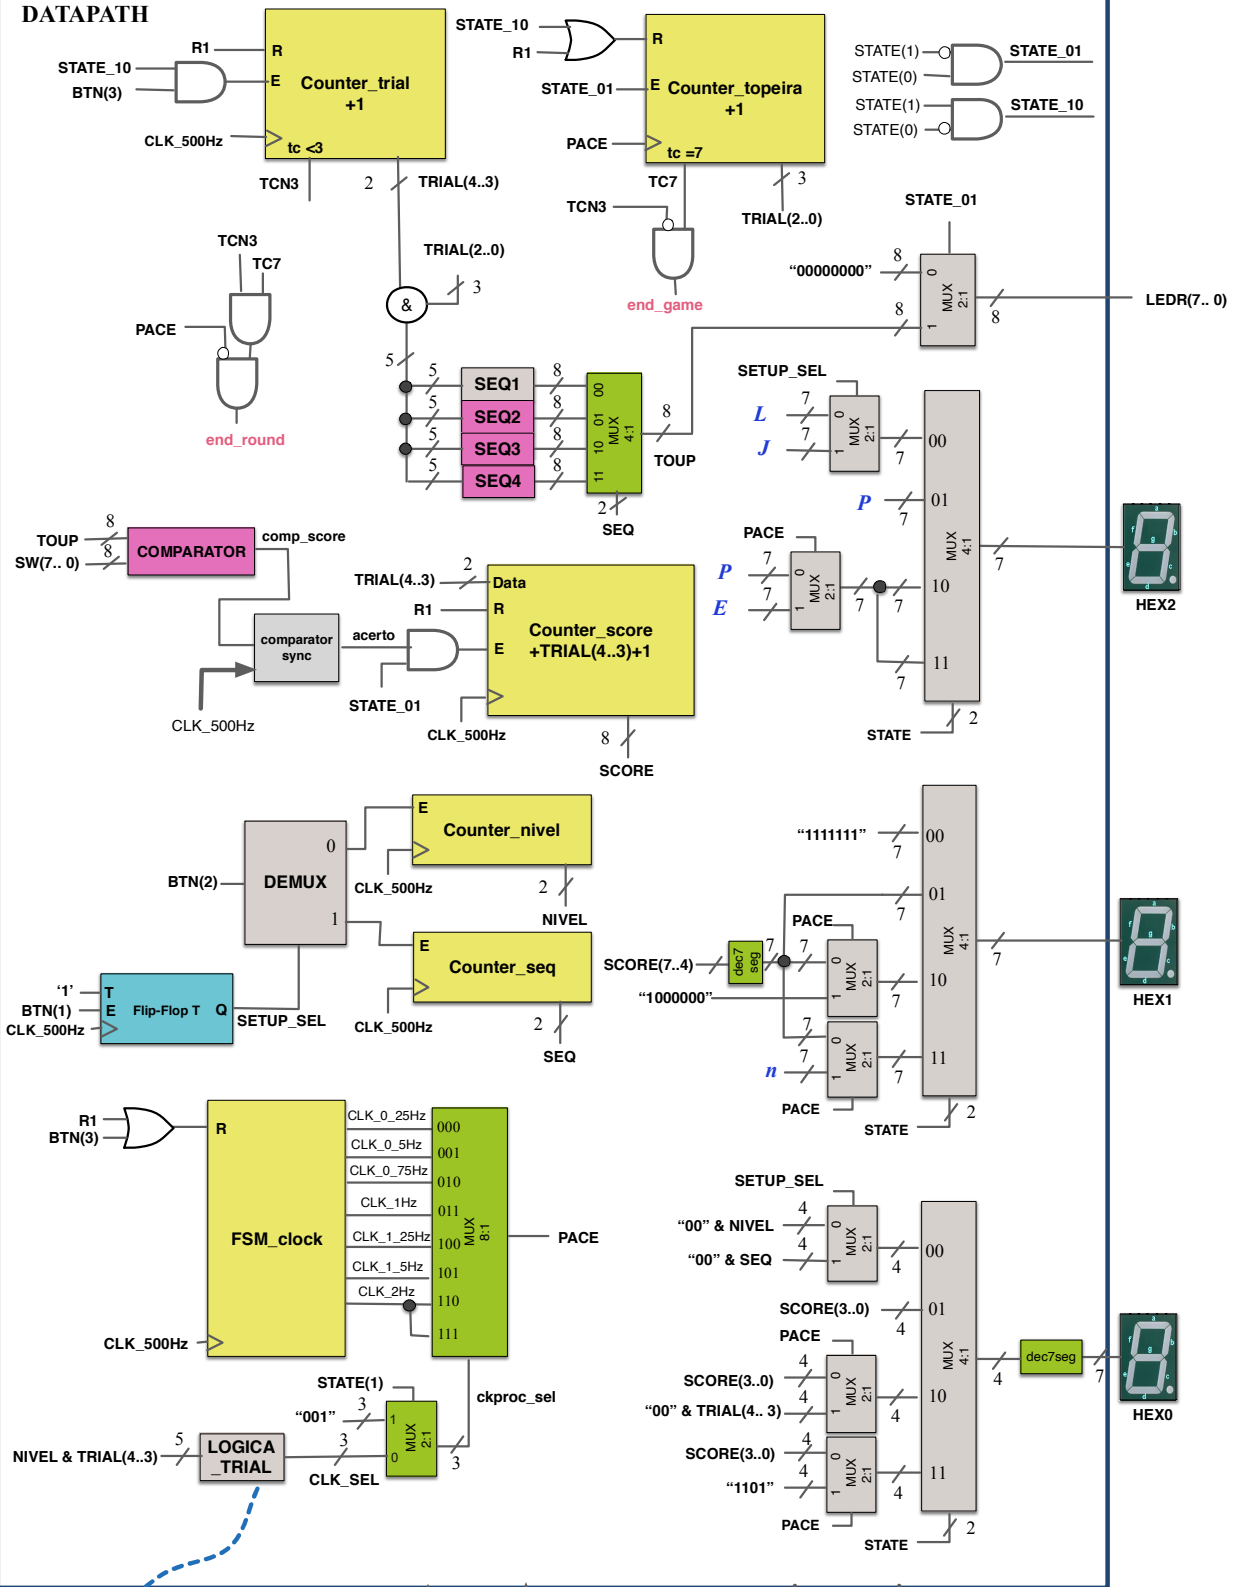


LOGICA_TRIAL

CLK_SEL(2..0)

	TRIAL(4..3)			
NIVEL	00	01	10	11
00	000	001	010	011
01	001	010	011	100
10	010	011	100	101
11	011	100	101	110

LAB4
LAB5
LAB6
LAB7
Fazer
Dado



CONTROLE

BTN(3) → enter
BTN(0) → reset

CLK_500Hz