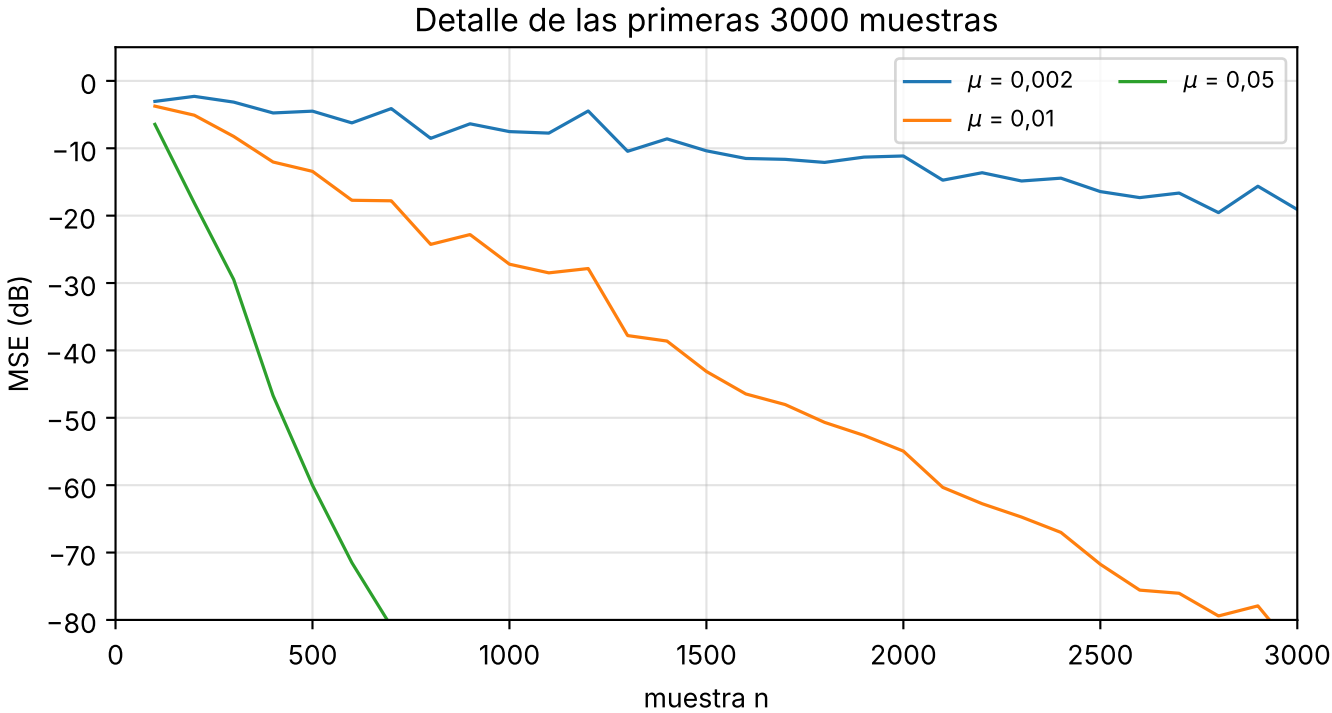
Detalle de las primeras 3000 muestras
μ = 0,002
μ = 0,01
μ = 0,05
MSE (dB)
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
muestra n