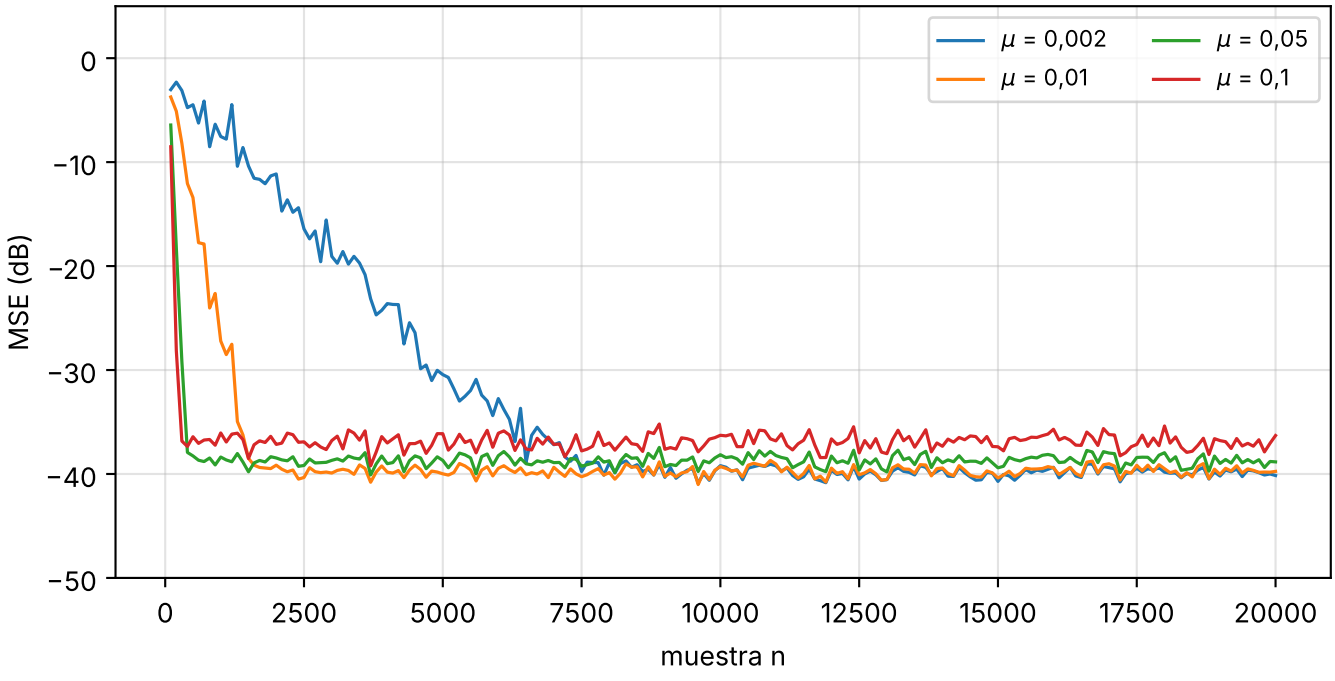
Con ruido de medición σ_v = 0,01 (σ_v^2 = −40 dB)
μ = 0,002
μ = 0,01
μ = 0,05
μ = 0,1
MSE (dB)
0
−10
−20
−30
−40
−50
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000
muestra n