

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Medicina Física y Rehabilitación

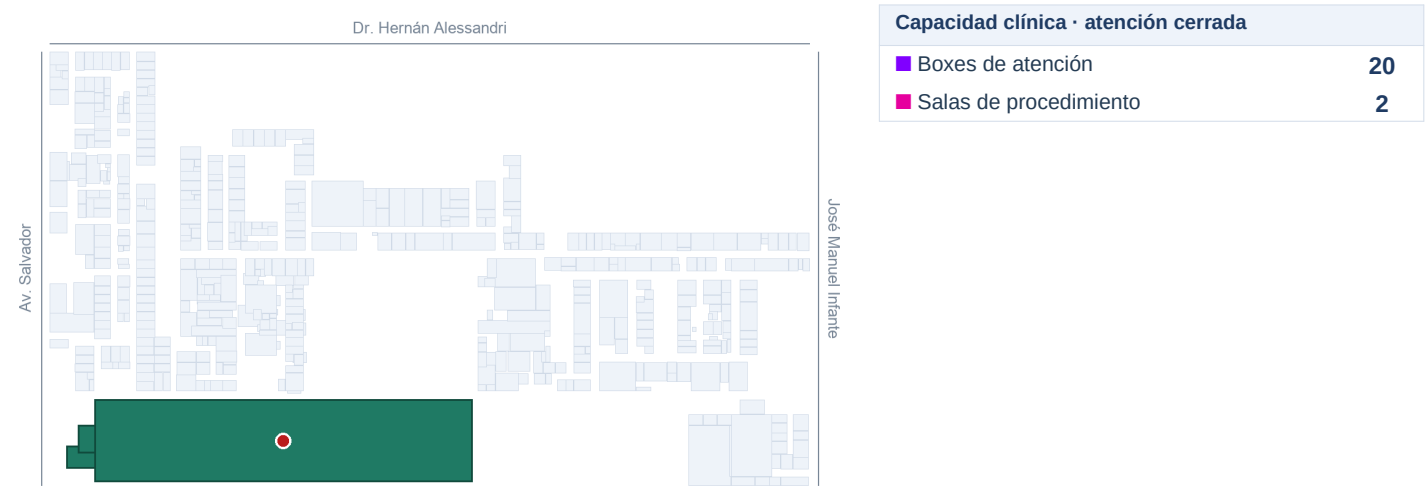
Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.


Tipos	Unidades	Recintos
105	370	20

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P-1	Atención Cerrada (HDS)	Medicina Física y Rehabilitacion



Piso P-1 · área «MED FISICA Y REHABILITACION»

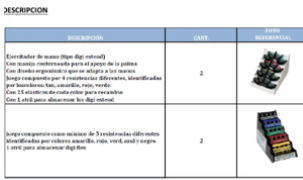
APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
 s de operación:	Negatoscopio 2 Caras MINSTON MSTXD LED2 Ficha en Drive >	4
	Lampara examen PROVITA Serie 1 L111111A rodable Ficha en Drive >	1
	Podoscopio Fisiomarket FMK-136 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		

 Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >		1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar		
 Balanza Silla SECA 954 Ficha en Drive >		1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar		
 Espirómetro SIBELMED DATOSPIR TOUCH DIAGNOSTIC F Ficha en Drive >		1
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Incluir treinta (30) Boquillas desechables por equipo ofertado, en caso que el equipo sea compatible o cuente con filtros antibacterianos, el oferente deberá incluir treinta (30) de éstos por cada equipo ofertado. • Incluir sistema de calibración por equipo ofertado, considerando todo lo necesario para su utilización • El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Conexión a través de USB con un computador • Incluir los cables y/o interfaces para garantizar la conexión del espirómetro al computador • Computador — Procesador i5 o superior.		
 Pimometro MD Diagnostics RP-CHECK Ficha en Drive >		2
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Sets de 100 boquillas (inicio de operación), reutilizables (desinfectable y esterilizables) • 03 Sets de boquillas desechables • 02 Pinzas nasales • 01 Set de tubos de silicona • 01 Set de válvulas unidireccionales (mínimo 10) • Baterías • Estuche de protección y almacenaje • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional		

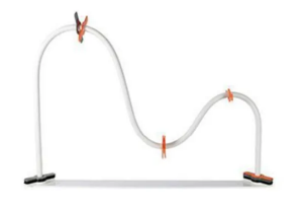
APOYO DIAGNÓSTICO


Imagen	Equipo / ítem	Cant.
 010000 Dinamómetro de Manos Digital con 8000 veces Características Resaltadas: Con una sola mano regulable en 5 posiciones, ajustable a cualquier tamaño de mano. Indicador de resistencia que muestra en pantalla la misma resistencia ejercida por el paciente. Registro de datos y 90 Kg. 000000 Calibrador de Alfileres 02 0000 Dinamómetro de Pulso Características de mano y dedos (función de protección). Para pruebas de fuerza de pulso, fuerza de pulso. Sistema de calibración para 20 a 100 N de fuerza. Indicador de fuerza en N y Kg. Rango de registro entre 0 - 20 Kg.	Set Evaluacion Manos Baseline - Jamar Varios Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Maletín de protección y almacenaje del set completo y/o de cada uno de sus componentes.		
 01 0000 Dinamómetro de Manos Digital con 8000 veces Características Resaltadas: Con una sola mano regulable en 5 posiciones, ajustable a cualquier tamaño de mano. Indicador de resistencia que muestra en pantalla la misma resistencia ejercida por el paciente. Registro de datos y 90 Kg. 000000 Calibrador de Alfileres 02 0000 Dinamómetro de Pulso Características de mano y dedos (función de protección). Para pruebas de fuerza de pulso, fuerza de pulso. Sistema de calibración para 20 a 100 N de fuerza. Indicador de fuerza en N y Kg. Rango de registro entre 0 - 20 Kg.	Set Goniometros Baseline Varios Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Maletín de protección y transporte para cada goniómetro		
	Espejo de Fonoaudiología Generica Espejo de Fonoaudiología Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Dinamometro Multiaplicacion Baseline 12-0380 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Estuche de protección y almacenaje. • 01 Batería instalada. • 03 Estribos.		
 El sistema además incluye un soporte para el paciente, permitiendo evaluar la marcha segura a pacientes que presentan una movilidad reducida o problemas para poder mantener una posición ligada. La terapia con Remediación ayuda a los pacientes a adquirir una marcha segura y eficaz a través de sensores biométricos y gráficos que se pueden adaptar individualmente a las necesidades de los pacientes.	Sistema Evaluacion Dinamica De La Marcha HP-COSMOS Zebris® FDM Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Impresora a color • 02 colchonetas • 02 juegos de arnés pequeños • 02 juegos de arnés medianos • 02 juegos de arnés grandes Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Estación de trabajo — Un computador all in one.		


APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Bomba Aspiracion Universal Ca-Mi ASKIR 36 BR	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• 02 Tubos de silicona autoclavables. • 01 Sonda de aspiración • 02 Filtro antibacterial		

APOYO TERAPÉUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Set Cuñas Fisiomarket Varios Ficha en Drive >	7
	Set Ejercicios Dedos Y Manos Cando 10-0757 / 10-0746 Ficha en Drive >	14
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Baston Ortopedico De Codera Fija CASA DEL ABUELO E007 Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Andador Plegable, con asiento, con Ruedas Fabrication (FE) Andador adulto plegable 43-2150 Ficha en Drive >	10
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Andador Sin Ruedas CILEF MEDICAL # JL913L Ficha en Drive >	10
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Baston Ortopedico De Codera Movil CASA DEL ABUELO E006 Ficha en Drive >	10
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		




	Disco De Freeman Fisiomarket FM-S Disco Madera Ficha en Drive >	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica.		
 ITEM: 100-092 DESCRIPCION: Set Perros Terapeuticos MARCA: CANDO MODELO: FMMA-1001 DESCRIPCION: Set de Perros Terapeuticos. Incluye 30 perros de plástico con 5 niveles de resistencia, diferenciados por color. Con Base de madera Para posicionar los perros. FUNCIONAMIENTO: Diseñado para desarrollar la fuerza de la mano y los dedos. Utilizado por pacientes que se recuperan de lesiones en las manos o personas con discapacidades. Utilizan los controladores y verifan de pin de puntos de varias maneras para evaluar e mejorar la destreza, la fuerza de agarrar y la coordinación.	Set Conos Terapeuticos JM Import Set de Conos Ficha en Drive >	7
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Bicicleta De Mano Cando 10-0712 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Bicicleta Ergonométrica Vertical Horizon COMFORT 3 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 estribos de fijación.		
	Escalera De Dedos Fabrication Enterprises 10-1160 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Set Perros Terapeuticos Fisiomarket - CANDO FMMA-1001 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		

 Pulsed & Continuous Shortwave SW-1000	Ultratermia ITO SW-1000 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 silla de madera por equipo		
	Set Pesas Y Mancuernas Varios Varios Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Carro o mueble para colgar o guardar las pesas (soporte para su almacenamiento)		
	Turbion De Extremidades Carci FM.HTC2039 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Con todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. P: Dentro de los accesorios necesarios para su funcionamiento, considerarán silla de turbión? CTAR: Sí, se considera dentro de los descrito en la Fila 28 de las EETT. P2: Accesorio necesario para correcto funcionamiento, se considera una silla? CTAR: Sí, se considera dentro de los descrito en la Fila 28 de las EETT.		
	Arco Para Hombro Fabrication Enterprises 10-1155 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Bicicleta Ergonometrica Horizontal Horizon Comfort R Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 estribos de fijación		
	Ejercitador De Mano Y Brazo Fisiomarket FMK-95 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica.		


	Electroestimulador De Analgesia WME TENS 7000 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Set de electrodos de estimulación, con 4 electrodos para el equipo de dos canales y cables.		
	Equipo Terapia De Manos Cando 10-0757 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Sets de 12 bandas elásticas cada uno, de cada color o resistencia requerida.		
	Mouse Paciente Neurologico AbleNet BIGTrack 2 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Pronosupinadora Fisiomarket FMK-68 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Rueda de Hombro Fisiomarket FMK-110 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Step Fisiomarket FMDS-5 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		

	Treadmill SCIFIT AC5000M Ficha en Drive >	4
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	
	Polea Doble Fisiomarket FMK-98	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 10 pesas de 1 kg.	
	Rodillera Articulada Kinetec Kinetec Prima Advance Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.	
	Rollos Terapeuticos Fisiomarket Varios Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.	
	Tabla Bidireccional De Equilibrio Fisiomarket FMK-125 Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.	
	Tablero Estimulacion De Percepcion Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Maletín de almacenaje	
	Almohadilla De Equilibrio Cando 30-1910 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.	

	Baston Ortopedico De Cuatro Apoyos Fabrication (FE) Baston Araña 43-2040 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.	
	Baño Parafina BTL 25L Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 2 cargas completas de parafina por equipo	
	Calentador Para Trabajo Termoplastico Whitehall Forma Splint 1502 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.	
	Elíptica Horizon 7.2 AFG Pro Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica	
	Lijador Bilateral Fisiomarket FMK-L20 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.	
	Material de Rehabilitacion Neuropsicologica I TIENDITA VARIOS Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	
	Puntero Cefalico Adapta Puntero Cefalico Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.	

	Set de Evaluación Alimentación Varios Varios Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 1 maleta de almacenamiento.		
	Set Implementos Terapeuticos Cando - Go Band Varios Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Equipo Computarizado Para Simulación Laboral TUR ISOFORCE Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Hardware — Computador integrado al equipo con capacidades acordes al sistema ofertado.		
	Set Electrodomesticos VARIO VARIOS Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios estándar de cada equipo		
	Set Herramientas Ortesis Varios Varios Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Set Instrumentos Y Vajilla Especializada Para AVD Varios Varios Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		

 he Perfect Pair -	Software Convertidor Texto-Voz FREEDOM SCIENTIFIC OPENBOOK Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Scanner	
	Ultrasonido BTL 4710 Smart Ficha en Drive >	6
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Carro de transporte • 03 Frascos de Gel Conductor	
	Sistema Suspension Antigravedad Medlinne SOPORTE ANTIGRAVITACIONAL ELECTRICO K118 Ficha en Drive >	4
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Posicionador para codo y mano/muñeca con lo necesario para su funcionamiento. • 1 base móvil.	
	Software Comunicacion Alternativa Tobii dynavox Tobii I Series - 16 Ficha en Drive >	4
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Incluye Dispositivo TD, base ajustable, cargador, placa de montaje, bolso de viaje, tarjeta de entrenamiento, manual y todo lo necesario que no se mencione en el listado anterior, para asegurar el funcionamiento completo del sistema. • Incluir Soporte de pie con ruedas, con adaptador UDS	
	Compresor Neumatico BTL Lymphastim 12 Topline Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 férulas para extremidades superiores que cubra muñeca, antebrazo y brazo. • 02 férulas para extremidades inferiores que cubra tobillo, rodilla ,muslo y cintura	
	Disco Equilibrio Y Fortalecimiento Muscular BOSU FMSD_-1201a Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Inflador tradicional para balones de ejercicio , con adaptador. • 02 manillas y cuerda.	

 BALONES DIVERSOS De material flexible y desinfectable. Para trabajo con terapia de pelota. (Diseño) 01 de 10 cm. diámetro x 100 gms. (Diseño) 02 de 15 cm. diámetro x 150 gms. (Diseño) 03 de 20 cm. diámetro x 200 gms. (Diseño) 04 de 25 cm. diámetro x 250 gms. BALONES DE EJERCICIOS Los pelotas de pelota Cauda tienen una superficie de corte PVC antideslizante con 1000 protuberancias para mayor tracción. Las pelotas pueden estar "infladas" para dar una sensación suave y flexible y completamente infladas para una sensación firme y resistente. Pueden usarse para 1000 repeticiones de ejercicios. Balón de 10 cm. diámetro Balón de 15 cm. diámetro Balón de 20 cm. diámetro Balón de 25 cm. diámetro BALONES MEDICINALES Balón medicinal de goma, libre de látex. 1 kg	Set Balones Terapeuticos Cando-Nacional Varios Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		Accesorios obligatorios • 2 bombines para balones de ejercicios. • 1 bombines para balón Bossu. • 4 par de manillas y cuerdas para balón Bossu.
	Calentador De Compresas Relief Pack Cod. 11-1975 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		Accesorios obligatorios • 24 compresas tamaño 25 x 30 cm. • 01 rack porta compresas. • 01 Tenaza toma compresas.
	Consola Juegos Nintendo OLED Blanco Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		Accesorios obligatorios • 01 Juego de Baile • 01 Juego de Deporte Extremidad Superior • 01 Juego de Cardiovascular • Incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de la consulta y los juegos
	Pantalla Tactil ELO 2202L 22INCH LCD Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		Accesorios obligatorios • Cable poder • Cable HDMI • Cable USB • Funda protectora
	Equipo De Terapia Combinada BTL 4825 Smart Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		Accesorios obligatorios • 01 Carro porta equipo. • 01 Cabezal doble frecuencia 1 y 3 MHz. • 03 set de Cintas de fijación (1 por electrodo). • 02 Cable paciente (2 canales). • 03 set de electrodos de caucho de 6 x 8 cm aprox. • 01 Botella de Gel

—	Sistema para Rehabilitacion Cardiologica con monitoreo y telemetria LODE Varios (revisar OC) Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 7 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Cables, conexiones y cualquier implemento que se requiera para hacer operativo el sistema. • 12 cables paciente (electrodos ECG) • Kit de 100 electrodos de ecg para la piel (contacto) Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • 01 Impresora Laser • Incluir 01 Impresora térmica de alta resolución, con capacidad de registro de uno o dos canales de ECG, velocidad de papel 25 mm/seg. Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Estación principal — Un computador all in one • Estaciones de reporte/trabajo — Dos computador all in one.	
	Electroestimulador GYMNA DUO 400 Ficha en Drive >	5
	» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Electrodos de estimulación de 6 x 8 cm aproximadamente. (+/- 4 cms) • 02 Electrodos de estimulación de 12x 12 cm aproximadamente (+/- 4 cms). • 01 Electrodo de punta y soporte electrodo. • 01 Carro de transporte con ruedas. • 05 Juegos de almohadillas para electrodos de goma con medidas acordes a los electrodos de estimulación. • 02 Cintas fijadoras 100 x 3 cm (tamaño referencial). • 02 Cintas fijadoras 250 x 3 cm (tamaño referencial). • 01 Cubierta protectora o maletín de almacenaje y transporte.	
	Electroestimulador Biofeedback Miografia Para Incontinencia VIVALTIS Phenix Liberty G3 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 11 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • 02 Cables EMG y para electrodo de referencia. • 01 Caja de electrodos adhesivos • 05 electrodos de referencia (4 x 6 cm) con 05 cables conectores de electrodos referencial • 05 juegos de almohadillas para electrodos de goma (4 x 6 cm) referencial • 10 Electrodo vaginales con respectivos cables y soporte aplicador listos para usar • 10 Electrodo anales con respectivos cables • 02 Sensores de presión anales • 02 sensores de presión intravaginales • 02 tubos de conexión para sondas de presion vaginal tipo CD • 02 tubo de conexión para sondas de presion anal • Control remoto (para uso del terapeuta)	
—	Set Entrenamiento Laboral Varios Varios Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 32 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 1 — Set 12 Pinceles tempera • 1 — Liston madera 1 metros de 1 x 2 • 1 — Pack tarugos lisos • 1 — Pack tarugos estriados • 1 — Pack guantes de trabajo diferentes tamaños (20 unidades) • 1 — Corta azulejos • 1 — Cola fria madera (300 ml) • 1 — Tempera. 12 colores • 1 — Kit pinceles 5 unidades • 1 — Set brochas 9 piezas	

- 1 — Barniz spray
- 1 — Esmalte al agua. 1/4 galon (color blanco)
- 1 — Set cajas plasticas 20 lts transparente con tapa (5 unidades)
- 1 — Set papel de regalo 70x190 cms
- 1 — Set Cartulinas 100 hojas
- 1 — Set de papel lustre 14 pliegos 12 colores
- 1 — Block papel entretenido 16x16 cm 18 unidades
- 1 — Lanas 100 gramos (colores a elección, sin repetir colores)
- 1 — Set Palos de brocheta 40 cm, 45 unidades
- 1 — Set de Palos de maqueta 3x3 o similar técnico
- 1 — Corta carton
- 1 — Repuesto hoja corta carton
- 1 — Set lapiz carpintero 12 piezas negro, HB 17.5 cm
- 1 — Set reglas plasticas (4 transparentes)
- 1 — Regla metalica 100 cm
- 1 — Pistola silicona para silicona delgada
- 1 — Set Barras silicona 7mm 90 unidades
- 1 — Set 6 Tizas colores
- 1 — Pizarra blanca 90 x 120
- 1 — Set plumones de pizarra, 4 plumones diferentes colores
- 1 — Tijeras diestro
- 1 — Tijeras zurdo

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	10
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 130.009 Piso Clínico CoinfyCare MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo Asiento Ruedas con freno   	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Escabel MALVESTIO FSH162102 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Mesa De Bipedestacion Fisiomarket FMAT09 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Silla De Ruedas Paciente Bariátrico SUNSHINE SILLA DE RUEDA ESTANDAR BARIATRICA W920 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Set de herramientas		
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad		

	Elevador De Paciente Handimove Elevador de Pacientes 1630 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 hamacas con reposa cabeza por equipo	
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	12
	» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable	
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	6
	» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable	
	Mesa Kanavel Fisiomarket FMK-160 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 5 pesas de 150 grs aprox. • 5 pesas de 250 grs aprox. • 5 pesas de 350 grs aprox. • 5 pesas de 500 grs aprox.	
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediátrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts	

MOBILIARIO CLÍNICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Camilla Examen Kinesiologica LUPUS MEDICAL HFL-5091/W Ficha en Drive >	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Colchonetas, juego de 12 Fisiomarket Colchonetas, Juego de 12 Ficha en Drive >	7
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Colchoneta Encatrada Fisiomarket FMK-61 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
 CARACTERÍSTICAS Marco de madera barnizada natural. Con 4 ruedas. Dimensiones: Rodante de 180 cm. X 70 cm. Área del espejo: 168 cm. X 60 cm. Cuadrícula en cuadros de 5 x 10 cms.	Espejo De Evaluacion Ortopedica Movil Medlinne K32 Espejo cuadrículado de corrección Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Barras Paralelas Fisiomarket FMK-80 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Espaldera Fisiomarket FMK-40 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		

	Escalera Esquina Kinesica Fisiomarket FMK-45 Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.	
	Barras Paralelas Plano Inclinado Fisiomarket FMK-45 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.	
	Cama Elastica (Mini) HANDLE MARCY ASG-40 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Barra de Sujeción para Paciente	
	Camilla Neurologica (Bobath) Carci 1330 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	
	Colchonetas, juego de 10 Fisiomarket FM-CEM1251 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	
	Elevador para piscina Handi Move 2815 LIR Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • Incluir Hamacas de Baño para soporte de Femur, espalda y cabeza. 01 por talla S, M, L y XL. Se aceptan medidas similares.	

	Escalera Esquina Kinesica 3 y 4 peldaños Fisiomarket FMK-43 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Espejo De Evaluacion Ortopedica Mural Bauhaus Espejo De Evaluación Ortopédica Mural Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Mesa Para Cuadriceps Fisiomarket FMK-55 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 06 pesas de 1 Kg • 04 pesas de 2 kg • 04 pesas de 0,5 kg		
	Camilla De Bipdestacion Carci CCB1210 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 bandeja de trabajo • 03 correas de fijación • 02 Apoya brazos, ajustables a la camilla. • 01 Barra de fijación para accesorios		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		

SIN CLASIFICAR		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Dinamometro De Cuadriceps Baseline 12-0400 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Estuche de almacenamiento		
	Pinzas Largo Alcance FABLINE (PERFORMANCE HEALTH) 50-1112 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Maquina Universal De Ejercicios MBH HBM-4 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Con set completo de accesorios Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Estación de Trabajo — 01 Columna de carga		