

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Psiquiatría Hospitalizados (UHCIP)

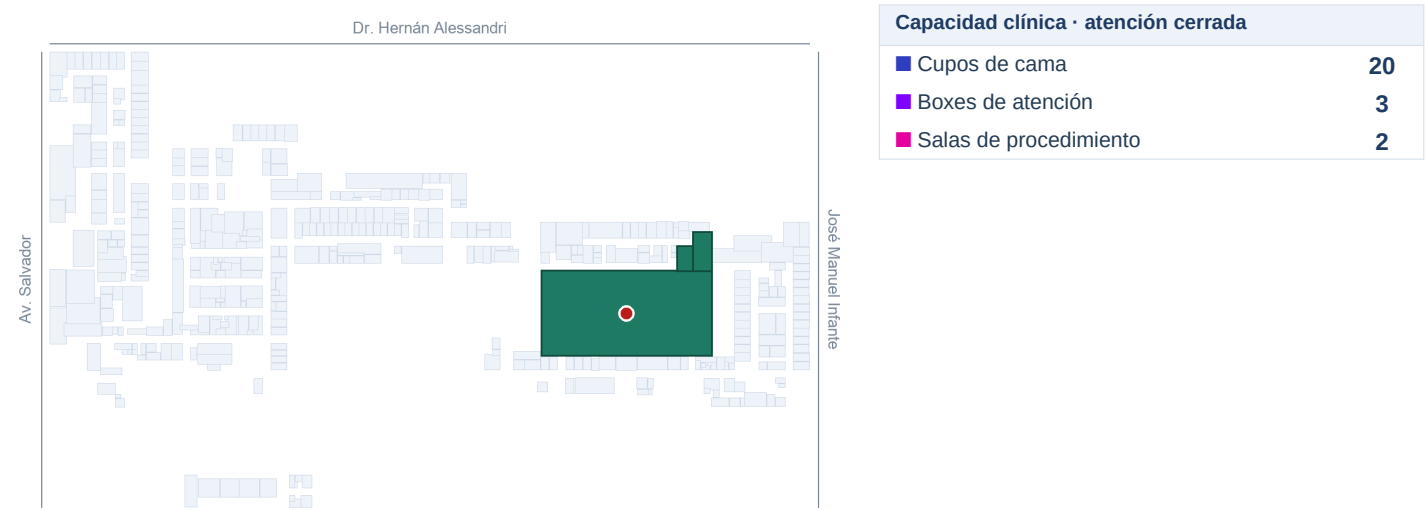
Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
28	83	10

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P1	Atención Cerrada (HDS)	Psiquiatría Hospitalizados (UHCIP)



Piso P1 · área «HOSP PSIQUIATRIA»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L111111A rodable Ficha en Drive >	2
	Negatoscopio 3 Caras MPLENT ZG-3B Ficha en Drive >	1
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 01 par de olivas de repuesto.		



Reserva	
Capacidad	150 kg (330 lbs)
Dimensiones	108 x 1,2 (32 x 31")
Dimensiones (cubierta)	1,2 x 1,03 x 0,72 (31 x 26 x 18")
Dimensiones (cubierta)	1,2 x 1,03 x 0,72 (31 x 26 x 18")
Plancha (cubierta)	1,2 x 1,03 x 0,72 (31 x 26 x 18")
Peso de instalación	~ 250 kg (550 lb)
Peso neto	120 kg (265 lbs)
Forma de alimentación	Electrica, suministro de corriente (aportado)
Forma de calefacción	Electrica (200 vatios para calefacción eléctrica)
Funciones	NO, MCM, MCM2, Modulo de calefacción eléctrica, NO
Modulo de calefacción de radiación electrodinamica	De acuerdo a EN 12453-1 + 2
Accesorios	- Plancha para calef. 471 - Plancha para 472 - Adaptador para cable eléctrico 473
Plancha para calef. (opcional)	
Dimensiones (cubierta)	42,8 x 1,03 x 0,72 (30 x 26 x 18")
Peso neto	4,5 kg (9,9 lbs)

SECA 777

[Ficha en Drive >](#)

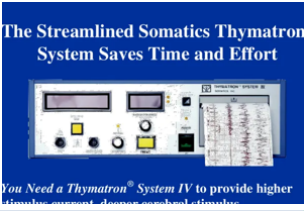
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)

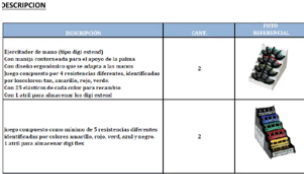
Accesorios básicos

- Bateria recargable
- Cargadores de batería, en caso de necesitar

APOYO DIAGNÓSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Set Evaluacion Cognitiva LOTCA Performance Health 1565159-MaddakDLOTCA	6


APOYO INDUSTRIAL		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
  Enjuagadoras desinfectadoras para hospitales y residencias de ancianos 	Lavadora De Chatas Steelco BP 100 HAE Ficha en Drive > » Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Armario de pared para almacenamiento de chatas (mínimo 5) y urinarios (mínimo 5) con rejilla y cuba de goteo, de acero inoxidable • 20 Chatas de acero inoxidable • 12 Patos urinarios de acero inoxidable	2

APOYO TERAPEUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Equipo Terapia Electroconvulsiva SOMATICS THYMATRON SYSTEM IV » Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) Impresora	1

APOYO TERAPÉUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Equipo de Musica SHARP SH-XL-B530 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Control remoto		
	Set Ejercicios Dedos Y Manos Cando 10-0757 / 10-0746 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Set Balones Terapeuticos Cando-Nacional Varios Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 2 bombines para balones de ejercicios. • 1 bombines para balón Bossu. • 4 par de manillas y cuerdas para balón Bossu.		

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Dispensador automatico de insumos y medicamentos 1 columna PYXIS MED STATION ES Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Componentes asociados · Computador (detectado en EETT)		
• Debe contar con mensajes de alerta en la estacion de trabajo de administrador y supervisor, para los niveles de inventarios, stock critico, apertura de puerta, control de vencimientos, entre otros		
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad		
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Fichas Y Rx MALVESTIO 329633 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Transporte Material MIXTA MSKT1210 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • No aplica		
	Mesa mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.069 Piso Clínico CoinfyCare MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo  Asiento  Ruedas con freno 	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		

	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Mobiliario Paciente Psiquiatrico PARAMOUNT PA-90000 Ficha en Drive >	22
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Almohada de espuma viscoelástica. • 01 Funda de repuesto cada dos colchones. • 04 Asas para contención		
	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable		
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediátrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MOBILIARIO CLÍNICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	
	Set Juego de Mesa Varias Varias Ficha en Drive >	3	
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 03 cajas plasticas con tapa de minimo 60 lt			
	Colchonetas, juego de 10 Fisiomarket FM-CEM1251 Ficha en Drive >	1	
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica			

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		