

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Pabellon Central

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

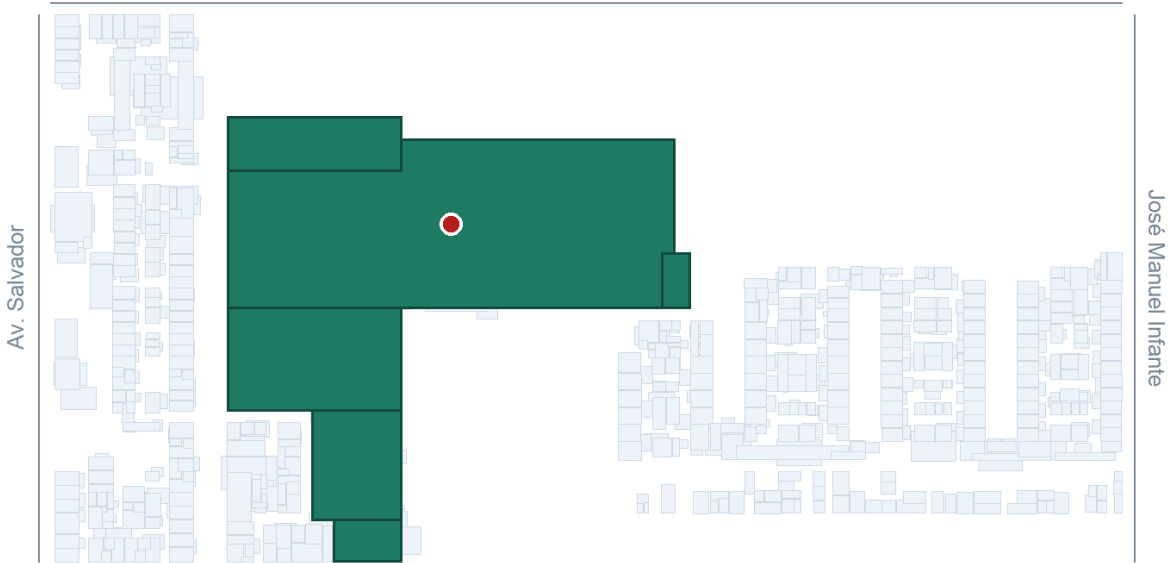
Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
110	889	30

Ubicación en el hospital

Pisos	Edificio	Servicio clínico 2026
P1 · P2	Atención Cerrada (HDS)	Pabellon Central

Dr. Hernán Alessandri




La planta corresponde al piso P2 · área «PABELLONES»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L111111A rodable Ficha en Drive >	2
	Oftalmoscopio Binocular indirecto HEINE OMEGA 500 Ficha en Drive >	1

	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	29
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 01 par de olivas de repuesto.		
	Lampara Hendidura C/Sistema de Video TOPCON SL-D4 LED Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador		
	Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar		
	Localizador Estimulador De Nervio Periferico Bbraun STIMUPLEX HNS 12 Ficha en Drive >	15
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • 02 cable conector de aguja de estimulación • 01 contenedor o maleta de almacenamiento para equipo y accesorios • Incluir Baterías		
	Doppler Vascular GENERAL ELECTRIC Logiq E pro Ficha en Drive >	2
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo · el servicio recibe 2 Cirugia — 2 equipos · Logiq E pro 1 × Transductor Sectorial Cardiologico 3Sc-RS · 1.7–4.0 MHz 1 × Transductor Abdominal Curvo C1-5-RS · 1.5–5.0 MHz 1 × Transductor Lineal 9L-R5 · 3.33–10.0 MHz 1 × Transductor Lineal Alta Frecuencia 12L-RS · 4.0–13.0 MHz		
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Bandeja para impresora • Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte para unidad renal y de UCI		

	Monitor nervio facial INOMED C2 XPLORE	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Carro de transporte • Set de electrodos • Sonda Monopolar • 01 simulador de paciente • 02 Interfaz a paciente	
	Otoftalmoscopio Portatil WELCHALLYN 92871-BLK Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Mínimo 8 Espéculos Universales y Reutilizables; indicar tamaños • Ampolletas • Pera de insuflación • Baterías recargables en caso de ser necesario • Cargador de Baterías en caso de ser necesario • Estuche o maletín de almacenaje y protección	
	Tonometro Aplanatico Perkins KOWA HA-2 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Baterías o pilas • Ampolleta de repuesto si lo requiere. • Cono de repuesto. • Cargador si aplica • Estuche • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.	

	Electrocardiografo COMEN H12 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 limpiador de cabezal térmico • 01 Cable de paciente ECG para 12 derivadas • 01 set de Electrodo de "parche" por equipo ofertado, que incluya al menos: 70 electrodos adulto • 01 Unidad resma de papel de impresión en formato compatible con impresora • 01 Cable tierra (extra a enchufe de 3 vías) • 02 Potes de gel conductor • 01 Set de Adaptadores para cables de paciente y/o electrodos. • El equipo debe incluir todos los accesorios o insumos que lo hagan funcional • Manual Servicio • Manual Usuario en español Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — Integrada al equipo • Cabezal térmico digital Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Conectividad — A computadora		





APOYO ENDOSCOPICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Rinovideolaringoscopio ATMOS FEES TROLLEY Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 01 recipiente para esterilización para cada video nasolaringoscopio • 01 maleta de transporte para cada video nasolaringoscopio • Test de hermeticidad • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.	
	Torre De Artroscopia Stryker 1688 4K incluye ópticas Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Todas las consolas — cable de poder • Videoprocesador — Teclado Propio con cobertor de protección • Fuente de Luz — Adaptadores para fuentes de luz, cable de fibras ópticas y ópticas de otras marcas existentes en el mercado y compatibles con ella Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Monitor Grado Médico o apto para imágenes médicas • Accesorios básicos Videoprocesador: incluir Teclado Propio con cobertor de protección	
	Torre De Video Laparoscopica/Endoscopica OLYMPUS EXERA III Ficha en Drive >	2
	» Lo que trae el equipo · cantidades totales del servicio · 2 torres Endoscopios (6 unidades en total) 2 x Colonoscopio Olympus CF-H170 2 x Duodenoscopio Olympus TJF-Q170V 2 x Gastrosocpio Olympus GIF-H170 Cadena de imagen (8 unidades en total) 2 x Cabezal de Camara Olympus CH-S190-XZ-E 2 x Fuente de Luz Olympus EVIS EXERA III CLV-190 2 x Monitor Olympus LMD2735MD 2 x Procesador de Video Olympus EVIS EXERA III CV-190 Accesorios (2 unidades en total) 2 x Insuflador CO2 Olympus UCR	
	» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios y Endoscopios por torre ofertada • Video panendoscopio terapéutico adulto — Cantidad: 2, se deben incluir todos los accesorios para limpieza y esterilizacion del endoscopio. Además maletín de almacenaje y transporte (para cada endoscopio ofertado) • Video colonoscopio terapéutico adulto — Cantidad: 1, se deben incluir todos los accesorios para limpieza y esterilizacion del endoscopio. Además maletín de almacenaje y transporte. • Video duodenoscopio — Cantidad: 1, se deben incluir todos los accesorios para limpieza y esterilizacion del endoscopio. Además maletín de almacenaje y transporte. Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Se debe incluir un Cabezal de Cámara compatible con el videoprocesador ofertado. (Uno para cada torre de video) • Videoprocesador con salida de video HD-SDI y DVI ó DVI-D	

	Torre De Video Endosonografia/Endoscopica FUJIFILM EPX-7000/SU-1 Ficha en Drive >	1
	» Lo que trae el equipo · cantidades totales del servicio Endoscopios (3 unidades en total) 1 × Endosonografo Lineal Terapeutico Fujinon EG-580UT 1 × Endosonografo Radial Terapeutico Fujinon EG-580UR 1 × Enteroscopia Terapeutico Fujinon EN-580T Cadena de imagen (4 unidades en total) 1 × Fuente de Luz Fujifilm BL-7000 1 × Monitor 26" Eizo EX2621 1 × Procesador de Ultrasonido Fujifilm SU-1 1 × Video Procesador Fujifilm VP-7000 Accesorios (1 unidad en total) 1 × Insuflador Balon Enteroscopia Fujifilm PB-30 » Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Fuente de Luz — Fuente de luz independiente o incluida dentro del videoprocesador • Videoprocesador — Procesador de Imagen 4K o Full HD • Videoprocesador con salida de video HD-SDI y DVI ó DVI-D • Videoprocesador — Teclado Propio con cobertor de protección Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Incluye computador y Impresora Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Incluye computador y Impresora	
	Torre De Video Laparoscopica Karl Storz IMAGE1 Ficha en Drive >	17
	» Lo que trae el equipo · configuración única: las 17 unidades del servicio salen iguales Visualización (1 ítem por equipo) 1 × Monitor quirúrgico 31" 4K (FS-P3102DS) <i>TFT LCD LED, 4096 × 2160, 350 cd/m², contraste 1500:1, respuesta 11 ms</i> Cadena de imagen (4 ítems por equipo) 1 × Procesador IMAGE1 S CONNECT II (TC201ES) <i>Hasta 3 módulos de enlace · 4K 3840 × 2160 y Full HD · KARL STORZ-SCB</i> 1 × Módulo de enlace IMAGE1 S 4U-Link (TC304) <i>Para cabezales UHD 4K, salida DisplayPort, obturador automático</i> 1 × Cabezal de cámara IMAGE1 S 4U (TH120) <i>CMOS 1/2.3", 3840 × 2160 px, lente f = 16 mm, 3 botones. Tecnologías SPIES: CLARA, CHROMA, SPECTRA A y B</i> 1 × Módulo multiconexión TELECAM C3 (TC100ES) <i>Conexión de equipos X-LINE y C-LINE · 2 salidas DVI</i> Grabación (1 ítem por equipo) 1 × AIDA con SMARTSCREEN (WD350-ES) <i>Dos canales hasta 4K, 2D/3D, memoria interna 2 TB, DICOM y HL7. Incluye OR1 SMARTSCREEN y teclado en español</i> Fuente de luz (2 ítems por equipo) 1 × Fuente de luz fría POWER LED 300 W (TL300) <i>> 30.000 h, 6.000 K, control de brillo 0–100 %</i> 1 × Cable de luz de fibra óptica 4,8 mm × 300 cm (495 NE) Insuflación (4 ítems por equipo) 1 × Insuflador Endoflator 50 SCB (UI500S1) <i>Flujo máx. 50 l/min, presión máx. 30 mmHg en pasos de 1 mmHg, calefacción de gas a 37 °C</i> 1 × Manguera metálica de alta presión para cilindro de CO■ 1 × Tubo de insuflación con filtro de alto flujo y conexión Luer-lock 1 × Manguera de 3 m con conector DISS para CO■ (COD. 1157)	

	Torre De Video ENDOSCOPIA Urologica Karl Storz IMAGE1 4U Ficha en Drive >	1
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo Endoscopios (3 ítems · 3 unidades en total) 1 × Videocistoscopio flexible <i>HD-VIEW, movilidad distal 210°/140°, dirección visual 0°, abertura 100°, canal de trabajo 7 Charr (2,3 mm), vaina 16 Charr, longitud útil 37 cm</i> 1 × Videoureterorrenoscopio flexible <i>FLEX XC, canal de trabajo 3,6 Charr (1,2 mm), dirección visual 0°, abertura 90°, vaina 8,5 Charr, longitud útil 70 cm</i> 1 × Ureterorrenoscopio rígido <i>Acero inoxidable, vaina de instrumentación 8,5–9,8 Fr, óptica de fibra con ocular acodado</i> Instrumental del videocistoscopio (4 ítems · 6 unidades en total) 1 × Pinza de biopsia estándar (27023ZE) 1 × Pinza para cuerpos extraños (27023FE) 2 × Pinza de recuperación de cuerpos extraños 2 × Cánula de irrigación Instrumental del videoureterorrenoscopio (4 ítems · 6 unidades en total) 1 × Pinza de biopsia (11275ZE) 1 × Pinza para cuerpos extraños (11275FE) 1 × Pinza de agarre tipo cocodrilo 3 Fr 3 × Canastillo Dormia desechable 3 Fr Instrumental del ureterorrenoscopio rígido (5 ítems · 6 unidades en total) 1 × Pinza de agarre para fragmentos 5 Fr 1 × Pinza para cálculos completos 5 Fr 1 × Pinza de biopsia 5 Fr de 60 cm (27425Z) 1 × Sonda Dormia 5 Fr con canastillo de 3 alambres 2 × Set de tapas para canal de instrumentos <i>paquetes de 10 unidades cada uno</i>		

APOYO INDUSTRIAL		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lavadora De Chatas Steelco BP 100 HAE Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Armario de pared para almacenamiento de chatas (mínimo 5) y urinarios (mínimo 5) con rejilla y cuba de goteo, de acero inoxidable • 20 Chatas de acero inoxidable • 12 Patos urinarios de acero inoxidable		

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Columna Pabellon II Nexor Port PDM960	17
	Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia LED SURTRON 400 HP TOUCH Ficha en Drive >	8
	Columna Pabellon I Nexor Port PDM960	7
	Mango Isquemia Automatico STRYKER SMARTPUMP Ficha en Drive >	7
	Unidad Criocirugia/Criocauterio OPTIKON CRYOLINE Ficha en Drive >	5
	Facoemulsificador C/Vitrector Anterior JOHNSONS&JOHNSON; SIGNATURE PRO Ficha en Drive >	4
	Mesa Quirurgica Traumatologia Trumpf PST 300 Ficha en Drive >	4
	Ciclodiodo transescleral con sondas IRIDEX IQ810 Ficha en Drive >	2

	Laser CO2 Otorrinolaringologia DEKA MELA SMARTXIDE TRIO	1
	Nefroscopio RICHARD WOLF NEFROSCOPIO 20,8. 12° Ficha en Drive >	1
	Lampara Quirurgica II Nexor Nova 800/600 Ficha en Drive >	16
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 20 conos reutilizables por equipo		
	Lampara Quirurgica I Nexor Nova 600 Ficha en Drive >	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 20 conos reutilizables por equipo		
	Lampara Quirurgica Rodable Trumpf iLED 7 Rodable Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 20 conos reutilizables por equipo		
	Morcelador HAWK MORCELADOR Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Kit inicial de insumos para 30 casos		

	Bomba Aspiracion Quirurgica Ca-Mi NEW HOSPIVAC 350 FULL Ficha en Drive >	24
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Tubos de silicona autoclavables. • 01 Sonda de aspiración • 01 Filtro antibacterial y/o hidrófugos.		
	Bomba irrigacion de pulsos FUJIFILM JW-3 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Incluir tubo y/o adaptador del canal auxiliar compatible con endoscopios marca FUJIFILM / FUJINON. Incluir UNO por cada bomba de irrigación ofertada • Incluir tubo y/o adaptador de irrigación para biopsia compatible con endoscopios marca FUJIFILM / FUJINON. Incluir UNO por cada bomba de irrigación ofertada • Incluir los componentes o accesorios esenciales para el correcto funcionamiento de la bomba de irrigación con los endoscopios marca FUJIFILM / FUJINON		
	Microscopio Quirurgico Zeiss Tivato 700 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios — 10 Set de fundas estériles para mangos • Adaptador para conexión de cámara de video HD o similar Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Sistema de video y captura imágenes — Cámara video integrada, 3 CCD (ó MOS), con óptica apocromática		
	Electrobisturi Disector Ultrasonico JOHNSON & JOHNSON GEN11 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Pedal o footswitch • Carro de transporte • Pinza ultrasónica para corte/coagulación de 23 CM largo y 5mm de diámetro. • Pinza Bipolar con tecnología ultrasónica de punta curva de corte/coagulación de 36 cm de largo y que selle vasos de hasta 7 mm.		
	Equipo Transfusion Rapida Autolog IQ Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Regulador de aspiración • Canister de aspiración, set bde bolsas de reinfusión y de desechos • Set de filtros desechables • Insumos — Siliconas de interconexión		


	Microscopio Quirurgico Otorrino LEICA PROvido Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 10 pares de capuchones o mangos esterilizables para mover el microscopio • Funda protectora • Incluye todo adaptador, accesorio, cable o pieza necesaria para realizar las funcionalidades solicitadas Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Incluir cámara de video Full HD CCD o HD 3CCD externa o integrada con enfoque óptico. O superior.		
	Unidad Para Electrocirugia Urologica Endoscopica VALLEYLAB VALLEYLAB FT10 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • 01 Pedal de Activacion • 01 Cable para Placa Paciente • 01 Carro de Transporte • Electrodo de retorno		
	Lupa Quirurgica Zeiss EYMAG PRO F Ficha en Drive >	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Protección contra salpicaduras • Cristales de protección • Líquido limpiador • Paños para limpiar • Funda o maletín de transporte • El equipo debe contener todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional		
	Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia Con Modulo De Argon VALLEYLAB / WEM Valleylab FT10 - ARGON 4 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • Unidad de Electrocirugia — 01 Pedal de Activacion • 01 Cable para Placa Paciente • 01 Carro de Transporte • Electrodo de retorno • Modulo de Argon — 01 pedal de comando • 01 cilindro sin carga		

	Esternotomo Electrico STRYKER System 8 Sierra Esternal Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Baterías — 04 Baterías reutilizables • Cargador de baterías — Cargador para al menos 4 baterías, de forma independiente y simultánea. • Indicador lumínico del estado de carga de la batería (batería completamente cargada, batería cargando, falla en la carga, o equivalentes). • Conexión a red eléctrica 220V, 50/60 Hz • Kit de Limpieza — Incluir al menos 01 cepillo de limpieza del equipo • Incluir al menos 01 aceite mineral para limpieza del equipo	
	Laser con Resectoscopios Lumenis/ Strauss Pulse 120H/ Resectoscopia Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios a incluir por el total de la oferta — Incluir UN (1) Pedal doble • Incluir DOS (2) Cables para Generador HF compatible con equipo Valleylab FT10 • Incluir CINCO (5) Fibras Ópticas con emisión FRONTAL, desechables, de diámetro del núcleo 200 µm • Incluir CINCO (5) Fibras Ópticas con emisión FRONTAL, desechables, de diámetro del núcleo 550 µm • Incluir DOS (2) Fibras Ópticas con emisión LATERAL, reutilizables para vaporización. • Incluir TRES (3) blas shield de respaldo.	
	Unidad Para Electrocirugia De Argon Plasma Para ENDOSCOPIA Digestiva KLS MARTIN MAXIUM Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • Unidad de Electrocirugia — 01 Pedal de Activacion • 01 Cable para Placa Paciente • 01 Carro de Transporte • Electrodo de retorno • Modulo de Argon — 01 pedal de comando • 01 cilindro sin carga	
	Microscopio Quirurgico Oftalmológico ZEISS OpmiLumera700 Callisto Full Ficha en Drive >	6
	» Accesorios y componentes de la tipología · 7 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 10 pares de capuchones o mangos esterilizables para mover el microscopio • 10 pares de capuchones o mangos esterilizables para mover ajustes del equipo • Funda protectora • Incluye todo adaptador, accesorio, cable o pieza necesaria para realizar las funciones solicitadas Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Sistema de video y visualización de imágenes — Cámara de video Full HD 3 sensores integrada. • Pantalla LCD o similar para visualización en tiempo real, grado médico de 21 [pulg] o superior, ubicada en estativo • Permite visualizar lo que se está grabando	

	Aspirador Ultrasonico Integra CUSA CLARITY Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 7 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 2 llaves torque • 2 Alambres de limpieza • 1 recipiente de succión reutilizable • 1 Juego de tubos desechables. • 1 Caja para esterilización • Se deben incorporar todos los accesorios que permitan el correcto funcionamiento del equipo y sus accesorios • FDA Y CE		
	Motor Quirurgico Grandes Fragmentos STRYKER System 8 Grandes Fragmentos Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • Baterías — Dos (2) baterías recargables con sus respectivos estuches. • Dos cubiertas estéril. • 2 Cepillos de limpieza por equipo • 2 Cargas de lubricantes • Contenedor con tapa y cesta para esterilización • Cesta de esterilización debe incluir sujetadores para pieza de mano y adaptadores • Incluir filtro permanente para contenedor de esterilización o 10 filtros desechables • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Motor Quirurgico Pequeños Fragmentos STRYKER System 8 cordless Driver Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • Baterías — Dos (2) baterías recargables • Dos cubiertas estéril. • 2 Cepillos de limpieza por equipo • 2 Cargas de lubricantes • Contenedor con tapa y cesta para esterilización • Cesta de esterilización debe incluir sujetadores para pieza de mano y adaptadores • Incluir filtro permanente para contenedor de esterilización o 10 filtros desechables • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		

	Laser Holmium 150 W QUANTA SYSTEM CYBER HO 150	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 9 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• Incluir UN Pedal Doble • Incluir DOS (2) Fibras Ópticas con emisión FRONTAL, reutilizables, de diámetro del núcleo 272 µm • Incluir DOS (2) Fibras Ópticas con emisión FRONTAL, reutilizables, de diámetro del núcleo 365 µm • Incluir DOS (2) Fibras Ópticas con emisión FRONTAL, reutilizables, de diámetro del núcleo 550 µm • Incluir DOS (2) Fibras Ópticas con emisión FRONTAL, reutilizables, de diámetro del núcleo 800 µm • Incluir DOS (2) Fibras Ópticas con emisión FRONTAL, reutilizables, de diámetro del núcleo 940 o 1000 µm • Incluir DOS (2) Peladores de cables por cada tipo de de Fibra solicitada • Incluir DOS (2) Tijeras o Cortadores de fibras • Incluir DOS (2) lentes de protección láser		
	Litotriptor Intracorporeo Neumatico EMS/WOLF Lithoclast Master con Nefroscopio 20.8 Charr Ficha en Drive >	1
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo		
Nefroscopio incluido (6 ítems · 6 unidades en total)		
1 × Óptica con visor paralelo 12°, 20.8 Charr		
Canal de trabajo oval de 15 Charr, con conductor de luz y cable de fibra incorporados. Es un SEGUNDO nefroscopio, adicional al [110107] del Pabellón de Endourología		
1 × Vaina quirúrgica 20.8 Charr		
Irrigación y aspiración continua con llave luer-lock giratoria		
1 × Set de dilatadores telescópicos de Alken 9–27 Charr		
1 × Dilatador especial de 30 Charr		
1 × Pinza para grandes cálculos con mandíbulas fenestradas, mango anular 35 cm		
1 × Pinza de agarre con mango e inserto separables 9F/355 mm		
Sondas de litotricia (4 ítems · 6 unidades en total)		
1 × Sonda 2,0 mm × 425 mm (6 Fr)		
2 × Sonda 1,0 mm × 605 mm (3 Fr)		
2 × Sonda 3,3 mm (403 mm y 330 mm)		
1 × Sonda para uso combinado con ultrasonido		
	Motor Quirurgico Otorrino Stryker PI Drive ESSx Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 12 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• Accesorios — Equipo debe incluir los siguientes acopladores para cada equipo ofertado: - UN (01) Acoplador para mini taladro recto pequeño - UN (01) Acoplador para mini taladro angulado pequeño • Incluir UN (01) motor de Sierra Sagital compatible con el equipo ofertado • Pedal de accionamiento • Equipo debe incluir UN (01) cable de conexión para cada pieza de mano a la consola por cada equipo ofertado • Piezas de mano para especialidad de Otorrino • Kit de bajadas para irrigación • Incluir set de limpieza que considere a lo menos: 1. Un (01) Lubricante 2. Un (01) Cepillo de limpieza • Incluir UNA (01) caja y/o cesta para esterilización con todos los accesorios necesarios para su normal funcionamiento por equipo ofertado. • Guía de uso rápido incorporada • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Certificaciones Internacionales — FDA y/o CE y/o JIS y/o equivalente técnico • Normas de seguridad electromedica — IEC 60601-1-1 (Requerimientos de seguridad eléctrica) / IEC 60601 -1-2 (Requerimientos de seguridad electromagnetismo) / Clase I tipo BF		

 two configurations ry R-Evolution® a micro-invasive tool with IOP controlled Active 3P Control™ using is by adjusting IOP or the equipment abilities. Optimized logs for consistent and multiple proven Safe of proprietary vital application, is 1280, 250 and 270 free independent enhanced and integrated Green screen, wireless foot removable voice and	Vitreosector posterior OPTIKON R-EVOLUTION CR Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 14 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Set Tijeras neumáticas (para resección vítreo) • Pieza de mano para tijera intraocular • Cable de alta presión (neumática) • Cassette colector de fluidos • Pieza de mano facofragmentación, esterilizable en autoclave a vapor. • Terminales de para vitrectomía posterior. • Set de insumos para inicio de operación (cuchillitos, tapones esclerales, puntas de sondas, otros) • Terminales de diatermia • Cable de diatermia • Tubería Bomba intercambio fluido/gas, en caso de ser necesario • Ruedas; incorporadas al equipo o en carro • Soporte para fluidos (si se requiere) • Pedal multifunción y/o control remoto • Todo otro accesorio indispensable para el correcto uso del equipo y que no haya sido nombrados en estas Especificaciones Técnicas.		
	Mesa Quirúrgica Universal TRUMPF/ HILLROM / BAXTER PST 300 Ficha en Drive >	14
» Accesorios y componentes de la tipología · 18 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) ACCESORIOS CIRUGÍA GENERAL • 01 Unidad para el total de Mesas Qx Universal — Dispositivo para colocación rectal que permita reducir las presiones abdominales. • 01 Par para el total de Mesas Qx Universal — Un par (2) de soporte de rodillas ajustables, incluyen correas de sujeción. • 01 Unidad para el total de Mesas Qx Universal — Placa de respaldo radiolúcido en 360°, dimensiones de 520 (mm) ancho (+/-100mm) x1150 (mm) largo (+/-100 mm). Incluir adaptador de accesorio solicitado. • Incluir accesorios de fijación y adaptadores de accesorios. ACCESORIOS UROLOGÍA GINECOLOGÍA • Apoya pierna tipo Goepel (Cantidad: 03 Pares para el Total de las Mesas Qx Universal) — Un par de porta piernas tipo Goepel o similar adulto , con fijación rotatoria. Con almohadillas y correas de fijación. • Tamaño adulto • Acolchado integrado • De acero inoxidable • Incluye fijador, pieza de anclaje, clamp o cualquier otro requerido para montar en mesa • Dos pares de piernas tipo Goepel o similar extra ancho (02 Para para el Total de Mesas Qx Univesal) — Un par de piernas tipo Goepel o similar extra ancho, idóneo para pacientes con obesidad, incluye fijadores. • Recipiente colector (03 unidad para el Total de la Propuesta) — Recipiente colector esterilizable. • Bandeja para Instrumental (03 para el Total de la Propuesta) — Bandeja para instrumental, capacidad de carga aproximada de 3 kgs como mínimo. • Carro porta Accesorios (03 Unidades para el total de la propuesta) — Carro porta accesorios, que permita almacenar todos los accesorios de la especialidad, 1 unidad. • Incluir accesorios de fijación y adaptadores a mesa. ACCESORIOS NEUROCIRUGÍA (solo 1 set par para el total de las mesas) • Sistema de fijación craneal radiolúcido (Fijador de craneo Mayfield o similar (3 pines), adaptador de bola Mayfield o similar y unidad ultra base Mayfield o similar). • Tres (3) pines adulto reusables. • Herradura gel adulto radiolúcido. • Incluir accesorios de fijación y adaptadores a mesa.		

	Maquina Anestesia Alta Complejidad General Electric CS750 + B650 ONE Ficha en Drive >	18
» Accesorios y componentes de la tipología · 19 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • ECG — 1 cable troncal o extensión ECG • 1 cable de 3 derivaciones ECG • 1 cable de 5 derivaciones ECG • 1 cable de 10 derivaciones ECG • Presión Arterial No Invasiva — 1 brazalete PANI adulto pequeño, reusable • 1 brazalete PANI adulto mediano, reusable • 1 brazalete PANI adulto grande, reusable • 1 brazalete PANI adulto obeso morbidito, reusable • SPO2 — 1 cable troncal o de extensión • 1 sensor SpO2 pinza adulto • 1 sensor SpO2 oreja • Temperatura — 1 sonda de temperatura corporal reutilizable • 1 sonda de temperatura oro/rectal reutilizable • Presiones Invasiva — 2 cables de presión invasiva • Análisis de gases y Capnografía — Incluir al menos 2 trampas de agua y líneas de muestra de capnografía. • BIS — Electrodo BIS bilateral • TMN — Set completo con adaptador de dedos y cables para electroestimuladores • Cilindros de gases — Cilindros de O2, Aire y N2O (llenos al momento de la entrega). Con llaves de apertura cilindro. • El equipo debe contener todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional		
	Maquina Anestesia Mediana Complejidad General Electric CS750 + B650 ONE Ficha en Drive >	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 19 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • ECG — 1 cable troncal o extensión ECG • 1 cable de 3 derivaciones ECG • 1 cable de 5 derivaciones ECG • 1 cable de 10 derivaciones ECG • Presión Arterial No Invasiva — 1 brazalete PANI adulto pequeño, reusable • 1 brazalete PANI adulto mediano, reusable • 1 brazalete PANI adulto grande, reusable • 1 brazalete PANI adulto obeso morbidito, reusable • SPO2 — 1 cable troncal o de extensión • 1 sensor SpO2 pinza adulto • 1 sensor SpO2 oreja • Temperatura — 1 sonda de temperatura corporal reutilizable • 1 sonda de temperatura oro/rectal reutilizable • Presiones Invasiva — 2 cables de presión invasiva • Análisis de gases y Capnografía — Incluir al menos 2 trampas de agua y líneas de muestra de capnografía. • BIS — Electrodo BIS bilateral • TMN — Set completo con adaptador de dedos y cables para electroestimuladores • Cilindros de gases — Cilindros de O2, Aire y N2O (llenos al momento de la entrega). Con llaves de apertura cilindro. • El equipo debe contener todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional		

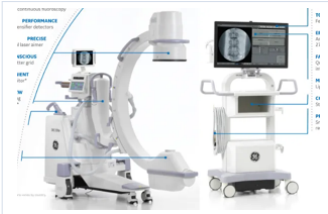
 ERBE VIO 3 - IES 3 Ficha en Drive >	Unidad Para Electrocirugia Con Fusion De Tejidos ERBE VIO 3 - IES 3 Ficha en Drive >	14
	» Accesorios y componentes de la tipología · 31 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • Carro de Transporte — Cuatro ruedas • Cantidad de frenos ≥ 2 • Bandeja para soporte de accesorios • Gancho o soporte que garantice el orden de los cables y pedal. • Pintura electroestática • Con sistema de fijación a carro o sistema antidesplazamiento para fijación del equipo. • Accesorios — 01Cable extensión electrodo monopolar reusable. • 05 Mango porta electrodo con interruptor digital con botón para corte y coagulación • 5 Placas paciente adulto • 2 Cables placa paciente • Electrodo para cirugía abierta longitud de trabajo 25 [mm] referencial • Electrodo para laparoscopia longitud de trabajo 320 [mm] referencial • Juego de electrodos de aguja, 10 o más electrodos incluidos de diferentes medidas. • Juego de electrodos de paleta,10 o más electrodos incluidos de diferentes medidas. • Juego de electrodos de bola,10 electrodos incluidos de diferentes medidas. • Juego de electrodos de asa de cinta, 10 incluidos de diferentes medidas. • Juego de pinzas bipolares rectas, 5 incluidas de diferentes medidas. • Juego de pinzas bipolares acodadas, 5 incluidas de diferentes medidas. • Juego de pinzas bipolares tipo bayoneta, 5 incluidas. • Instrumento o pinza fusión tejido bipolar, 6. • 01 Pinza bipolar, 1 [mm] referencial tipo bayoneta recta, 2. • 02 Pinzas laparoscópicas • 02 Pinzas abiertas • 01 Adaptador Universal reusable. • Cable alimentación eléctrica • 01 o más Pedales para activación monopolar y bipolar. • Incluye toda conexión, cable, parte o accesorio requerido para el funcionamiento • Incluye evacuador de humo compatible • El equipo deberá incorporar todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, con independencia de si estas fueron o no descritas dentro del presente Formulario Técnico • FDA y/o CE y/o JIS y/o equivalente técnico • IEC 60601-1 o certificación homologable	

APOYO TERAPEUTICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Calentador De Fluido STHILER ELECTRONICS ALTROTHERM PLUS Ficha en Drive >	13
	Acelerador Infusion 1000 cc. VISTARMED V0010P Ficha en Drive >	35
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica.		
	Acelerador Infusion 500 cc. VISTARMED V0005P Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica.		
	Calentador De Paciente 3M BAIR HUGGER 675 Ficha en Drive >	29
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios 10 Mantas para adulto por equipo. - Rodable.		
	Bomba Alto Flujo Y Calentador De Sueros Belmont Infusor Rapido Belmont Ri-2 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios - Soporte Universal - Con abrazadera para soporte universal		
	Gabinete Calentador De Suero MEMMERT IN160 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos - Incluye todo cable, conexión o accesorio requerido para el funcionamiento - Manual Servicio en español o inglés - Manual Usuario en español		

	Generador De Pulso Unicameral OSCOR / OSYPKA 101 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 03 Cables paciente para estimulación ventricular por cada equipo • 02 Pilas/Baterías (según corresponda) por cada equipo • Incluir todo accesorio necesario para el funcionamiento correcto del equipo, como por ejemplo: cables extensores		
	Generador De Pulso Bicameral LIVETEC T20 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 03 Cables paciente para estimulación ventricular por cada equipo • 03 Cables paciente para estimulación auricular por cada equipo • 02 Cables alargadores con sus correspondientes conexiones, por cada equipo ofertado • 02 Pilas/Baterías (según corresponda) por cada equipo • Incluir todo accesorio necesario para el funcionamiento correcto del equipo, como por ejemplo: cables extensores		
	Balon contrapulsacion aortico MAQUET-GETINGE CARDIOSAVE Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 7 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Carro transporte incorporado al equipo • Cilindro principal de Helio y de respaldo • 02 Cable de ECG de 5 electrodos • Cable de Presión invasiva (según tipo de transductor usado en institución) • Simulador de paciente (para verificar funcionamiento) • 03 cateteres de cada medida, con balones nuevos, listos para ser utilizados (Para balones de al menos 30cc ± 5cc y 40 cc ± 5cc) Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora integrada al equipo o externa con interfase USB 2.0 o mínimo RS232		
	Ventilador De Transporte Dräger Oxylog 3000 plus Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 12 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 03 válvulas espiratorias o cassettes espiratorios reutilizables • 02 Circuito Paciente • 01 Sensor de oxígeno si aplica • 02 Sensores de flujo rama exhalatoria con calentador de gases espirados • 02 Filtros de bacterias • 02 Circuitos desechables para humidificación pasiva • 01 Manguera para O2 normada de 3 mts • 01 set de máscaras con la configuración: Full Face, Total face, Oro - Nasales, Tubo endotraqueal/Traqueotomía • 01 Cilindro de oxígeno tipo E o similar con todos los accesorios e insumos necesarios para su funcionamiento • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original		

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Ecografo doppler para pabellones MINDRAY TE7 ACE Ficha en Drive >	6
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo · el servicio recibe 6 Hepatobiliar — 2 equipos · TE7 ACE 1 × Transductor Lineal Vascular Periferico L12-4s · 3.0–13.0 MHz 1 × Transductor Intraoperatorio T Biplanar 7LT4s · 3.5–13.5 MHz 1 × Transductor Laparoscopico Flexible LAP13-4CS · 2.6–12.8 MHz Cirugia — 4 equipos · TE9 1 × Transductor Sectorial Cardiologico SP5-1S · 1.0–5.0 MHz 1 × Transductor Abdominal Curvo C5-1s · 1.0–5.7 MHz 1 × Transductor Lineal Aplicaciones Vasculares L12-4s · 3.0–13.0 MHz 1 × Transductor Lineal Alta Frecuencia L14-6NS · 3.5–16.0 MHz » Accesorios y componentes de la tipología · 20 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Transductores y Accesorios (por cada equipo ofertado) • Carro de transporte — Incluir UN Carro de Transporte compatible con Ecógrafo, por cada equipo ofertado • Transductores (Incluir los siguientes transductores por cada equipo ofertado) — Un (1) Transductor cardiológico (sectorial) adulto Rango Referencial de Frecuencias: 1 a 5 MHz o superior Nota: Entiéndase superior aquel rango que sea mayor a la cota superior y/o menor la cota inferior, siempre y cuando abarque el rango referencial solicitado. • Un (1) Transductor Abdominal Curvo adulto Rango Referencial de Frecuencias: 2 a 5 MHz o superior Nota: Entiéndase superior aquel rango que sea mayor a la cota superior y/o menor la cota inferior, siempre y cuando abarque el rango referencial solicitado. • Un (1) Transductor lineal para aplicaciones vasculares. Rango Referencial de Frecuencias: 4 a 8 MHz o superior Nota: Entiéndase superior aquel rango que sea mayor a la cota superior y/o menor la cota inferior, siempre y cuando abarque el rango referencial solicitado. • Un (1) Transductor Lineal de alta frecuencia Rango de referencia: 4 a 13 Mhz o superior Nota: Entiéndase superior aquel rango que sea mayor a la cota superior y/o menor la cota inferior, siempre y cuando abarque el rango referencial solicitado. • Modos de imagen para Ecotomógrafo Portátil Pabellón — Modos de escaneo Modo B, Modo M, Doppler, Color, 2D, imagen armónica • Software de especialidad para Ecotomógrafo Portátil Pabellón — Aplicaciones Doppler color velocidad, Doppler de potencia en color, Doppler pulsado, imagen Doppler tisular • Paquete de cálculos y mediciones generales • Paquete de mediciones y cálculos vasculares • Visualización de agujas • Paquete de mediciones y cálculos cardíacos • Estudio partes blandas y articulaciones • Estudios abdominales • Bloqueo de plexo nervioso • Software para reducción de ruido granular Accesorios obligatorios • Accesorios Obligatorios para cada equipo — Un (1) Cable para exportar imágenes • Un (1) Cable para exportar audio/video • Incluir guía de aguja para transductores • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Bandeja para impresora		

	Ecotomografo doppler portátil GENERAL ELECTRIC Logiq E pro	2
	» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo · el servicio recibe 2 Cirugia — 2 equipos · Logiq E pro 1 × Transductor Sectorial Cardiologico sin modelo ni frecuencia declarados 1 × Transductor Abdominal Curvo sin modelo ni frecuencia declarados 1 × Transductor Vascular Periferico sin modelo ni frecuencia declarados Además, 1 de estos equipos llevan: 1 × Transductor Transesofagico » Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios Obligatorios para cada equipo — Un (1) Kit de accesorios para uso de ECG Cable de paciente de 12 derivadas, se debe incluir kit de electrodos desechables y electrodos reutilizables para el cable ofertado. • Un (1) Cable para exportar imágenes • Un (1) Cable para exportar audio/video • Incluir guía de aguja para todos los transductores solicitados que tengan dicha opción. (Se coordinará con mayor detalle con el adjudicado) • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Consola — Portátil tipo laptop o point of care Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Bandeja para impresora • Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte	
 M9 Ultrasound System	Ecografo Portatil Urologia MINDRAY M9 Ficha en Drive >	1
	» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo Urologia — 1 equipo · M9 1 × Transductor Cardiologico SP5-1s · 1,0 - 5,0 MHz. 1 × Transductor Abdominal Curvo C5-1s · 1.0–5.7 MHz 1 × Transductor Lineal Bloqueo Nervioso L12-4s · 3.0–13.0 MHz 1 × Transductor Transesofagico P7-3Ts · 1.9–8.2 MHz 1 × Transductor Transrectar Doble Vista Biplanar ELC13-4s · 3.5–9.5 MHz » Accesorios y componentes de la tipología · 11 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Un (1) Cable para exportar imágenes • Un (1) Cable para exportar audio/video • Incluir guía de aguja para transductores que tengan esta alternativa. Se coordinará con mayor detalle con el adjudicado • Autorizaciones de Comercialización — FDA y/o CE y/o JIS y/o equivalente técnico • Certificaciones de Calidad de Fabricación — ISO 13485:2003 o superior • Certificaciones de Seguridad — NCh 2893 y/o IEC 60601 o equivalente técnico • Certificación Sistema de Gestión de Calidad — ISO 9001 Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Consola — Portátil tipo laptop Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Bandeja para impresora • Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte para unidad renal y de UCI • Interfaz DICOM FULL (Send, Print, Query, Retrieve, Worklist, Estadistics)	

	Equipo Rx Arco C GENERAL ELECTRIC OEC Elite II 12" Ficha en Drive >	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Carro de visualización • 100 Cobertores estériles desechables para Arco C • Cable de red Lan (Ethernet) para transmisión de imágenes • Cable de video para conexión con pantalla remota en caso de requerir • Disparador y pedal		
	Ecotomografo Doppler Color Multiproposito GE HEALTHCARE LOGIQ FORTIS Ficha en Drive >	1
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo Vascular — 2 equipos · LOGIQ FORTIS 1 × Transductor Lineal Alta Frecuencia ML6-15-D · 4.0–15.0 MHz 1 × Transductor Especifico Aplicación Vascular L2-9-D · 2.0–9.0 MHz 1 × Transductor Sectorial Cardiologico M5Ss-D · 1.0–5.0 MHz 1 × Transductor Convexo C1-6-D · 1.5–6.0 MHz El resumen de ecógrafos declara 2 equipos para este servicio y el Despliegue oficial 1. Requiere revisión.		
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Una (1) Funda protector. • Un (1) Cable para exportar imágenes • Un (1) Cable para exportar audio/video • Incluir guía de aguja para transductores • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Bandeja para impresora • Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Composición de imágenes panorámicas en modo B		
	Angiografo Multiproposito II Siemens Healthineers Artis Zee Ceiling Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 25 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Intercomunicador entre sala de examen y sala de comando • 03 Apoyabrazos radiolucidos • 01 Soportes para infusiones, medio de contraste y transductores • 02 kit correas fijación paciente • 02 kit cuñas posicionamiento paciente (solo en caso de ser necesario) • 07 Set de protección radiológica personal (protector de cuello + faldón + chaleco) • 04 Lentes de protección radiológica personal • 02 Kit de Pares Guantes de protección radiológica personal (cada kit debe tener al menos medida S, M, L) • 3 Colgadores para set de proteccion radiologica • 01 mesa auxiliar acero inoxidable preparación stent, intercambio de balón • Monitor ECG/ Signos Vitales Mediana complejidad — 02 Cable de ECG para 12 derivaciones con cables de latiguillos radiolúcidos • 02 Cable y Sensor reutilizable SpO2 pediátrico/adulto • 03 Cable interfase para transductor de presión invasiva, • 04 Tubo y Set Manguitos para PNI de todos los tamaños • 02 Cable para gasto cardíaco • 02 Sensor de temperatura externo		

- Mesa Quirúrgica — Accesorios básicos de posicionamiento de paciente y anestesia Respuesta: kit de cuñas posicionamiento de paciente, 4 brazos y 4 apoyacodos compatibles, de materialidad tipo gel o similar
- Dos cintas o correas de sujeción de paciente ajustable para distintos tipos de pacientes, con instalación en rieles laterales de medidas 800 x 100 mm
- Dos cintas o correas de sujeción de paciente ajustable para distintos tipos de pacientes, con instalación en rieles laterales de medidas 950 x 100 mm
- Un Kit de Correas de fijación para pacientes bariátricos a tablero con hebilla
- Un Kit de Placas de ensanchamiento largas, 2 piezas para ensanchar tablero de mesa en pacientes adiposos(par)
- Un Kit de Placas de ensanchamiento cortas, 2 piezas para ensanchar tablero de mesa en pacientes adiposos(par)
- Un Par de Porta pierneras anchos para pacientes adiposos, dos pares para la totalidad de las mesas

Componentes asociados · Computador (detectado en EETT)

- Estación de trabajo — Mínimo 03 Monitores de 19" de alta resolución (Referencia, Live y datos)
- Mouse y Teclado alfanumérico

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
 temperature range, CDC, clinical laboratories. CE MC-5L126	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño MIDEA BIOMEDICAL MC-5L126	2
	Campana De extraccion gases organicos I ESCO EFD-4B8 Ficha en Drive >	1
	Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas PYXIS MED STATION ES Ficha en Drive >	11
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Debe contar con mensajes de alerta en la estacion de trabajo de administrador y supervisor, para los niveles de inventarios, stock critico, apertura de puerta, control de vencimientos, entre otros		
	Dispensador automatico de insumos y medicamentos 3 columnas PYXIS MED STATION ES - SUPPLY STATION Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Debe contar con mensajes de alerta en la estacion de trabajo de administrador y supervisor, para los niveles de inventarios, stock critico, apertura de puerta, control de vencimientos, entre otros		
	Dispensador automatico de insumos y medicamentos 1 columna PYXIS MED STATION ES Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Debe contar con mensajes de alerta en la estacion de trabajo de administrador y supervisor, para los niveles de inventarios, stock critico, apertura de puerta, control de vencimientos, entre otros		
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Carro Quirúrgico MALVESTIO 328836 Ficha en Drive >	47
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.069 Piso Clínico CoinfyCare MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Regulable Asiento Ruedas con freno	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	49
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Soporte Universal SCHMITZ SCHMITZ PORTASUERO 242.2351.0 Ficha en Drive >	40
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Mesa Arsenalera MALVESTIO 327081 Ficha en Drive >	38
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No Aplica		
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	28
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Carro Compresero LUPUS MEDICAL OPR-1093 Ficha en Drive >	26
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios NA		

	Tarima INSIPITAL BS10.11 Ficha en Drive >	21
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	
	Sillon Clinico LOS PINOS SMM-251 Ficha en Drive >	20
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica	
	Carro 2 bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	8
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	6
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad	
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	6
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica	
	Sillon oftalmologia (cirujano) UFSK SURGITREND Ficha en Drive >	6
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	

	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	4
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	
	Sistema Transferencia Paciente MEDICARE SYSTEM MEDI ROLLER PRO Ficha en Drive >	4
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	
	Escabel MALVESTIO FSH162102 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica	
	Carro Anestesia BAILIDA MX-34ANE Ficha en Drive >	26
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Sistema de 4 Compartimientos • 01 Sistema de 6 Compartimientos	
	Camilla Quirurgica Oftalmologica STRYKER 5051 Ficha en Drive >	6
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable	
	Armario almacenamiento cateteres TECNIFARMA COLUMNA FARMABOX ALMACENAMIENTO CATETERES Ficha en Drive >	4
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional. • Dos cajoneras para material de angiografía.	

Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable	
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	50
	» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable	
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	7
	» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediátrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts	

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Oxímetro De Pulso MINDRAY PM-60 Ficha en Drive >	20
	» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Sensores de SpO2 de dedo, tipo pinza adulto • Sensor de SpO2 en oreja para paciente adulto • Protector de goma antigolpes • Estuche de almacenaje y protección • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.	
	Poligrafo Electrofisiologia Boston Scientific Lab System Pro	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Catéter electrodo cuadripolar 5F o 6F de 120 cms aproximados de largo con curva para AD, VD y HIS. Diversos espaciados. • Catéter electrodo decapolar 6F sin lumen de 120 cm aproximados de largo, curva fija para SC, Diversos espaciados. • Catéter electrodo decapolar 7F sin lumen (de al menos 90 cm. de largo) con electrodo distal de 2 mm, dirigible con alcance de curva de 55 mm, diversos espaciados. • Conectores para Catéteres de Diagnostico. (3 CLS, 2 DECA, 4 CUADRI) • Catéter electrodo cuadripolar 7F de ablación 4mm aproximados • Catéter electrodo cuadripolar 7F de ablación 8mm aproximados • Conectores para catéteres de ablación. Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Incluir Hardware (PC, teclado, mouse, monitores, impresora y todo lo necesario para el correcto funcionamiento) y software que permita el manejo del flujo de datos en la sala de electrofisiología	
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	7
	» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto	

	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	11
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		
	Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad GENERAL ELECTRIC B105 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 25 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios Básicos por monitor — 01 Cable troncal de 3 lead R: Se aclara. Se acepta cables de 3 y 6 derivadas o cable de conexión completa sin división en más latiguillos. • 01 Cable troncal de 5 a 6 lead • 01 Cable ECG de 3 lead • 01 Cable ECG de 5 a 6 lead • Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto • 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto • 01 cables conectores al módulo de temperatura R: Se aclara. Se aceptan ofertas con cable único (troncal + sensor de temperatura) , siempre que se oferte sensores para piel y esofágica/rectal según EETT N° 76 y 77 • 01 Sensor de temperatura de piel adulto • 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal • 01 Carro de transporte • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en Monitores de Baja Complejidad — 15 Cable troncal de 3 lead reutilizable. R: Se aclara. Se acepta cable de ECG y troncal unidos o troncal para 3 y 6 derivadas, esto en las cantidades solicitadas. • 15 Cable troncal de 5 lead reutilizable • 20 Cable ECG de 3 lead • 20 Cable ECG de 5 lead • 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto R: Se aclara. Se acepta sensores SpO2 de tecnología propia, esto para el total de la oferta. • 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto • 20 Sensores de temperatura de piel adulto • 20 Sensor de temperatura esofágica/rectal • Operación — Manual de operación en idioma español • Manual de servicio (inglés o español) • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		

Xhibit® Central Station XC4 and XC48 96501/96102 96280 Xhibit Telemetry Receiver 	Central Monitoreo Recuperacion Spacelabs XHIBIT Ficha en Drive > 3
---	---

» Accesorios y componentes de la tipología · 71 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)

1.3 Accesorios Para cada monitor de mediana complejidad Recuperación Central

- Accesorios Básicos por monitor de cabecera Recuperación Central — 01 Cable troncal de 3 lead reutilizable P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "01 Cable troncal de 3 lead reutilizable",¿Es posible ofertar un equipo que cuente con un cable troncal unico, para ECG de 3/6 derivadas? R: Se acepta ofertar cable troncal único para 3 y 6 derivadas
- 01 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "01 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable",¿Es posible ofertar tan solo 1 cable troncal por equipo, que permita la visualizacion de ECG 3/6 derivadas? R: Se acepta ofertar cable troncal único para 3 y 6 derivadas
- 01 Cable ECG de 3 lead
- Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto
- 01 manguera de presión no invasiva
- 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazaletes para adulto normal, 1 brazaletes para adulto pequeño, 1 brazaletes para paciente obeso. Todos reusables

- 01 cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto
- 01 Sensor de temperatura superficial tipo lenteja
- 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- 02 cables conectores al módulo de temperatura P: 02 cables conectores al módulo de temperatura". Dado que piden 2 canales de T° por monitor, ¿es posible ofrecer solo un cable troncal dual por monitor para cumplir con las dos temperaturas simultaneas requeridas en línea 112? R: Se acepta mientras pueda cumplir con lo solicitado en la línea 112 referente a medición de 2 temperaturas simultaneas, y a la capacidad de conectar sensores de temperatura solicitados en las líneas N° 126 y 127 (superficial y esofágica/rectal). P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "02 cables conectores al módulo de temperatura",¿Es posible ofertar un cable sensor de temperatura que sea troncal + sensor, para temperatura de piel? R: Se acepta mientras pueda cumplir con lo solicitado en la línea 112 referente a medición de 2 temperaturas simultaneas, y a la capacidad de conectar sensores de temperatura solicitados en las líneas N° 126 y 127 (superficial y esofágica/rectal).
- 01 Kit de anclaje a pared
- Accesorios globales para el total de Monitores para Recuperación Central. — 06 Cable troncal de 12 lead (10 puntas) P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "06 Cable troncal de 12 lead (10 puntas)",¿Es posible ofertar un cable ECG de 12 derivadas que sea único, es decir, troncal mas latiguillos? R: Se acepta lo solicitado.
- 06 Cable ECG de 10 lead P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "06 Cable ECG de 10 lead",¿Es posible ofertar un cable ECG de 12 derivadas que sea único, es decir, troncal mas latiguillos? R: Se acepta.
- 12 Cable ECG de 5 o 6 lead
- 12 Cable ECG de 3 lead
- 6 Cable troncal de 3 lead reutilizable P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "6 Cable troncal de 3 lead reutilizable",Es posible ofertar cables troncales de ECG que permitan la conexión con latiguillos de 3 y 6 derivadas? R: Se acepta
- 6 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable
- 12 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto
- 12 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto
- Operación — El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.

2.3 Accesorios Para cada monitor de baja complejidad Recuperación Ambulatoria

- Accesorios Básicos por monitor Recuperación Ambulatoria — 01 Cable troncal de 3 lead reutilizable
- 01 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable
- 01 Cable ECG de 3 lead
- 01 Cable ECG de 5 o 6 lead
- Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto
- 01 manguera de presión no invasiva
- 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazaletes para adulto normal, 1 brazaletes para adulto pequeño, 1 brazaletes para paciente obeso. Todos reusables
- 01 cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto
- 01 Sensor de temperatura superficial tipo lenteja
- 01 cable conector al módulo de temperatura
- 01 Carro de transporte
- Accesorios globales para el total de Monitores para Recuperación Central. — 06 Cable troncal de 12 lead (10 puntas)
- 06 Cable ECG de 10 lead
- 12 Cable ECG de 5 o 6 lead
- 12 Cable ECG de 3 lead
- 6 Cable troncal de 3 lead reutilizable
- 6 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable

- 12 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto P: En el ítem 2.3 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "12 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto", Es posible ofertar tecnología de saturación propia? R: Se acepta medición de saturación con tecnología propia para cualquier monitor contenido en el Tipo Equipo Central de Monitoreo Recuperación, en cuyo caso se deben ofertar los tipos y cantidades de accesorios conforme a la tecnología.

- 12 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto P: En el ítem 2.3 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "12 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto", Es posible ofertar tecnología de saturación propia? R: Se acepta medición de saturación con tecnología propia para cualquier monitor contenido en el Tipo Equipo Central de Monitoreo Recuperación, en cuyo caso se deben ofertar los tipos y cantidades de accesorios conforme a la tecnología.

- Operación — El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.

3.3 Accesorios Para cada monitor de mediana complejidad Recuperación/Preanestesia

- Accesorios Básicos por monitor de cabecera Recuperación/Preanestesia — 01 Cable troncal de 3 lead reutilizable
- 01 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable
- 01 Cable ECG de 3 lead
- 01 Cable ECG de 5 o 6 lead
- Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto
- 01 manguera de presión no invasiva
- 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables
- 01 cable de extensión (interfaz) de sensor de saturimetría
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto
- 01 Sensor de temperatura superficial tipo lenteja
- 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- 01 cables conectores al módulo de temperatura
- 01 Kit de anclaje a pared
- Accesorios globales para el total de Monitores para Recuperación/Preanestesia. — 3 Cable troncal de 12 lead (10 puntas)
- 3 Cable ECG de 10 lead
- 5 Cable ECG de 5 o 6 lead
- 5 Cable ECG de 3 lead
- 3 Cable troncal de 3 lead reutilizable
- 3 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable
- 5 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto
- 5 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto
- Operación — El total de equipos deben venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.

Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT)

• Debe incluir todos los equipos necesarios para la conectividad de la central: Switch, CPU, Pantallas, parlantes, periféricos, impresora y cables de conexión requeridos. Se dispondrá a nivel de obra exclusivamente de puntos de datos en el cupo y en la estación de enfermería. P: En la descripción del ítem mencionan: "Se dispondrá a nivel de obra exclusivamente de puntos de datos en el cupo y en la estación de enfermería". Favor indicar el N° de puntos de red por cada monitor que dispondrá la obra. R: Se adecuarán conforme a los requerimientos del equipamiento ofertado, para lo anterior se dispone del anexo N°18 punto 4. Además con el proveedor adjudicado se trabajará en el Plan de Instalación que reunirá con mayor especificidad este tipo de requerimiento.

- Interfaz de comunicación con impresora láser
- Requerimiento de Impresora para la central de monitorización — La Central debe incluir impresora láser compatible con Central de Monitoreo
- Interfaz a impresora láser de la Central

SIN CLASIFICAR		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	sistema integrado de pabellones Nexor-Rein SMART-OR + NOVA.light 800 / 600+NEXOR.port PDM960 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • 20 conos reutilizables por equipo		
	Equipo Ecografía intravascular Boston Scientific AVVIGO+	1
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo Vascular — 1 equipo · AVVIGO+ 1 x Transductor Digital sin modelo ni frecuencia declarados		
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Insumos desechables requeridos para funcionamiento • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional. Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Debe contar con UNO de los siguientes almacenamientos para grabador e impresora: Opción 1: Bandejas para ambos accesorios. Opción 2: Espacio en la consola para ambos accesorios.		
	Equipo De Electroterapia Por Radiofrecuencia BTL BTL- 6000 THERAPY ELITE 320 W 8,4' Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Set de diferentes aplicadores • Cable de conexión • Portaelectrodos • Portacables • Todos los accesorios que sean necesarios para el funcionamiento del equipo		
Tipo equipo: 20002 Nombre: Carro de intubacion dificil Marca: INSIGHTERS Modelo: IS-3L  FUNCIONALIDAD Su funcionalidad es poder tener todas las herramientas para realizar una intubación de todo tipo, por difícil que sea.	Carro de intubacion dificil INSIGHTERS IS-3L Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Del videobroncoscopio — 01 pinza de arrastre • 06 Válvulas de aspiración • 01 Set de lavado • 01 maleta de transporte • 02 cepillos de limpieza Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Cámara de video — Alta resolución, mínimo 320 x 140 pixeles		

	Angiografo Multiproposito I Siemens Healthineers Artis Zee Ceiling Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 25 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Intercomunicador entre sala de examen y sala de comando • 03 Apoyabrazos radiolucidos • 01 Soportes para infusiones, medio de contraste y transductores • 02 kit correas fijación paciente • 02 kit cuñas posicionamiento paciente (solo en caso de ser necesario) • 07 Set de protección radiológica personal (protector de cuello + faldón + chaleco) • 04 Lentes de protección radiológica personal • 02 Kit de Pares Guantes de protección radiológica personal (cada kit debe tener al menos medida S, M, L) • 3 Colgadores para set de proteccion radiologica • 01 mesa auxiliar acero inoxidable preparación stent, intercambio de balón • Monitor ECG/ Signos Vitales Mediana complejidad — 02 Cable de ECG para 12 derivaciones con cables de latiguillos radiolúcidos • 02 Cable y Sensor reutilizable SpO2 pediátrico/adulto • 03 Cable interfase para transductor de presión invasiva, • 04 Tubo y Set Manguitos para PNI de todos los tamaños • 02 Cable para gasto cardíaco • 02 Sensor de temperatura externo • Mesa Quirúrgica — Accesorios básicos de posicionamiento de paciente y anestesia Respuesta: kit de cuñas posicionamiento de paciente, 4 brazares y 4 apoyacodos compatibles, de materialidad tipo gel o similar • Dos cintas o correas de sujeción de paciente ajustable para distintos tipos de pacientes, con instalación en rieles laterales de medidas 800 x 100 mm • Dos cintas o correas de sujeción de paciente ajustable para distintos tipos de pacientes, con instalación en rieles laterales de medidas 950 x 100 mm • Un Kit de Correas de fijación para pacientes bariátricos a tablero con hebilla • Un Kit de Placas de ensanchamiento largas, 2 piezas para ensanchar tablero de mesa en pacientes adiposos(par) • Un Kit de Placas de ensanchamiento cortas, 2 piezas para ensanchar tablero de mesa en pacientes adiposos(par) • Un Par de Porta pierneras anchos para pacientes adiposos, dos pares para la totalidad de las mesas Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Estación de trabajo — Mínimo 03 Monitores de 19" de alta resolución (Referencia, Live y datos) • Mouse y Teclado alfanumérico		