

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Policlinico Medicina


Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
16	59	10


Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P-1	Atención Abierta (AA)	Policlinico Medicina

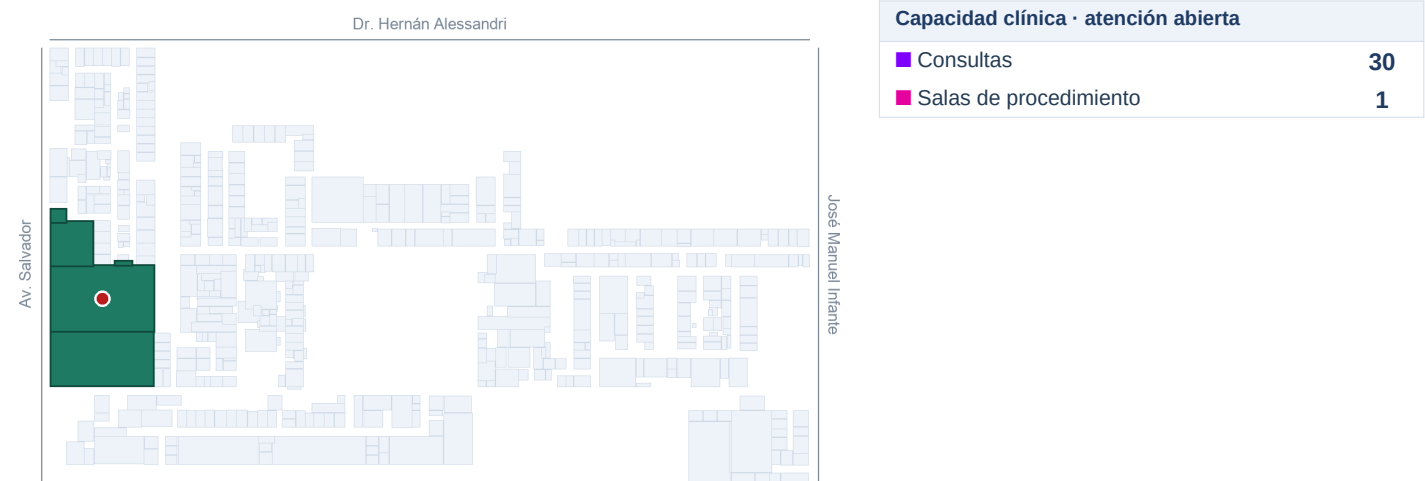

Piso P-1 · área «CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIDADES MEDICAS»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Diapasón De Sensibilidad Fabrication (FE) Diapasón tipo Hartmann Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Estuche de almacenamiento.		
	Balanza Paciente Bariátrico Health o Meter 1100KL Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable y/o cable para red eléctrica		

	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 01 par de olivas de repuesto.		
	Bioimpedanciometro SECA 5250021009 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Oftalmoscopio Directo Portatil HEINE BETA 200 LED Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Cargador de baterías • Estuche de protección y almacenaje		
	Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar		
	Caliper Baseline Cod. 12-1110 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 barra de calibración • 01 Estuche de almacenaje		

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	1

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Ecotomografo Doppler Tiroides GENERAL ELECTRIC Logiq P9	1
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo Endocrino — 1 equipo · Logiq P9 1 × Transductor Conexo Abdominal y Transvesical C1-5-RS · 1.5–5.0 MHz 1 × Transductor Lineal Largo ML6-15-RS · 4.0–15.0 MHz 1 × Transductor Lineal Musculo Esqueletico L8-18i-RS · 4.5–18.0 MHz » Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Bandeja para impresora • Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad		
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.069 Piso Clínico CoinfyCare MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo Asiento Ruedas con freno 	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	30
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable		
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.	
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto	