

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

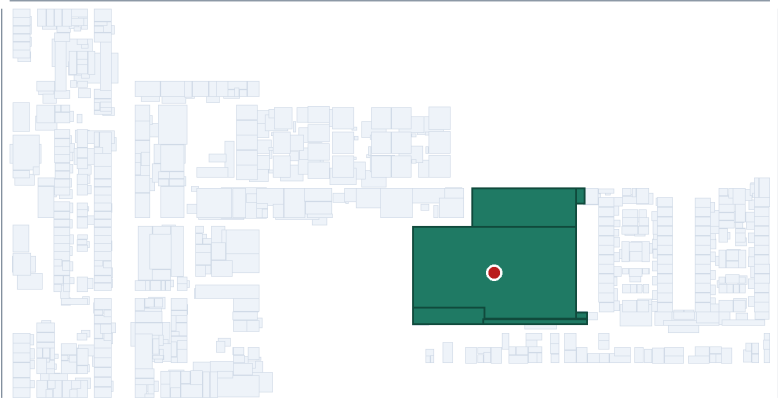
Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
60	335	15

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P2	Atención Cerrada (HDS)	Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Dr. Hernán Alessandri




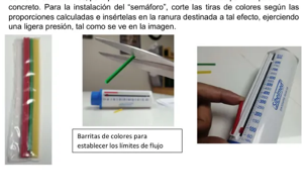
Capacidad clínica · atención cerrada

Cupos de cama


24

Piso P2 · área «UCI»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Negatoscopio 2 Caras MINSTON MSTXD LED2 Ficha en Drive >	2
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	25
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• 01 par de olivas de repuesto.		
	Medidor Cuff VBM VB5404000 Ficha en Drive >	16
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• Tubo de conexión		

 Balanza Silla SECA 954 Ficha en Drive >		2
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar		
 Ventilometro de Wright KOKO HALOSCALE Ficha en Drive >		2
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Maletín o estuche de almacenaje y protección. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
 Balanza Cama Detecto IB800-AC Ficha en Drive >		1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cualquier otro accesorio que sea indispensable para el uso del equipo ofertado (Cargadores, polea, sistema de suspensión, etc)		
 Localizador Estimulador De Nervio Periferico Bbraun STIMUPLEX HNS 12 Ficha en Drive >		2
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • 02 cable conector de aguja de estimulación • 01 contenedor o maleta de almacenamiento para equipo y accesorios • Incluir Baterías		
 Flujometro De Wright SILBEMED DATOSPIR PEAK - 10 Ficha en Drive >		4
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios — 02 Sets de 100 boquillas (inicio de operación), reutilizables (desinfectable y esterilizables) • 03 Sets de boquillas desechables • Estuche para almacenaje y protección • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional		

	Otoftalmoscopio Portatil WELCHALLYN 92871-BLK Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Mínimo 8 Espéculos Universales y Reutilizables; indicar tamaños • Ampolletas • Pera de insuflación • Baterías recargables en caso de ser necesario • Cargador de Baterías en caso de ser necesario • Estuche o maletín de almacenaje y protección		
	Pimometro MD Diagnostics RP-CHECK Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Sets de 100 boquillas (inicio de operación), reutilizables (desinfectable y esterilizables) • 03 Sets de boquillas desechables • 02 Pinzas nasales • 01 Set de tubos de silicona • 01 Set de válvulas unidireccionales (mínimo 10) • Baterías • Estuche de protección y almacenaje • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional		
	Electrocardiografo COMEN H12 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 limpiador de cabezal térmico • 01 Cable de paciente ECG para 12 derivadas • 01 set de Electrodos de "parche" por equipo ofertado, que incluya al menos: 70 electrodos adulto • 01 Unidad resma de papel de impresión en formato compatible con impresora • 01 Cable tierra (extra a enchufe de 3 vías) • 02 Potes de gel conductor • 01 Set de Adaptadores para cables de paciente y/o electrodos. • El equipo debe incluir todos los accesorios o insumos que lo hagan funcional • Manual Servicio • Manual Usuario en español Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — Integrada al equipo • Cabezal térmico digital Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Conectividad — A computadora		

APOYO ENDOSCOPICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Fibrobroncoscopio Karl Storz 11009BC Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 39 ítems (según EETT + oferta adjudicada · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 05 Válvulas de Fórceps (para sellar el canal de trabajo) • 02 Pinzas de biopsia • 02 Pinzas tipo cocodrilo o pinzas de agarre • 04 Sets de cepillos citológicos • Incluir cepillos de limpieza para equipo solicitado • 1 Válvula de succión reutilizable (o 05 válvulas de succión desechables en caso de no utilizar reutilizables) • Maleta de transporte y almacenaje • Contenedor de esterilización para Fibrobroncoscopio • Contenedor de esterilización para elementos reutilizables y esterilizables del equipo • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional. Adjudicado · Set principal ofertado • 11009BCK1 — SET Fibrobroncoscopio para adultos: acodamiento 180° arriba / 100° abajo, dirección visual 0°, ángulo de apertura 110°, canal de trabajo 2,6 mm, extremo distal exterior 5,6 mm, longitud útil 54 cm, longitud total 82 cm • Broncofibroscopio (cuerpo del equipo) • Maletín de transporte • Pinza de biopsia • Pinza de agarre • Tapón de compensación • Tester de estanqueidad • «OTROS» — texto literal de la oferta, sin desglose (BRECHA) Adjudicado · Fuente de luz fría • TL 100 S1 — Fuente de luz fría CO2mbi LED SCB, LED de alto rendimiento, KARL STORZ-SCB integrado y bomba de insuflación de CO2, 100–240 VAC 50/60 Hz; 6.400 K, vida útil 30.000 h, intensidad 0–100 % continua, clase de protección 1/CF, 305 × 110 × 380 mm • Incluye: soporte para botellas de irrigación • Incluye: anillo de soporte para botellas de agua • Incluye: botella de agua • Incluye: adaptador de irrigación para botella de agua • Incluye: cable de conexión SCB • Incluye: llave universal Adjudicado · Accesorios de la fuente de luz (catálogo anexo) • TL 001 — Soporte para botella de irrigación, para fuente CO2mbi LED SCB TL 100 S1 • 13992 BS — Botella de agua 250 ml • 13991 SW — Anillo de sujeción para botellas de irrigación Ampuwa Plastipur • Anillo de sujeción para botella de agua 13992 BS • 20090170 — Cable de conexión SCB, longitud 100 cm • 20400030 — Adaptador de irrigación para botella de agua 13992 BS (irrigación de tubo doble) • Llave universal Adjudicado · Instrumental y fungibles asociados • 11301 CA — Válvula de labios, un solo uso, envase de 20 unidades • 11001 KL — Pinza de biopsia en forma de cuchara, mordazas redondas flexibles, apertura bilateral; canal de trabajo 1,8 mm, longitud 120 cm • 110345-10 — Pinzas de agarre tipo pelícano, ángulo de apertura grande, 2,4 mm Ø, longitud útil 180 cm, estériles, un solo uso, envase de 10 unidades (endoscopios flexibles con canal >= 2,8 mm) • 110950-50 — Cepillo de limpieza con cepillo en ambos extremos, longitud 120 cm, cepillos 3,2 mm Ø, no estéril, un solo uso, envase de 50 unidades (canales 2,6–3,0 mm) • 11301 CB — Válvula de aspiración, reutilizable Adjudicado · Contenedores de esterilización y almacenamiento • 39402 AS — Recipiente de plástico para esterilización por gas y peróxido de hidrógeno (Sterrad®) y almacenamiento, con perforaciones y tapa, para fibroscopios flexibles de hasta 95 cm de longitud útil; 550 × 260 × 92 mm • 39360 BK — Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento de juegos de instrumentos variables, perforado, tapa transparente, esterilla de silicona, un nivel; 525 × 240 × 70 mm. Incluye: clavo de fijación (env. 12 un.), pisador de silicona (env. 12 un.) y herramienta		

APOYO INDUSTRIAL			
Imagen		Equipo / ítem	Cant.
pid cycle s than 2 minute cycle Dispose of up to 6 ces of pulp. ed 9 bladed technology es pulp utensil into tiny is, ensuring all waste is ted. less technology ng infection risk for ns and patients. uous, free-flowing of waste to drain g thorough removal of quality materials and  DDC Dolphin Save space, r for all room h Various To suit rangin Opti bits To e for c isole Optio long corre Pre- & pos self-clean		Maceradora De Chatas DDC Dolphin DDC Pulpmatic Ultima Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Repisa de Acero inoxidable o Aluminio para instalar al menos 5 soportes de chatas • En total 70 Soportes plasticos o Acero Inox. para chatas • 100 patos y 100 chatas desechables por equipo			

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Columna Porta Equipos Para UCI Nexor Port PDM960/PDM960	12
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	4
	Sistema para monitoreo de indica biespectral (BIS) MASIMO Sedline Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios		
• 4 Cable para Modulo BIS o equivalente		
• 04 Sensores BIS para los dos hemisferios		
	Bomba Aspiracion Universal Ca-Mi ASKIR 36 BR	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• 02 Tubos de silicona autoclavables.		
• 01 Sonda de aspiración		
• 02 Filtro antibacterial		

APOYO TERAPEUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Calentador De Fluido STHILER ELECTRONICS ALTROTHERM PLUS Ficha en Drive >	3
	Equipo Regulacion Termica ZOLL MEDICAL THERMOGARD XP Ficha en Drive >	1
	Acelerador Infusion 500 cc. VISTARMED V0005P Ficha en Drive >	18
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica.		
	Acelerador Infusion 1000 cc. VISTARMED V0010P Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica.		
	Calentador De Paciente 3M BAIR HUGGER 675 Ficha en Drive >	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios 10 Mantas para adulto por equipo. - Rodable.		
	Maquina Hemodialisis Bbraun Dialog EVO ligh Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios 1 Set de filtros para un mes de operación por equipo. - El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si estas están o no descritas en esta especificación técnica		

	Maquina Hemodiafiltracion Bbraun OMNI Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Porta suero o soporte de líquidos. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si estas están o no descritas en esta especificación técnica		
	Humidificador O2 C/ Calefactor FISHER & PAYKEL AIRVO2 Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios — Kit de inicio de circuitos de paciente (06) • Cable poder (integrado o para acople a placa calefactora) • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Generador De Pulso Unicameral OSCOR / OSYPKA 101 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 03 Cables paciente para estimulación ventricular por cada equipo • 02 Pilas/Baterías (según corresponda) por cada equipo • Incluir todo accesorio necesario para el funcionamiento correcto del equipo, como por ejemplo: cables extensores		
	Gabinete Calentador De Suero MEMMERT IN160 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Incluye todo cable, conexión o accesorio requerido para el funcionamiento • Manual Servicio en español o inglés • Manual Usuario en español		
	Ventilador Manual AMBU MARK IV Ficha en Drive >	13
» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios — 02 Válvulas espiratorias de repuesto. • 02 Mascarillas N° 4 y 5 (c/u). • 01 Maletín de transporte y almacenaje. • 01 Válvula para PEEP • Certificaciones Internacionales — FDA y/o CE y/o JIS y/o equivalente técnico		

	Generador De Pulso Bicameral LIVETEC T20 Ficha en Drive >	5
	» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 03 Cables paciente para estimulación ventricular por cada equipo • 03 Cables paciente para estimulación auricular por cada equipo • 02 Cables alargadores con sus correspondientes conexiones, por cada equipo ofertado • 02 Pilas/Baterías (según corresponda) por cada equipo • Incluir todo accesorio necesario para el funcionamiento correcto del equipo, como por ejemplo: cables extensores	
	Equipo de Asistencia Respiratoria con Membrana Extracorporea MAQUET-GETINGE CARDIOHELP Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Mezclador de gases (incluido en la configuración) • 02 Set de Cánulas Arteriales: 17Fr, 19Fr y 21Fr, cada uno con su respectivo kit introductor. • 02 Set de Cánulas Venosas: 21Fr, 23Fr y 25Fr, cada uno con su respectivo kit introductor. • 03 Kits desechables para ECMO, pre-ensamblados, con oxigenador de membrana de polimetilpentene • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.	
	Balón Contrapulsación Aortica MAQUET-GETINGE CARDIOSAVE Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 7 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Carro transporte incorporado al equipo • Cilindro principal de Helio y de respaldo • 02 Cable de ECG de 5 electrodos • Cable de Presión invasiva (según tipo de transductor usado en institución) • Simulador de paciente (para verificar funcionamiento) • 03 cateteres de cada medida, con balones nuevos, listos para ser utilizados (Para balones de al menos 30cc ± 5cc y 40 cc ± 5cc) Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora integrada al equipo o externa con interfase USB 2.0 o mínimo RS232	
Producto para uso traumático, usado en el tratamiento pre-quirúrgico de la fractura de fémur, ya que permite mantener el miembro inferior elevado consiguiendo así aliviar el dolor y alinear si existen fragmentos óseos fracturados.   Recomendaciones de uso y seguridad de férula de Brown.	Férula De Brown PIMET PIMET Ficha en Drive >	6
	» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Estríbo para tracción, tamaño medium • 01 Pesa para tracción de 2 Kg • 01 Pesa para tracción de 3 Kg • 01 Pesa para tracción de 4 Kg • 01 Pesa para tracción de 5 Kg • 01 Piola de acero para tracción o en su reemplazo lienza de máxima seguridad • 06 Gancho en S para tracción	

	Ventilador Mecanico No Invasivo Dräger Savina 300 Select Ficha en Drive >	26
	» Accesorios y componentes de la tipología · 12 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 válvulas espiratorias o cassettes espiratorios reutilizables, o similar técnico en ventilación no invasiva • 02 Circuito Paciente • 01 Sensor de oxígeno • 01 Base humidificadora servocontrolada, con cámara reusable o desechable, cables de temperatura y sensor de flujo • 01 Sensor de temperatura • 01 Manguera de conexión de oxígeno (3mts) • 02 Circuitos desechables para humidificación • Mangueras para O2 normada • Set de Mascaras tamaño Large. Debe incluir: Full Face, Total face, Oro - Nasaes, Tubo endotraqueal/Traqueotomía • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original	
	Ventilador De Transporte Dräger Oxylog 3000 plus Ficha en Drive >	4
	» Accesorios y componentes de la tipología · 12 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 03 válvulas espiratorias o cassettes espiratorios reutilizables • 02 Circuito Paciente • 01 Sensor de oxígeno si aplica • 02 Sensores de flujo rama exhalatoria con calentador de gases espirados • 02 Filtros de bacterias • 02 Circuitos desechables para humidificación pasiva • 01 Manguera para O2 normada de 3 mts • 01 set de máscaras con la configuración: Full Face, Total face, Oro - Nasaes, Tubo endotraqueal/Traqueotomía • 01 Cilindro de oxígeno tipo E o similar con todos los accesorios e insumos necesarios para su funcionamiento • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original	

	Ventilador Volumetrico Dräger Evita V600 Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 15 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios Básicos por cada ventilador — 02 válvulas espiratorias o cassettes espiratorios reutilizables • 01 Kit Reutilizable de nebulización ultrasónico • 01 Sensor de monitorización CO2 volumétrico tipo mainstream • 01 Base humidificadora servocontrolada, cables de temperatura y sensor de flujo • 01 Sensor de temperatura • 01 Manguera de conexión de aire (3mts) • 01 Manguera de conexión de oxígeno (3mts) • 02 Circuitos desechables para humidificación • 05 Sensores de flujo rama exhalatoria con accesorio para disminuir condensación o equivalente. P: ¿Se considera cumplida característica, si cassette espiratorio posee sensor de flujo con calefactor interno para evitar condensación? Se podría ofertar Heater externo para disminuir condensación, dando por cumplida característica. R: Se aceptan soluciones equivalentes que permitan cumplir con la función. • Mangueras para O2 y Aire codificadas por color • 02 Mascarillas reusables de tamaños grande y mediano (1 de c/u) con arnés, para VNI. Todas las mascarillas deben ser libres de latex • 01 Cánula de alto flujo con lo necesario para la operación del modo. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manuales — Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original		

APOYO TERAPÉUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Andador Sin Ruedas CILEF MEDICAL # JL913L Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• No aplica.		

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Ecotomografo doppler portátil GENERAL ELECTRIC Logiq E pro	3
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo · el servicio recibe 3 Upc — 3 equipos · Logiq E pro 1 × Transductor Sectorial Cardiologico sin modelo ni frecuencia declarados 1 × Transductor Abdominal Curvo sin modelo ni frecuencia declarados 1 × Transductor Vascular Periferico sin modelo ni frecuencia declarados		
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios Obligatorios para cada equipo — Un (1) Kit de accesorios para uso de ECG Cable de paciente de 12 derivadas, se debe incluir kit de electrodos desechables y electrodos reutilizables para el cable ofertado. • Un (1) Cable para exportar imágenes • Un (1) Cable para exportar audio/video • Incluir guía de aguja para todos los transductores solicitados que tengan dicha opción. (Se coordinará con mayor detalle con el adjudicado) • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Consola — Portátil tipo laptop o point of care Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Bandeja para impresora • Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte		
	Rx Portatil PHILIPS MOBILE DIAGNOST WDR Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Delantales plomados • 02 Pares de guantes plomados • 02 Pares de lentes de protección radiológica • 03 Protectores de tiroides • Perchero para delantal plomado, 3 prendas		

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas PYXIS MED STATION ES Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Componentes asociados · Computador (detectado en EETT)		
• Debe contar con mensajes de alerta en la estacion de trabajo de administrador y supervisor, para los niveles de inventarios, stock critico, apertura de puerta, control de vencimientos, entre otros		
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Sillon Clinico LOS PINOS SMM-251 Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Alza Ropa MAXCARE REGULABLE	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad		
	Carro Fichas Y Rx MALVESTIO 329633 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro 2 Bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Transporte Material Esteril SEBA A medida Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		

	Baño Portatil GLOMED SIN RUEDAS Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Transporte Material Contaminado SEBA A medida	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Piso Taburete Clinico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Sistema Transferencia Paciente MEDICARE SYSTEM MEDI ROLLER PRO Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Mobiliario Paciente UCI MALVESTIO 378250B	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Almohada de espuma viscoelástica. • 01 portasuero		

	Mobiliario Paciente UPC Bariátrico PARDO NEWCARE BARIATRICA Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Almohada de espuma viscoelástica. • 01 portasuero		
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		
	Mobiliario Paciente UTI PARAMOUNT A6 Ficha en Drive >	23
» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Almohada de espuma viscoelástica. • 01 portasuero • 01 Funda de repuesto por cada dos colchones. • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original		
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediátrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminación por fibra optica a batería, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		
Xhibit® Central Station XC4 and XC48 96501/96102 96280 Xhibit Telemetry Receiver  For Telemetry e Version 1.4 Xhibit & 1.02 and 1.3 Xhibit Telemetry	Central Monitoreo UPC Spacelabs XHIBIT Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 60 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) 1.3 Accesorios Para Monitor de Alta Complejidad UCI • Accesorios Básicos por cada monitor de cabecera UCI — 01 Cable troncal de 3 lead reutilizable P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "01 Cable troncal de 3 lead reutilizable", ¿Es posible ofertar un equipo que cuente con un cable troncal único, para ECG de 3/6 derivadas? R: Se acepta • 01 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "01 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable", ¿Es posible ofertar tan solo 1 cable troncal por equipo, que permita la visualización de ECG 3/6 derivadas? R: Se acepta • 01 Cable ECG de 3 lead • 01 Cable ECG de 5 o 6 lead • Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto • 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables • 01 cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto • 01 Sensor de temperatura superficial tipo lenteja • 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal		

- 02 cables conectores al módulo de temperatura P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "02 cables conectores al módulo de temperatura", ¿Es posible ofertar un cable sensor de temperatura que sea troncal + sensor, para temperatura de piel? En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "02 cables conectores al módulo de temperatura", ¿Es posible ofertar un cable sensor de temperatura que sea troncal + sensor, para temperatura esofágica/rectal? R: Se acepta mientras pueda cumplir con lo solicitado en la línea 120 referente a medición de 2 temperaturas simultáneas, y a la capacidad de conectar sensores de temperatura solicitados en las líneas N° 151 y 152 (superficial y esofágica/rectal).
- 01 kit de inicio para medición de Presión Intracraneal (PI). P: ¿Con kit para medición de Presión Intracraneal se refiere a transductor y catéter para medición? ¿o todo lo necesario hasta la conexión con el transductor? P: Solicitan: "01 kit de inicio para medición de Presión Intracraneal (PI)". Favor aclarar qué debe componer el kit y la marca del transductor compatible. R: Se refiere a todo lo necesario en la tecnología que se oferte para obtener una medición de este tipo. (conexión a canal de PI, cable, transductor y/u otro requerido)
- 01 Kit de montaje a columna de equipos P: Por favor aclarar si poseen las columnas, qué tipos de anclaje permiten, si se proporcionará un anclaje de tipo VESA, qué tipo de estándar VESA (100, 75), y si columnas permiten anclaje tipo GCX. R: Sí existen columnas y son consideraras como otro equipo, estas permiten anclajes tipo VESA, el estándar a detalle se acordará de manera posterior con los adjudicados de ambos tipos de equipo. Las consideraciones particulares que posea el proveedor respecto de sus instalaciones deben reflejarse en el anexo 18 punto 4 de las BACO.
- Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en UCI — 09 Cable troncal de 12 lead (10 puntas) P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "09 Cable troncal de 12 lead (10 puntas)", ¿Es posible ofertar un cable ECG de 12 derivadas que sea único, es decir, troncal mas latiguillos? R: Se acepta
- 09 Cable ECG de 10 lead P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "09 Cable ECG de 10 lead", ¿Es posible ofertar un cable ECG de 12 derivadas que sea único, es decir, troncal mas latiguillos? R: Se acepta
- 09 Cable ECG de 5 o 6 lead
- 3 Cable troncal de 3 lead reutilizable P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "04 Cable troncal de 3 lead reutilizable", ¿Es posible ofertar cables troncales de ECG que permitan la conexión con latiguillos de 3 y 6 derivadas? R: Se acepta
- 04 Cable troncal de 3 lead reutilizable P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "04 Cable troncal de 3 lead reutilizable", ¿Es posible ofertar cables troncales de ECG que permitan la conexión con latiguillos de 3 y 6 derivadas? R: Se acepta
- 04 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable
- 09 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto
- 09 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto
- 04 Kit accesorios para EEG (cables de conexión y montaje de electrodos)
- 09 Kit de medición de BIS
- 03 Kit de conexiones y sensores de flujo lateral para medición de Capnografía P1: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "03 Kit de conexiones y sensores de flujo lateral para medición de Capnografía", Tomando en consideración otras tecnologías de medicion, como Mainstream, ¿Es posible ofertar kit de conexiones para este tipo de sensores, los que permiten una mejor medición y menor volumen de espacio muerto? P2: Por favor aclarar si se requieren módulos junto con los sensores, o sólo sensores e insumos para medición de flujo lateral. R1: Se solicita considerar en monitores UCI tecnología tipo sidestream incluyendo sus accesorios puesto que el ventilador aporta con la tecnología mainstream. R2: La cantidad de módulos requeridos se encuentran detallados en la EETT (Línea 65 a 72), específicamente línea 71 solicita 03 módulos de capnografía.
- 04 Kit para gasto cardiaco: cables conectores al módulo de GC + cable bifurcado + sensor de temperatura para sistema abierto u otros según aplique tecnología.
- 04 Kits para gasto cardiaco continuo P: Solicitan: "04 Kits para gasto cardiaco continuo" Favor definir los componentes del kit. (Transductor desechable + Catéter?) (¿Catéter acceso femoral, radial o braquial, cubital, French del cateter?) R: Se solicita en la generalidad, ofertar lo necesario para su operación, 1 para cada módulo solicitado.
- Operación — El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.

2.4 Accesorios Para cada monitor de mediana complejidad UTI

- Accesorios Básicos por cada monitor de cabecera UTI — 01 Cable troncal de 3 lead reutilizable P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "01 Cable troncal de 3 lead reutilizable", ¿Es posible ofertar un equipo que cuente con un cable troncal unico, para ECG de 3/6 derivadas? R: Se acepta
- 01 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "01 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable", ¿Es posible ofertar tan solo 1 cable troncal por equipo, que permita la visualizacion de ECG 3/6 derivadas? R: Se acepta
- 01 Cable ECG de 3 lead
- 01 Cable ECG de 5 o 6 lead
- Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto
- 01 manguera de presión no invasiva
- 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazaletes para adulto normal, 1 brazaletes para adulto pequeño, 1 brazaletes para paciente obeso. Todos reusables
- 01 cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto
- 01 Sensor de temperatura superficial tipo lenteja
- 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- 02 cables conectores al módulo de temperatura P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "02 cables conectores al módulo de temperatura", ¿Es posible ofertar un cable sensor de temperatura que sea troncal + sensor, para temperatura de piel? P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "02 cables conectores al módulo de temperatura", ¿Es posible ofertar un cable sensor de temperatura que sea troncal + sensor, para temperatura esofágica/rectal? R: Se acepta mientras pueda cumplir con lo solicitado en la línea 251 referente a medición de 2 temperaturas simultáneas, y a la capacidad de conectar sensores de temperatura solicitados en las líneas N° 265 y 266.
- 01 Kit de montaje a pared o CPI según defina el hospital.
- Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en UTI — 12 Cable troncal de 12 lead (10 puntas) P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "12 Cable troncal de 12 lead (10 puntas)", ¿Es posible ofertar un cable ECG de 12 derivadas que sea único, es decir, troncal mas latiguillos? R: Se acepta
- 12 Cable ECG de 10 lead P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "12 Cable ECG de 10 lead", ¿Es posible ofertar un cable ECG de 12 derivadas que sea único, es decir, troncal mas latiguillos? R: Se acepta
- 12 Cable ECG de 5 o 6 lead
- 12 Cable ECG de 3 lead

- 06 Cable troncal de 3 lead reutilizable P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "06 Cable troncal de 3 lead reutilizable", ¿Es posible ofertar cables troncales de ECG que permitan la conexión con latiguillos de 3 y 6 derivadas? R: Se acepta

- 06 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable

- 12 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto

- 12 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto

- 03 Kit de conexiones y sensores de flujo lateral para medición de Capnografía P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "03 Kit de conexiones y sensores de flujo lateral para medición de Capnografía", Tomando en consideración otras tecnologías de medición, como Mainstream, ¿Es posible ofertar kit de conexiones para este tipo de sensores, los que permiten una mejor medición y menor volumen de espacio muerto? R: Estimados, se modifica la cantidad de estos accesorios capnografía a 0, dado que el monitor UTI no incluye el módulo, sólo la capacidad de conectarse un módulo de capnografía Sidestream. Ver Líneas 190 a 193 para configuración UTI.

- 03 Kit para gasto cardíaco: cables conectores al módulo de GC + cable bifurcado + sensor de temperatura para sistema abierto u otros según aplique tecnología.

- 03 Kits para gasto cardíaco continuo P: Solicitan: "03 Kits para gasto cardíaco continuo" Favor definir los componentes del kit. (Transductor desechable + Catéter?) (¿Catéter acceso femoral, radial o braquial, cubital, French del catéter?) R: Se solicita en la generalidad, ofertar lo necesario para su operación, 1 para cada módulo solicitado.

- Operación — El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.

Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT)

- Debe incluir todos los equipos necesarios para la conectividad de la central: Switch, CPU, Pantallas, parlantes, periféricos, impresora y cables de conexión requeridos. Se dispondrá a nivel de obra exclusivamente de puntos de datos en el cupo y en la estación de enfermería.

- Interfaz de comunicación con impresora láser

- Requerimiento de Impresora para cada central de monitorización — Cada Central debe incluir impresora láser compatible con Central de Monitoreo

- Interfaz a impresora láser de la Central

Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT)

- 04 módulos de EEG de al menos 4 canales. Se considera 1 cada 4 cupos. P1: Por favor, permitir cumplimiento con oferta de monitor externo BIS Bilateral, que presenta en pantalla 4 canales de EEG. Los monitores externos se pueden conectar al monitor multiparámetros para su visualización en pantalla, y almacenamiento de valores en tendencias. P2: Estimados, en esta fila están solicitando medición de EEG de 4 canales. ¿es necesario que estos 4 canales sean bipolares? R1: Se acepta similar técnico que permita cumplir con lo solicitado considerando canales bipolares. R2: Sí. Se solicitan canales bipolares.

SIN CLASIFICAR	
Imagen	Equipo / Ítem
Tipo equipo: 20002 Nombre: Carro de intubación difícil Marca: INSIGHTERS Modelo: IS-3L  VIDEOLARINGOSCOPIO FIBROSCOPIO IS-3L-3D VIDEOLARINGOSCOPIO IS-3L I-WORKSTATION INSIGHT IS-PI2 CARRO DE TRANSPORTE WORKSTATION IS-TC1 FUNCIONALIDAD Su funcionalidad es poder tener todas las herramientas para realizar una intubación de todo tipo, por difícil que sea.	Carro de intubación difícil INSIGHTERS IS-3L Ficha en Drive > 1
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Del videobroncoscopio — 01 pinza de arrastre • 06 Válvulas de aspiración • 01 Set de lavado • 01 maleta de transporte • 02 cepillos de limpieza Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Cámara de video — Alta resolución, mínimo 320 x 140 píxeles	