

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Unidad de Cuidados Intermedios (UTI)

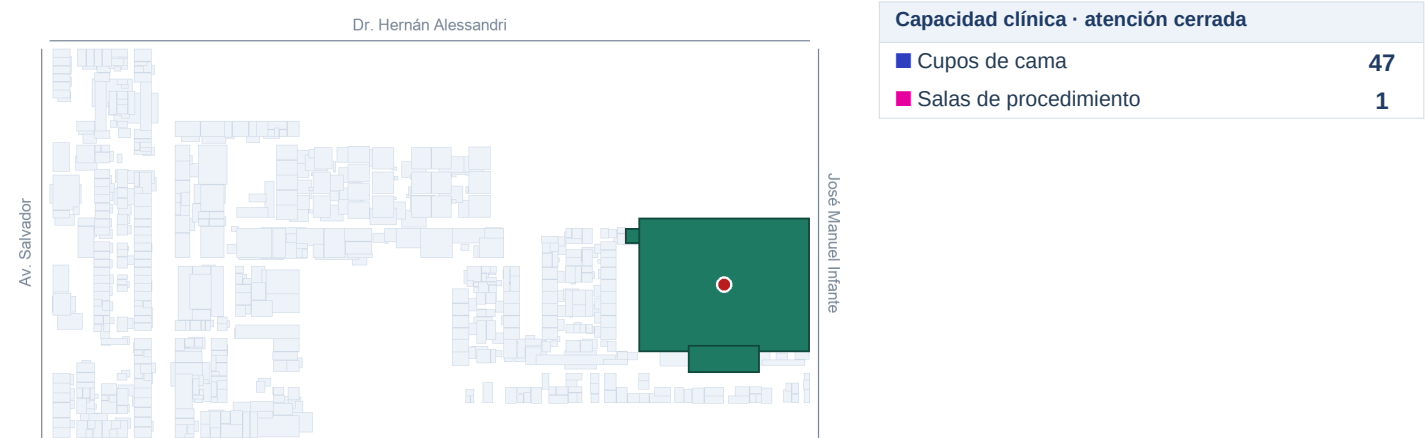
Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.


Tipos	Unidades	Recintos
54	310	12


Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P2	Atención Cerrada (HDS)	Unidad de Cuidados Intermedios (UTI)



Piso P2 · área «UTI»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Negatoscopio 2 Caras MINSTON MSTXD LED2 Ficha en Drive >	1
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	26
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 01 par de olivas de repuesto.		
	Medidor Cuff VBM VB5404000 Ficha en Drive >	17
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Tubo de conexión		

	Ventilometro de Wright KOKO HALOSCALE Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Maletín o estuche de almacenaje y protección. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Balanza Silla SECA 954 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar		
	Balanza Cama Detecto IB800-AC Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cualquier otro accesorio que sea indispensable para el uso del equipo ofertado (Cargadores, polea, sistema de suspensión, etc)		
	Flujometro De Wright SILBEMED DATOSPIR PEAK - 10 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios — 02 Sets de 100 boquillas (inicio de operación), reutilizables (desinfectable y esterilizables) • 03 Sets de boquillas desechables • Estuche para almacenaje y protección • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional		

 GE HealthCare Venue Fit™ Ultrasound System Made for your Point of Care	Equipo Doppler Transcraneal GE HEALTHCARE VENUE FIT Ficha en Drive >	1
	» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo Upc — 1 equipo · VENUE FIT 1 × Transductor Sectorial Cardiologico 3Sc-RS · 1.7–4.0 MHz 1 × Transductor Abdominal Convexo C1-5-RS · 1.5–5.0 MHz 1 × Transductor Lineal Vascular Periferico L4-12t-RS · 4.2–13.0 MHz 1 × Transductor Cardiologico Transcraneal 6S-RS · 3.0–7.0 MHz » Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Sostenedores de sondas • Impresora laser compatible • Gel conductor • Todo otro accesorio indispensable para la correcta operación del equipo y que no haya sido nombrado en estas EETT Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Conexiones — Para videograbador (CD/DVD) e impresora	
	Otoftalmoscopio Portatil WELCHALLYN 92871-BLK Ficha en Drive >	6
	» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Mínimo 8 Espéculos Universales y Reutilizables; indicar tamaños • Ampolletas • Pera de insuflación • Baterías recargables en caso de ser necesario • Cargador de Baterías en caso de ser necesario • Estuche o maletín de almacenaje y protección	
	Pimometro MD Diagnostics RP-CHECK Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Sets de 100 boquillas (inicio de operación), reutilizables (desinfectable y esterilizables) • 03 Sets de boquillas desechables • 02 Pinzas nasales • 01 Set de tubos de silicona • 01 Set de válvulas unidireccionales (mínimo 10) • Baterías • Estuche de protección y almacenaje • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional	

	Electroencefalografo NATUS 1 Brain Monitor con PC de escritorio 1 Brain Monitor portátil con Notebook. Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 9 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios general para EEG/EEG portátil — 03 Juegos de electrodos de copa de oro reutilizables, compuesto de al menos diez (10) unidades con un cable de extensión de al menos 150 cms, por cada equipo • Pasta de limpieza: Incluir al menos 2 unidades de gel de limpieza para piel, por cada equipo • Pasta conductora: incluir al menos 2 unidades de gel conductor, por cada equipo • Cabezal microprocesado, por cada equipo P: Solicitan cabezal microprocesado, se refieren al amplificador ya que este es microprocesado? R: Estimados, se aceptará cabezal microprocesado para el amplificador. • Botón de aviso paciente, por cada equipo • Accesorio EEG portátil — Se requiere maletín de traslado • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Incluir PC tipo Laptop de al menos 15" con requerimientos acorde a la especialidad Estimados, favor ofertar un equipo tipo Laptop que sea de 14" o superior. Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Incluir Impresora con tecnología Wifi para operación en red en EEG y EEG portátil, por cada estación (incluir las tintas correspondientes)	
	Electrocardiografo COMEN H12 Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 limpiador de cabezal térmico • 01 Cable de paciente ECG para 12 derivadas • 01 set de Electrodos de "parche" por equipo ofertado, que incluya al menos: 70 electrodos adulto • 01 Unidad resma de papel de impresión en formato compatible con impresora • 01 Cable tierra (extra a enchufe de 3 vías) • 02 Potes de gel conductor • 01 Set de Adaptadores para cables de paciente y/o electrodos. • El equipo debe incluir todos los accesorios o insumos que lo hagan funcional • Manual Servicio • Manual Usuario en español Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — Integrada al equipo • Cabezal térmico digital Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Conectividad — A computadora	

APOYO INDUSTRIAL			
Imagen		Equipo / ítem	Cant.
plid cycle s than 2 minute cycle dispose of up to 6 ces of pulp. ed 9 bladed technology es pulp utensil into tiny is, ensuring all waste is ted. less technology hg infection risk for ns and patients. uous, free-flowing of waste to drain g thorough removal of quality materials and  DDC Dolphin DDC Pulpmatic Ultima Various To suit range Opti bits To e for c isole Optio long corre Pre- & pos self-clean		Maceradora De Chatas DDC Dolphin DDC Pulpmatic Ultima Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Repisa de Acero inoxidable o Aluminio para instalar al menos 5 soportes de chatas • En total 70 Soportes plasticos o Acero Inox. para chatas • 100 patos y 100 chatas desechables por equipo			

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Columna Porta Equipos Para UCI Nexor Port PDM960/PDM960	12
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	3

APOYO TERAPEUTICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Calentador De Fluido STHILER ELECTRONICS ALTROTHERM PLUS Ficha en Drive >	3
	Acelerador Infusion 500 cc. VISTARMED V0005P Ficha en Drive >	18
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica.		
	Acelerador Infusion 1000 cc. VISTARMED V0010P Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica.		
	Calentador De Paciente 3M BAIR HUGGER 675 Ficha en Drive >	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios 10 Mantas para adulto por equipo. - Rodable.		
	Maquina Hemodiafiltracion Bbraun OMNI Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos - Porta suero o soporte de líquidos. - El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si estas están o no descritas en esta especificación técnica.		
	Humidificador O2 C/ Calefactor FISHER & PAYKEL AIRVO2 Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios - Accesorios — Kit de inicio de circuitos de paciente (06) - Cable poder (integrado o para acople a placa calefactora) - El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		

	Generador De Pulso Unicameral OSCOR / OSYPKA 101 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 03 Cables paciente para estimulación ventricular por cada equipo • 02 Pilas/Baterías (según corresponda) por cada equipo • Incluir todo accesorio necesario para el funcionamiento correcto del equipo, como por ejemplo: cables extensores		
	Ventilador Manual AMBU MARK IV Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios — 02 Válvulas espiratorias de repuesto. • 02 Mascarillas N° 4 y 5 (c/u). • 01 Maletín de transporte y almacenaje. • 01 Válvula para PEEP • Certificaciones Internacionales — FDA y/o CE y/o JIS y/o equivalente técnico		
	Generador De Pulso Bicameral LIVETEC T20 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 03 Cables paciente para estimulación ventricular por cada equipo • 03 Cables paciente para estimulación auricular por cada equipo • 02 Cables alargadores con sus correspondientes conexiones, por cada equipo ofertado • 02 Pilas/Baterías (según corresponda) por cada equipo • Incluir todo accesorio necesario para el funcionamiento correcto del equipo, como por ejemplo: cables extensores		
Producto para uso traumático, usado en el tratamiento pre- quirúrgico de la fractura de fémur, ya que permite mantener el miembro inferior elevado consiguiendo así aliviar el dolor y alinear y/o reducir fragmentos óseos fracturados.  Férula de Brown y gancho con pesa. Estribo de Kirschner con ganchos. Recomendaciones de uso y seguridad de férula de Brown.	Férula De Brown PIMET PIMET Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Estribo para tracción, tamaño medium • 01 Pesa para tracción de 2 Kg • 01 Pesa para tracción de 3 Kg • 01 Pesa para tracción de 4 Kg • 01 Pesa para tracción de 5 Kg • 01 Piola de acero para tracción o en su reemplazo lienza de máxima seguridad • 06 Gancheras porta pesas • 06 Gancho en S para tracción		

	Ventilador Mecanico No Invasivo Dräger Savina 300 Select Ficha en Drive >	5
	» Accesorios y componentes de la tipología · 12 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 válvulas espiratorias o cassettes espiratorios reutilizables, o similar técnico en ventilación no invasiva • 02 Circuito Paciente • 01 Sensor de oxígeno • 01 Base humidificadora servocontrolada, con cámara reusable o desechable, cables de temperatura y sensor de flujo • 01 Sensor de temperatura • 01 Manguera de conexión de oxígeno (3mts) • 02 Circuitos desechables para humidificación • Mangueras para O2 normada • Set de Mascaras tamaño Large. Debe incluir: Full Face, Total face, Oro - Nasaes, Tubo endotraqueal/Traqueotomía • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original	
	Ventilador De Transporte Dräger Oxylog 3000 plus Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 12 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 03 válvulas espiratorias o cassettes espiratorios reutilizables • 02 Circuito Paciente • 01 Sensor de oxígeno si aplica • 02 Sensores de flujo rama exhalatoria con calentador de gases espirados • 02 Filtros de bacterias • 02 Circuitos desechables para humidificación pasiva • 01 Manguera para O2 normada de 3 mts • 01 set de máscaras con la configuración: Full Face, Total face, Oro - Nasaes, Tubo endotraqueal/Traqueotomía • 01 Cilindro de oxígeno tipo E o similar con todos los accesorios e insumos necesarios para su funcionamiento • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original	

	Ventilador Volumetrico Dräger Evita V600 Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 15 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios Básicos por cada ventilador — 02 válvulas espiratorias o cassettes espiratorios reutilizables • 01 Kit Reutilizable de nebulización ultrasónico • 01 Sensor de monitorización CO2 volumétrico tipo mainstream • 01 Base humidificadora servocontrolada, cables de temperatura y sensor de flujo • 01 Sensor de temperatura • 01 Manguera de conexión de aire (3mts) • 01 Manguera de conexión de oxígeno (3mts) • 02 Circuitos desechables para humidificación • 05 Sensores de flujo rama exhalatoria con accesorio para disminuir condensación o equivalente. P: ¿Se considera cumplida característica, si cassette espiratorio posee sensor de flujo con calefactor interno para evitar condensación? Se podría ofertar Heater externo para disminuir condensación, dando por cumplida característica. R: Se aceptan soluciones equivalentes que permitan cumplir con la función. • Mangueras para O2 y Aire codificadas por color • 02 Mascarillas reusables de tamaños grande y mediano (1 de c/u) con arnés, para VNI. Todas las mascarillas deben ser libres de latex • 01 Cánula de alto flujo con lo necesario para la operación del modo. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manuales — Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original		

APOYO TERAPÉUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Andador Sin Ruedas CILEF MEDICAL # JL913L Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas PYXIS MED STATION ES Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Debe contar con mensajes de alerta en la estacion de trabajo de administrador y supervisor, para los niveles de inventarios, stock critico, apertura de puerta, control de vencimientos, entre otros		
	Dispensador automatico de insumos y medicamentos 3 columnas PYXIS MED STATION ES - SUPPLY STATION Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Debe contar con mensajes de alerta en la estacion de trabajo de administrador y supervisor, para los niveles de inventarios, stock critico, apertura de puerta, control de vencimientos, entre otros		
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		

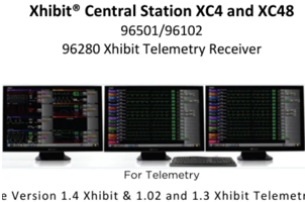
MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Sillon Clinico LOS PINOS SMM-251 Ficha en Drive >	14
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No Aplica		
	Alza Ropa MAXCARE REGULABLE	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No Aplica		
	Soporte Universal SCHMITZ SCHMITZ PORTASUERO 242.2351.0 Ficha en Drive >	11
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad		
ITEM 110.070 DESCRIPCION Piso Clinico MARCA CoinfyCare MODELO MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Resgado Adiento Ruedas con freno 	Piso Taburete Clinico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Carro 2 Bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		

	Carro Fichas Y Rx MALVESTIO 329633 Ficha en Drive >	3						
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica								
	Carro Transporte Material Contaminado SEBA A medida	3						
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica								
	Baño Portatil GLOMED SIN RUEDAS Ficha en Drive >	2						
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica								
	Carro Transporte Material Esteril SEBA A medida Ficha en Drive >	2						
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica								
	Elevador De Paciente Handimove Elevador de Pacientes 1630 Ficha en Drive >	1						
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 hamacas con reposa cabeza por equipo								
ITEM: 130.008 DESCRIPCION: Piso Clínico MARCA: CoinfyCare MODELO: MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD <table border="1"> <thead> <tr> <th>Regulable</th> <th>Asiento</th> <th>Ruedas con freno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Regulable	Asiento	Ruedas con freno				Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	1
Regulable	Asiento	Ruedas con freno						
								
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica								

	Mobiliario Paciente UCI MALVESTIO 378250B	11
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Almohada de espuma viscoelástica. • 01 portasuero	
	Mobiliario Paciente UPC Bariátrico PARDO NEWCARE BARIATRICA Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Almohada de espuma viscoelástica. • 01 portasuero	
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	4
	» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable	
	Mobiliario Paciente UTI PARAMOUNT A6 Ficha en Drive >	23
	» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Almohada de espuma viscoelástica. • 01 portasuero • 01 Funda de repuesto por cada dos colchones. • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original	

	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediatrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
—	Oxímetro Ambiental VETO A6031752 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Manual de usuario o documentación con instrucciones de uso		
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		

	Monitor Desfibrilador C/Mpe ZOLL MEDICAL M2 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 01 Kit de Marcapaso externo • Stock de papel para impresión • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		
	Central Monitoreo UPC Spacelabs XHIBIT Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 60 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) 1.3 Accesorios Para Monitor de Alta Complejidad UCI • Accesorios Básicos por cada monitor de cabecera UCI — 01 Cable troncal de 3 lead reutilizable P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "01 Cable troncal de 3 lead reutilizable", ¿Es posible ofertar un equipo que cuente con un cable troncal unico, para ECG de 3/6 derivadas? R: Se acepta • 01 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "01 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable", ¿Es posible ofertar tan solo 1 cable troncal por equipo, que permita la visualización de ECG 3/6 derivadas? R: Se acepta • 01 Cable ECG de 3 lead • 01 Cable ECG de 5 o 6 lead • Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto • 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables • 01 cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto • 01 Sensor de temperatura superficial tipo lenteja • 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal • 02 cables conectores al módulo de temperatura P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "02 cables conectores al módulo de temperatura", ¿Es posible ofertar un cable sensor de temperatura que sea troncal + sensor, para temperatura de piel? En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "02 cables conectores al módulo de temperatura", ¿Es posible ofertar un cable sensor de temperatura que sea troncal + sensor, para temperatura esofágica/rectal? R: Se acepta mientras pueda cumplir con lo solicitado en la línea 120 referente a medición de 2 temperaturas simultaneas, y a la capacidad de conectar sensores de temperatura solicitados en las líneas N° 151 y 152 (superficial y esofágica/rectal). • 01 kit de inicio para medición de Presión Intracraneal (PI). P: ¿Con kit para medición de Presión Intracraneal se refiere a transductor y catéter para medición? ¿o todo lo necesario hasta la conexión con el transductor? P: Solicitan: "01 kit de inicio para medición de Presión Intracraneal (PI)". Favor aclarar qué debe componer el kit y la marca del transductor compatible. R: Se refiere a todo lo necesario en la tecnología que se oferte para obtener una medición de este tipo. (conexión a canal de PI, cable, transductor y/u otro requerido) • 01 Kit de montaje a columna de equipos P: Por favor aclarar si poseen las columnas, qué tipos de anclaje permiten, si se proporcionará un anclaje de tipo VESA, qué tipo de estándar VESA (100, 75), y si columnas permiten anclaje tipo GCX. R: Sí existen columnas y son consideraras como otro equipo, estas permiten anclajes tipo VESA, el estándar a detalle se acordará de manera posterior con los adjudicados de ambos tipos de equipo. Las consideraciones particulares que posea el proveedor respecto de sus instalaciones deben reflejarse en el anexo 18 punto 4 de las BACO. • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en UCI — 09 Cable troncal de 12 lead (10 puntas) P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "09 Cable troncal de 12 lead (10 puntas)", ¿Es posible ofertar un cable ECG de 12 derivadas que sea único, es decir, troncal mas latiguillos? R: Se acepta • 09 Cable ECG de 10 lead P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "09 Cable ECG de 10 lead", ¿Es posible ofertar un cable ECG de 12 derivadas que sea único, es decir, troncal mas latiguillos? R: Se acepta		

- 09 Cable ECG de 5 o 6 lead
- 3 Cable troncal de 3 lead reutilizable P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "04 Cable troncal de 3 lead reutilizable", ¿Es posible ofertar cables troncales de ECG que permitan la conexión con latiguillos de 3 y 6 derivadas? R: Se acepta
- 04 Cable troncal de 3 lead reutilizable P: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "04 Cable troncal de 3 lead reutilizable", ¿Es posible ofertar cables troncales de ECG que permitan la conexión con latiguillos de 3 y 6 derivadas? R: Se acepta
- 04 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable
- 09 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto
- 09 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto
- 04 Kit accesorios para EEG (cables de conexión y montaje de electrodos)
- 09 Kit de medición de BIS
- 03 Kit de conexiones y sensores de flujo lateral para medición de Capnografía P1: En el ítem 1.3 sobre Accesorios para monitores de alta complejidad, indican "03 Kit de conexiones y sensores de flujo lateral para medición de Capnografía", Tomando en consideración otras tecnologías de medición, como Mainstream, ¿Es posible ofertar kit de conexiones para este tipo de sensores, los que permiten una mejor medición y menor volumen de espacio muerto? P2: Por favor aclarar si se requieren módulos junto con los sensores, o sólo sensores e insumos para medición de flujo lateral. R1: Se solicita considerar en monitores UCI tecnología tipo sidestream incluyendo sus accesorios puesto que el ventilador aporta con la tecnología mainstream. R2: La cantidad de módulos requeridos se encuentran detallados en la EETT (Línea 65 a 72), específicamente línea 71 solicita 03 módulos de capnografía.
- 04 Kit para gasto cardiaco: cables conectores al módulo de GC + cable bifurcado + sensor de temperatura para sistema abierto u otros según aplique tecnología.
- 04 Kits para gasto cardiaco continuo P: Solicitan: "04 Kits para gasto cardiaco continuo" Favor definir los componentes del kit. (Transductor desechable + Catéter?) (¿Catéter acceso femoral, radial o braquial, cubital, French del cateter?) R: Se solicita en la generalidad, ofertar lo necesario para su operación, 1 para cada módulo solicitado.
- Operación — El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.

2.4 Accesorios Para cada monitor de mediana complejidad UTI

- Accesorios Básicos por cada monitor de cabecera UTI — 01 Cable troncal de 3 lead reutilizable P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "01 Cable troncal de 3 lead reutilizable", ¿Es posible ofertar un equipo que cuente con un cable troncal unico, para ECG de 3/6 derivadas? R: Se acepta
- 01 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "01 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable", ¿Es posible ofertar tan solo 1 cable troncal por equipo, que permita la visualización de ECG 3/6 derivadas? R: Se acepta
- 01 Cable ECG de 3 lead
- 01 Cable ECG de 5 o 6 lead
- Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto
- 01 manguera de presión no invasiva
- 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazaletes para adulto normal, 1 brazaletes para adulto pequeño, 1 brazaletes para paciente obeso. Todos reusables
- 01 cable de extensión (interfaz) de sensor de saturimetría
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto
- 01 Sensor de temperatura superficial tipo lenteja
- 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- 02 cables conectores al módulo de temperatura P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "02 cables conectores al módulo de temperatura", ¿Es posible ofertar un cable sensor de temperatura que sea troncal + sensor, para temperatura de piel? P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "02 cables conectores al módulo de temperatura", ¿Es posible ofertar un cable sensor de temperatura que sea troncal + sensor, para temperatura esofágica/rectal? R: Se acepta mientras pueda cumplir con lo solicitado en la línea 251 referente a medición de 2 temperaturas simultáneas, y a la capacidad de conectar sensores de temperatura solicitados en las líneas N° 265 y 266.
- 01 Kit de montaje a pared o CPI según defina el hospital.
- Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en UTI — 12 Cable troncal de 12 lead (10 puntas) P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "12 Cable troncal de 12 lead (10 puntas)", ¿Es posible ofertar un cable ECG de 12 derivadas que sea único, es decir, troncal mas latiguillos? R: Se acepta
- 12 Cable ECG de 10 lead P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "12 Cable ECG de 10 lead", ¿Es posible ofertar un cable ECG de 12 derivadas que sea único, es decir, troncal mas latiguillos? R: Se acepta
- 12 Cable ECG de 5 o 6 lead
- 12 Cable ECG de 3 lead
- 06 Cable troncal de 3 lead reutilizable P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "06 Cable troncal de 3 lead reutilizable", ¿Es posible ofertar cables troncales de ECG que permitan la conexión con latiguillos de 3 y 6 derivadas? R: Se acepta
- 06 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable
- 12 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto
- 12 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto
- 03 Kit de conexiones y sensores de flujo lateral para medición de Capnografía P: En el ítem 2.4 sobre Accesorios para monitores de mediana complejidad, indican "03 Kit de conexiones y sensores de flujo lateral para medición de Capnografía", Tomando en consideración otras tecnologías de medición, como Mainstream, ¿Es posible ofertar kit de conexiones para este tipo de sensores, los que permiten una mejor medición y menor volumen de espacio muerto? R: Estimados, se modifica la cantidad de estos accesorios capnografía a 0, dado que el monitor UTI no incluye el módulo, sólo la capacidad de conectarse un módulo de capnografía Sidestream. Ver Líneas 190 a 193 para configuración UTI.
- 03 Kit para gasto cardiaco: cables conectores al módulo de GC + cable bifurcado + sensor de temperatura para sistema abierto u otros según aplique tecnología.
- 03 Kits para gasto cardiaco continuo P: Solicitan: "03 Kits para gasto cardiaco continuo" Favor definir los componentes del kit. (Transductor desechable + Catéter?) (¿Catéter acceso femoral, radial o braquial, cubital, French del cateter?) R: Se solicita en la generalidad, ofertar lo necesario para su operación, 1 para cada módulo solicitado.
- Operación — El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.

Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT)

- Debe incluir todos los equipos necesarios para la conectividad de la central: Switch, CPU, Pantallas, parlantes, periféricos, impresora y cables de conexión requeridos. Se dispondrá a nivel de obra exclusivamente de puntos de datos en el cupo y en la estación de enfermería.
- Interfaz de comunicación con impresora láser
- Requerimiento de Impresora para cada central de monitorización — Cada Central debe incluir impresora láser compatible con Central de Monitoreo
- Interfaz a impresora láser de la Central

Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT)

- 04 módulos de EEG de al menos 4 canales. Se considera 1 cada 4 cupos. P1: Por favor, permitir cumplimiento con oferta de monitor externo BIS Bilateral, que presenta en pantalla 4 canales de EEG. Los monitores externos se pueden conectar al monitor multiparámetros para su visualización en pantalla, y almacenamiento de valores en tendencias. P2: Estimados, en esta fila están solicitando medición de EEG de 4 canales. ¿es necesario que estos 4 canales sean bipolares? R1: Se acepta similar técnico que permita cumplir con lo solicitado considerando canales bipolares. R2: Sí. Se solicitan canales bipolares.