

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Anatomía Patológica

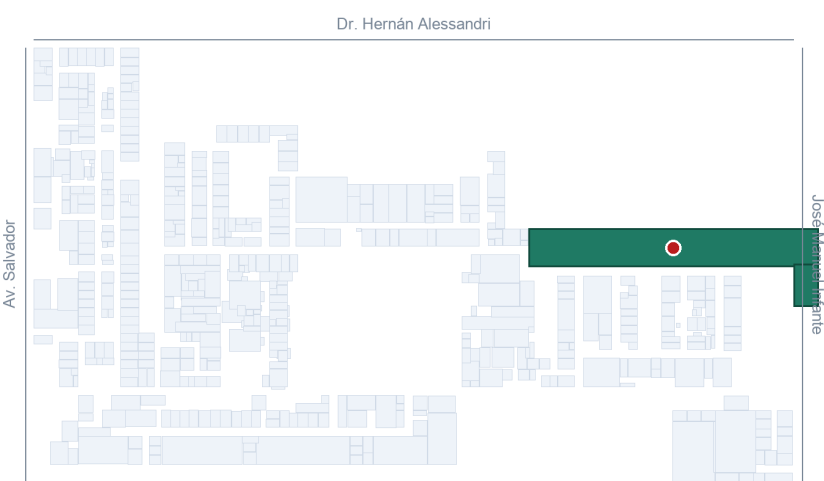
Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
44	178	17

Ubicación en el hospital

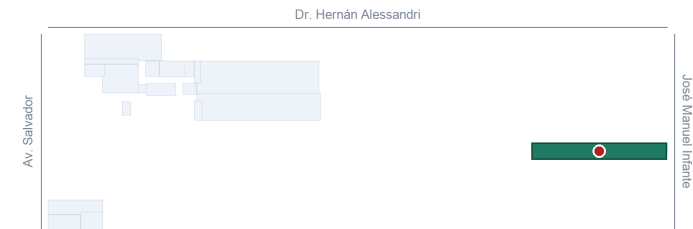
Pisos	Edificio	Servicio clínico 2026
P-2 · P-1	Atención Cerrada (HDS)	Anatomía Patológica



Capacidad clínica · atención cerrada	
■ Laboratorio	9

La planta corresponde al piso P-1 · área «ANATOMIA PATOLOGICA»


Otros pisos del servicio




Piso P-2 · área «ANATOMIA PATOLOGICA»

APOYO INDUSTRIAL

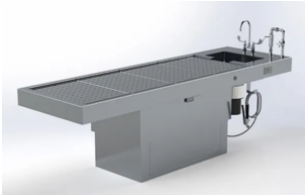
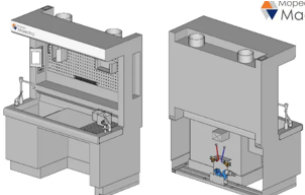
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Microondas Mademsa Onde 31 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No requiere		

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Microscopio Coobservacion Luz Polarizada LEICA MICROSYSTEMS DM2000 LED Ficha en Drive >	10
	Microscopio Universal Luz Polarizada LEICA MICROSYSTEMS DM2000 LED Ficha en Drive >	6
	Estufa de secado BINDER ED56 9010-0333 Ficha en Drive >	3
	Campana De extraccion gases organicos I ESCO EFD-4B8 Ficha en Drive >	2
	Citocentrifuga HETTICH Rotanta 380 Ficha en Drive >	1
	Microscopio 10 Cabezales Con Camara Digital LEICA MICROSYSTEMS LEICA DM2500 LED STAND, IVD Ficha en Drive >	1
	Microscopio Luz Polarizada Basico LEICA MICROSYSTEMS DM2000 LED Ficha en Drive >	1
	Baño Histologico General Data (TBS) FWS-L-220 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Cobertor de polvo		


 atos técnicos ación nominal 100 120 V/220 240 V	Placa Calefaccionada Leica HI1220 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Funda protectora		
	Placas frias MILESTONE 500001 HISTODREAM CM Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Balanza De Precision W&J; INSTRUMENT CO LTD JA10003 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 funda de proteccion		
	Procesador De Tejidos Leica ASP 6025 S Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • 01 UPS de 1,5 KVA		
	Balanza Analitica Digital OHAUS PR224 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 funda de proteccion		
 MC-SL416 MC-SL756 MC-SL1006	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Doble Puerta HAIER HYC-1099T Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		

	set de tincion PORLAB FLOWSTAIN SLIDE STAINING SYSTEM SS112 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No requiere		
	Sistema Integrado Cubridor Y Teñidor de Laminas LEICA BIOSYSTEMS SPECTRA WORKSTATION Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 set de filtros • 01 UPS 1.5 KVA		
	Balanza Peso Organos MOPEC BB014 BALANZA HS-30K - BB035 SOPORTE A PISO - CO016 SOPORTE A MESA Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Sistema de suspensión a mesa de autopsia (acero inoxidable) • 01 Sistema de suspensión rodable (acero inoxidable)		
	Freezer -30° C THERMO SCIENTIFIC TSX1230FV Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Incluir todo accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo • 02 Par de guantes de protección		
	Microtomo Rotatorio Semiautomatico Leica Multicut Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Set de herramientas estándar • 01 Pinza universal para cassetes. • 01 Set de Cuchillas Desechables estándar		

	Agitador Magnetico con calefactor VELP SA20500410 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Barra agitadora (Imán) tamaño S • 01 Barra agitadora (Imán) Tamaño M • 01 Barra agitadora (Imán) Tamaño L		
	PHmetro Thermo Orion STARA2115 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Electrodo de pH con dispositivo protector • 01 Sonda de Temperatura (si aplica). • 01 Set calibrador • 01 Funda Protectora		
	Agitador Vortex VELP F202A0173 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 aditamento para placa de microtubulo • 01 aditamento universal • 01 plataforma para placas • 01 aditamento para una mano • 01 aditamento para tubos de ensayo		
	Microscopio Inmunofluorescencia LEICA MICROSYSTEMS LEICA DM2000 LED Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Set de protectores de oculares para el microscopio o similar técnico. • 01 Funda protectora para microscopio • 01 kit de limpieza ára microscopio • 01 Frasco con aceite de inmersión. • El equipo deberá incorporar todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, con independencia de su estas fueran o no descritas en estas especificaciones técnicas.		

	Sierra Electrica Para Autopsias Mortech - BSN 0298-0270 - 0295-420 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Juego de llaves de fijación y mantenimiento • Dos (2) hojas circular serrada con eje fijo • Dos (2) hojas sección serrada con eje fijo • Eje de sierra estándar adicional • 01 contenedor para esterilización	
	Mesa Autopsia MOPEC CE210-EX Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Apoya cabeza multiposición • 01 Set de cuñas para elevación del cuerpo • 01 Tabla de Corte • 01 Lámpara Procedimiento Rodable de 80.000 lux • 01 Bandeja elevada de acero inoxidable de sobremesa para elementos de disección • 01 Cesta para lavado de órganos	
	Estacion Trabajo ANATOMIA PATOLOGICA MOPEC MB1060LEX Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 7 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla de disección de polietileno • 01 Contenedor de Desechos Ventilado • 01 Lupa • 01 Estantería en acero inoxidable • 02 Bidones para la dispensación y recolección de Formalina Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Estacion de Trabajo para un Operador, ancho aproximado de 1.50mt • 01 Brazo articulado para computador (tipo AIO) para Macroscopía Digital	
	Criostato LEICA BIOSYSTEMS CM1860 UV AG Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 7 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 10 cajas de cuchillas de perfil Alto • 10 cajas de cuchillas de perfil Bajo • 2 Batería de Tinción de 12 estaciones (24 láminas c/u) • 01 Herramienta expulsadora de navajas • 30 criomoldes • 10 tarros de spray congelante • 30 unidades de medio de soporte para biopsia rápida	

	Criostato Portatil LEICA BIOSYSTEMS CM1860 UV Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 7 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 10 cajas de cuchillas de perfil Alto • 10 cajas de cuchillas de perfil Bajo • 2 Batería de Tinción de 12 estaciones (24 láminas c/u) • 01 Herramienta expulsadora de navajas • 30 criomoldes • 10 tarros de spray congelante • 30 unidades de medio de soporte para biopsia rápida		
	Centro De Inclusion LEICA BIOSYSTEMS ARCADIA WORKSTATION Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 11 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Lupa de magnificación • Pinza eléctrica DIFERENTES MEDIDAS 3 unidades minimas • Pedal • Compactadores, 1 grande y 1 pequeño • Debe incluir moldes de acero inoxidable de diferentes tamaños: • Endoscopicos 50 UD • pequeños 50 UD • medianos 50 UD • grandes 50 UD • extra grandes 50 UD • FDA y/o CE y/o JIS y/o equivalente técnico.		
	Camara Mortuoria MATACHANA CAMARA TRES CUERPOS COD. 75036.6 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 14 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Sistema elevador de cadáver — 01 Carro elevador de bandejas porta cadáveres para los 3 niveles de estiba • Mecanismo de funcionamiento electromecánico y/o Electrohidráulico • Compatible con bandejas de la cámara • Estructura de acero inoxidable. • Sistema alzamiento tipo Doble Tijera • Con rodillos para desplazamiento frontal de bandeja • Con asidera parte de la estructura para manejo y traslado del carro • Batería integrada • Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno • Control de elevación y bajada • Capacidad de peso soportado mínimo 250 Kg • Balanza integrada al elevador — Sistema integrado de medición de peso • Balanza con capacidad de carga mínimo 250 kg • Visualizador digital de peso en kilogramos		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Bandeja Porta-Objetos (Laminas Histologicas) Simport M750-20W Ficha en Drive >	50
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.070 Piso Clinico Coinfyre MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo Asiento Ruedas con freno   	Piso Taburete Clinico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	18
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Archivador De Laminas Histologicas Porlab SC01-3026 Ficha en Drive >	10
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Camilla Cadaveres MATACHANA CAMILLA TRANSPORTE CADAVER COD. 75234 Ficha en Drive >	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Gabinete Almacenaje De Líquidos Inflamables (Mueble de seguridad) ASECOS Q-CLASSIC-30 modelo Q90.195.120 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Cubeto de retención o sistema de retención de químicos derramados		
	Gabinete Almacenaje Sustancias Peligrosas ASECOS Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Cubeto de retención o sistema de retención de químicos derramados		

	Escabel MALVESTIO FSH162102 Ficha en Drive >	1						
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica								
ITEM: 130.069 DESCRIPCION: Piso Clínico MARCA: CoinfyCare MODELO: MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD <table border="1"> <thead> <tr> <th>Requedo</th> <th>Asiento</th> <th>Ruedas con freno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Requedo	Asiento	Ruedas con freno				Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	1
Requedo	Asiento	Ruedas con freno						
								
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica								
	Armario Bloques De Parafina Porlab SC01-4026 Ficha en Drive >	10						
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Cierre superior (tapa) para cada armario • Cierre inferior (base) para cada armario NO rodable								
	Carro Transporte Cadaver HYGECO 32227-A Ficha en Drive >	1						
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Con sistema de arco para cubrir cadaver • 02 Lonas Opaca Lavable								
	Carro Transporte Cadaver Paciente Bariatrico HYGECO 32227-A Ficha en Drive >	1						
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Con sistema de arco para cubrir cadaver • 02 Lonas Opaca Lavable								

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		

SIN CLASIFICAR		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Gabinete Almacenaje para Formaldehído ASECOS Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116	2