

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Laboratorio Clínico

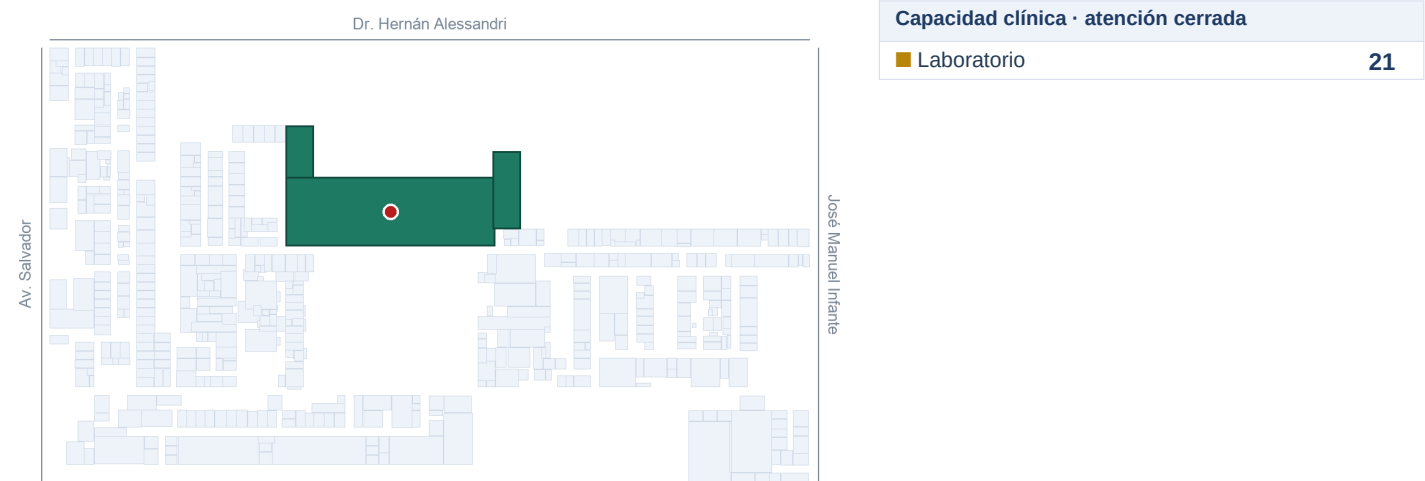
Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
55	239	25


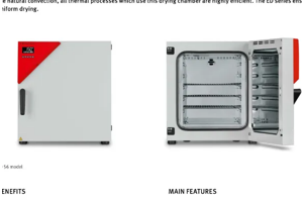
Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P-1	Atención Cerrada (HDS)	Laboratorio Clínico





Piso P-1 · área «LABORATORIO CLINICO»

ESTERILIZACION		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Autoclave Laboratorio SHP Steriltechnik Laboklav 80 MV Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Canastillos de acero inoxidable perforado o en malla • 02 Cilindros de acero inoxidable para pipetas y cápsulas de Petri Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Sistema de registro — Impresora integrada		

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Gabinete Bioseguridad Clase II A2 Telstar BIO II ADVANCE 4 Ficha en Drive >	9
	Microscopio Universal LEICA MICROSYSTEMS LEICA MICROSYSTEMS Ficha en Drive >	9
	Contador Celular DIGISYTEM DBC-9D Ficha en Drive >	7
	Estufa De Cultivo THERMO HERATHERM Ficha en Drive >	7
	Centrifuga Universal THERMO MEGAFUGE ST1 Ficha en Drive >	6
	Estufa De Secado BINDER ED56 9010-0333 Ficha en Drive >	3
	Microscopio Contraste de Fase ICOE HEMERA-E10 Ficha en Drive >	3
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño MIDEA BIOMEDICAL MC-5L126	3


	Campana De Extraccion gases organicos II ESCO EFD-6B8 Ficha en Drive >	2
	Centrifuga Refrigerada THERMO Megafuge ST4R PLUS Ficha en Drive >	2
	Espectrofotometro KLAB OPTIZEN NANOQ Ficha en Drive >	2
	Incinerador electrico de asas WLD-TEC 5001000 Ficha en Drive >	2
	Microscopio Contraste de Fase Trinocular LEICA MICROSYSTEMS MICROSCOPIO UNIVERSAL MOD. DM2000 LED Ficha en Drive >	2
	Microscopio Coobervacion LEICA MICROSYSTEMS LEICA DM2000 LED Ficha en Drive >	2
	Baño Seco BIOBASE BK-100-1 Ficha en Drive >	1
	Campana De Flujo Laminar TELSTAR AEOLUS H5 Ficha en Drive >	1
	Citocentrifuga HETTICH Rotanta 380 Ficha en Drive >	1

	Microscopio 5 Cabezales LEICA MICROSYSTEMS LEICA DM2500 LED STAND, IVD Ficha en Drive >	1
	Microscopio Coobservacion 3 cabezales LEICA MICROSYSTEMS LEICA DM2000 LED Ficha en Drive >	1
	Microscopio Trinocular LEICA MICROSYSTEMS DM2000 LED Ficha en Drive >	1
	Microscopio Universal Luz Polarizada LEICA MICROSYSTEMS DM2000 LED Ficha en Drive >	1
	Set Micropipetas Automaticas Axygen KITS Ficha en Drive >	1
 MC-SL416 MC-SL756 MC-SL1006	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Doble Puerta HAIER HYC-1099T Ficha en Drive >	7
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		
 Waterbath Model size 6 / 11 / 15 +10 °C ab	Baño Termorregulado MEMMERT WTB6 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios 01 set de gradillas para tubos por equipo		
 The Microfuge 16 offers fast, powerful micro-centrifugation in an easy-to-use, compact design. Powerful - spins up to 16,000 x g for fast pelleting in volumes of 0.2mL, 0.5mL, 1.5mL and 2.0mL Compact - fits easily in the tightest of laboratory environments with a height under 7 inches (178mm) and a footprint measuring 8.5 by 10.5 inches (216 by 267mm) Productive - handles sample throughput with an innovative auto-hold for when you need a 10-60 second pause Reliable - handles a load of 100g	Microcentrifuga 12T Beckman Coulter Life Science Microfuge 16 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios Rotor para mínimo 12 microtubos de al menos 1,5/2.0 ml		


	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		
	Balanza Analitica Digital OHAUS PR224 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios 01 funda de proteccion		
	Estacion De Trabajo Para Pcr ESCO SCR-2A1 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) Accesorios Obligatorios — Cada equipo ofertado deberá incorporar un soporte dedicado al tamaño de la estación de trabajo PCR, de materialidad resistente (deberá ser fijo o con ruedas y frenos)		
	Agitador Magnetico OHAUS GUARDIAN 5000 ST (230V) Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios 02 barra de agitación de tamaño estándar		
	Agitador Circular Para Vdrl MRC DOR-2828D Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Balanza De Precision W&J; INSTRUMENT CO LTD JA10003 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios 01 funda de proteccion		


 atos técnicos ación nominal 100 120 V/220 240 V	Placa Calefaccionada Leica HI1220 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Funda protectora	
 Thermo Scientific® TSX 1447 liter	Freezer -30° C THERMO SCIENTIFIC TSX1230FV Ficha en Drive >	11
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Incluir todo accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo • 02 Par de guantes de protección	
	Termobloque MEDICAL 150-S + BLOQU Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Bloque para tubos de 1,5 mm • 01 bloque para tubos de 2,0 mm	
	Termociclador BIORAD T100 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Registros y Comunicación — Interfaz de computador para conectividad Puerto RS-232 y/o USB	
 yo de 2022 3	Termociclador Tiempo Real BIORAD CFX OPUS 96 DX Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios y otros — Impresora Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Control externo a través de PC o notebook según aplique.	
	Extractor Automatizado De Adn/Arn QIAGEN QIAcube HT Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Incluir mueble de apoyo y computador de control • 01 Software que permita la cuantificación de ácidos nucleicos extraídos	

	Freezer -80°C 380L HAIER DW-86L388J Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Incluir todo accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo • 02 Par de guantes de protección		
	Secuenciador De Adn/Arn ILLUMINA DX-410-1001 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador interno integrado — Computador procesador intel core i7, 2,10GHz CPU, al menos 16 GB de memoria RAM, disco duro de 750 GB, con sistema operativo Windows 7 instalado. • Programas (software) incluido en computador interno que permitan el correcto funcionamiento del equipo para todas su operatividad		
	Mechero Bunsen WLD 2100000 Ficha en Drive >	11
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Boquilla para propano/butano, gas licuado y gas natural • 01 adaptador para conexión a bombonera • 01 bombonera compatible con equipo		
	Escaner de Metafases ASI HIBAND SCANNING SYSTEM Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador — Computador de procesador intel core i7 o similar técnico • Deberá incluir un computador de las siguientes características: procesador i5 o superior (Indicar), sistema operativo Windows 10, Disco Duro de 500 GB como mínimo, Pantalla de 20" o superior y UPS de respaldo Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Deberá incorporar una impresora térmica a color		
	Freezer -80°C 500L MIDEA BIOMEDICAL MD-86L568 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Incluir sistema de seguridad integrado ante apagado repentino. Puede ser por medio de CO2, N2 o similar. Favor especificar en la columna "comentarios" • Incluir todo accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo • 02 Par de guantes de protección		

	Transiluminador CORNING Axigen GDBL-1000 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Cámara Digital — Mínimo 5 megapíxeles • Otros — 01 Adaptador para cámara • 01 Software análisis de geles • 01 Cable de conexión a estación de trabajo	
	PHmetro Thermo Orion STARA2115 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Electrodo de pH con dispositivo protector • 01 Sonda de Temperatura (si aplica). • 01 Set calibrador • 01 Funda Protectora	
	Agitador Vortex VELP F202A0173 Ficha en Drive >	23
	» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 aditamento para placa de microtubulo • 01 aditamento universal • 01 plataforma para placas • 01 aditamento para una mano • 01 aditamento para tubos de ensayo	
	Microscopio Inmunofluorescencia LEICA MICROSYSTEMS LEICA DM2000 LED Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Set de protectores de oculares para el microscopio o similar técnico. • 01 Funda protectora para microscopio • 01 kit de limpieza ára microscopio • 01 Frasco con aceite de inmersión. • El equipo deberá incorporar todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, con independencia de su estas fueran o no descritas en estas especificaciones técnicas.	

	Estufa De Cultivo CO2 THERMO HERACELL VIOS 160i Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • Accesorios — Manómetro CO2 para conectar entre la red de gases y el equipo • Incluir mínimo 03 bandejas de acero inoxidable • 10 portaplacas con capacidad para mínimo 30 placas c/u, de material resistente a temperaturas, lavable y desinfectable. • 10 gradillas metálicas con capacidad para mínimo 50 tubos (16 x 160 [mm]) c/u • Incluye toda manguera o conexión que requiera el equipo para su funcionamiento • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional	
	Lupa Estereoscopica LEICA MICROSYSTEMS S9i Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 7 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Cámara fotográfica digital — Compatible con lupa • Mínimo de 5 Mp • Tiempo de captura menor o igual a 2 seg. • Autofoco • Con conexión HDMI y/O USB • Otros — 01 Adaptador de la cámara a la lupa • 01 Protector de polvo	
	Camara Electroforesis Vertical CLEAVER OMNIPAGE MINI Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 01 Fuente de Poder de corriente máxima hasta 600mA • 01 Porta electrodos • 06 Electrodos • 01 juego de peinetas de 11 dientes • 01 juego de peinetas de 15 dientes • 02 Placas disipadoras • 01 Cables de interconexión • 01 Kit de montaje	

	HPLC (Cromatografía Liquida De Alta Eficieciencia) JASCO LC 4000 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Caja de herramienta apropiada para actividades de rutina • 03 columnas C18 para los análisis requeridos. • 02 Jeringa de inyección para HPLC, 25 µl o equivalente • 10 Precolumnas compatibles con columnas a incorporar. • 04 Botellas para solventes con soporte Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador — Computador con características necesarias para el correcto funcionamiento del equipo, ultima tecnología Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — Impresora a tinta o laser B/N y color , conexión USB		
	Camara Electroforesis Horizontal CLEAVER MULTISUB CHOISE Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 9 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 01 Fuente de Poder de 500 mA • 01 Porta electrodos • 06 Electrodos • 01 Juego de Peinetas de 22 dientes como mínimo y 29 como máximo. • 01 juego de peinetas de 16 dientes como mínimo y 20 como máximo • 01 juego de peinetas de 30 dientes como mínimo y 36 como máximo. • 02 Placas disipadoras • 01 Cables de interconexión • 01 Kit de montaje		

MOBILIARIO CLINICO			
Imagen		Equipo / Ítem	Cant.
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.070 Piso Clínico COINFYRE MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo  Asiento  Ruedas con freno 		Piso Taburete Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	56
		» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	
		Archivador De Laminas Histologicas Porlab SC01-3026 Ficha en Drive >	6
		» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica	
		Carro 2 Bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	2
		» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	