

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Procedimientos Cirugia


Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
32	128	12

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P2	Atención Abierta (AA)	Procedimientos Cirugia

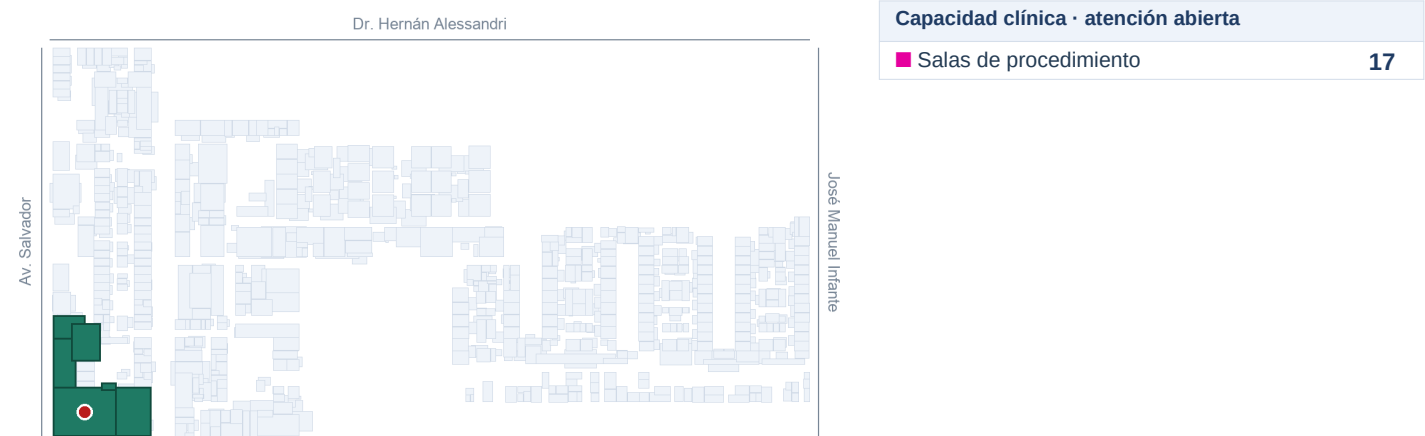

Piso P2 · área «CONSULTAS PROCEDIMIENTO QUIRURGICOS»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L1111111A rodable Ficha en Drive >	5
	Negatoscopio 3 Caras MPLENT ZG-3B Ficha en Drive >	2
	Negatoscopio 2 Caras MINSTON MSTXD LED2 Ficha en Drive >	1

	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	15
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 01 par de olivas de repuesto.		
	Balanza Paciente Bariátrico Health o Meter 1100KL Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable y/o cable para red eléctrica		
	Doppler Con Pletismografía Vascular VIASONIX FALCON PRO Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora externa B/N y Color		
	Balanza Adulto Con Tallímetro SECA 777 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar		

	Equipo Urodinamia LABORIE AQUARIUS LT Ficha en Drive >	1
	» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo Transductores (2 tipos · 2 unidades en total) 1 × Transductores de presión (reutilizables) frecuencia no declarada 1 × Transductores rectales y 02 vaginales para estudios de EMG frecuencia no declarada » Accesorios y componentes de la tipología · 14 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Impresora Laser o tinta convencional • 02 Transductores de presión (reutilizables) • 01 Silla de micción • 01 Bomba de infusión para flujos solicitados • 02 Transductores rectales y 02 vaginales para estudios de EMG • Llaves y domos • Set de Bajadas para bomba de infusión • Catéteres para medición simultánea de presión (2 vías) • Catéteres rectales (2 vías) • Conectores para catéter incluidos • Set de Electrodo • Todos los accesorios necesarios para la puesta en marcha Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Interfases — PC o laptop Externo • Computador — Tipo PC o Laptop	
	Uroflujometro LABORIE FLOWMASTER Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Silla micción con apoyabrazos y adaptación para embudo • Papel de impresión • Impresora externa • Carro para computador e impresora Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Características Generales — Tipo PC o Laptop	
	Doppler Vascular Portatil HUNTLEIGH KIT ITB Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios — Transductor Doppler 4.0 o 5.0 MHz referencial • Transductor Doppler 8.0 MHz • Maletín de almacenaje y transporte • Cargador de batería • Audífonos • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional. Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Incluir software para estudios de post procesamiento en estación de trabajo • Interfases — PC, monitor externo e impresora externa Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Interfases — PC, monitor externo e impresora externa Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Interfases — PC, monitor externo e impresora externa	

APOYO ENDOSCOPICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Torre De VideoCistocopia Karl Storz IMAGE1 Ficha en Drive >	2
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo · el servicio recibe 2 Endoscopios (total = 6 unidades) 3 × Videocistoscopio flexible de diagnóstico 11272 VHK/VSK · campo de visión 100°, longitud de trabajo 370 mm, canal de trabajo 2,31 mm (7,0 Charr), tubo de inserción 5,28 mm, angulación 210° arriba / 140° abajo Uretrótomo (9 ítems · 84 unidades en total) 2 × Óptica 0° gran angular 4 mm (27005 AA) (EETT exigía 1) 2 × Elemento de trabajo para resección y uretrotomía (27050E) (EETT exigía 1) 2 × Camisa 21 Fr con canal para filiformes-bougies (27068DK) (EETT exigía 1) 2 × Obturador para camisa (27068DO) (EETT exigía 1) 1 × Puente para camisa con canal 5 Fr (27068CD) 1 × Camisa suplementaria (27068F) 24 × Bisturí de Sachse recto 21 Fr (27069K) (EETT exigía 12) 4 × Cuchillo de corte redondo (EETT exigía 2) 4 × Vaina de protección para esterilización de electrodos y cuchilletes (EETT exigía 2) Óptica y luz (total = 4 unidades) 2 × Cable de fibra óptica 300 cm / 3,5 mm (495NA) (EETT exigía 1) Instrumental (2 ítems · 4 unidades en total) 1 × Pinza para pequeños fragmentos 5 Fr de 73 cm 1 × Pinza de biopsia 5 Fr de 73 cm Periféricos (total = 2 unidades) 1 × Impresora láser color 2 en total para las dos torres		

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	7
	Bomba Aspiracion Universal Ca-Mi ASKIR 36 BR	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Tubos de silicona autoclavables. • 01 Sonda de aspiración • 02 Filtro antibacterial		
	Motor De Yeso HEBU MEDICAL GMBH HB8889-01/HB8894GO Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Hoja de sierra de acero inoxidable utilizada para yeso convencional. Cantidad: dos (2) hojas por equipo. • Hoja de sierra de nitruro de titanio utilizada para yeso sintético. Cantidad: una (1) hoja por equipo. • Hoja de sierra para yeso convencional y sintético (mixto). Cantidad: una (1) hoja por equipo. • Cepillo para limpieza del motor. • Lubricante para mantenimiento. • Maletín para almacenaje del equipo y sus accesorios. • Filtros utilizados por la bomba de aspiración. Cantidad: diez (10) filtros por bomba. • Contenedor de color neutro con tapa de acero inoxidable para esterilización del equipo • Se debe incluir filtros utilizados por el contenedor. Cantidad: diez (10) unidades por equipo. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas.		

APOYO TERAPEUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Calentador De Paciente 3M BAIR HUGGER 675 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 10 Mantas para adulto por equipo. • Rodable.		

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Ecotomografo Doppler Color Multiproposito GE HEALTHCARE LOGIQ FORTIS Ficha en Drive >	2
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo · el servicio recibe 2 Vascular — 1 equipo · LOGIQ FORTIS 1 × Transductor Lineal de Alta Frecuencia ML6-15-D · 4.0–15.0 MHz 1 × Transductor Especifico para Aplicaciones Vasculares L2-9-D · 2.0–9.0 MHz 1 × Transductor Sectorial Cardiaco M5Sc-D · 1.4–4.6 MHz 1 × Transductor Convexo C1-6-D · 1.5–6.0 MHz Urologia — 1 equipo · LOGIQ FORTIS 1 × Transductor Abdominal Convexo C1-6-D · 1.5–6.0 MHz 1 × Transductor Lineal Prostatico ML6-15-D · 4.0–15.0 MHz 1 × Transductor Transrectal Doble Vista Biplanar BE9CS-D · 4.0–11.0 MHz » Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Una (1) Funda protector. • Un (1) Cable para exportar imágenes • Un (1) Cable para exportar audio/video • Incluir guía de aguja para transductores • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Bandeja para impresora • Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Composición de imágenes panorámicas en modo B		

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
temperature range, CDC, clinical laboratories.  MC-5L126 	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño MIDEA BIOMEDICAL MC-5L126	2

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.069 Piso Clínico COINFYRE MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo Asiento Ruedas con freno 	Piso Clínico COINFYRE MA08 Ficha en Drive >	17
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	11
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad		
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Soporte Universal SCHMITZ SCHMITZ PORTASUERO 242.2351.0 Ficha en Drive >	7
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro 2 Bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro compresero LUPUS MEDICAL OPR-1093 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • NA		

	Carro Instrumental Yeso LUPUS MEDICAL OPR-3005 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable		
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	10
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		
	Camilla Urologica STRYKER GYNNIE Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Soporte universal de apoya piernas. • 01 Soporte para Descanso de pies • 01 Bandeja recolectora de fluidos • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable • 01 Escabel		

	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediátrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	9
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		
	Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad GENERAL ELECTRIC B105 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 25 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios Básicos por monitor — 01 Cable troncal de 3 lead R: Se aclara. Se acepta cables de 3 y 6 derivadas o cable de conexión completa sin división en más latiguillos. • 01 Cable troncal de 5 a 6 lead • 01 Cable ECG de 3 lead • 01 Cable ECG de 5 a 6 lead • Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto • 01 manguera de presión no invasiva		

- 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables
- 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto
- 01 cables conectores al módulo de temperatura R: Se aclara. Se aceptan ofertas con cable único (troncal + sensor de temperatura) , siempre que se oferte sensores para piel y esofágica/rectal según EETT N° 76 y 77
- 01 Sensor de temperatura de piel adulto
- 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- 01 Carro de transporte
- Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en Monitores de Baja Complejidad — 15 Cable troncal de 3 lead reutilizable. R: Se aclara. Se acepta cable de ECG y troncal unidos o troncal para 3 y 6 derivadas, esto en las cantidades solicitadas.
- 15 Cable troncal de 5 lead reutilizable
- 20 Cable ECG de 3 lead
- 20 Cable ECG de 5 lead
- 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto R: Se aclara. Se acepta sensores SpO2 de tecnología propia, esto para el total de la oferta.
- 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto
- 20 Sensores de temperatura de piel adulto
- 20 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- Operación — Manual de operación en idioma español
- Manual de servicio (inglés o español)
- El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.