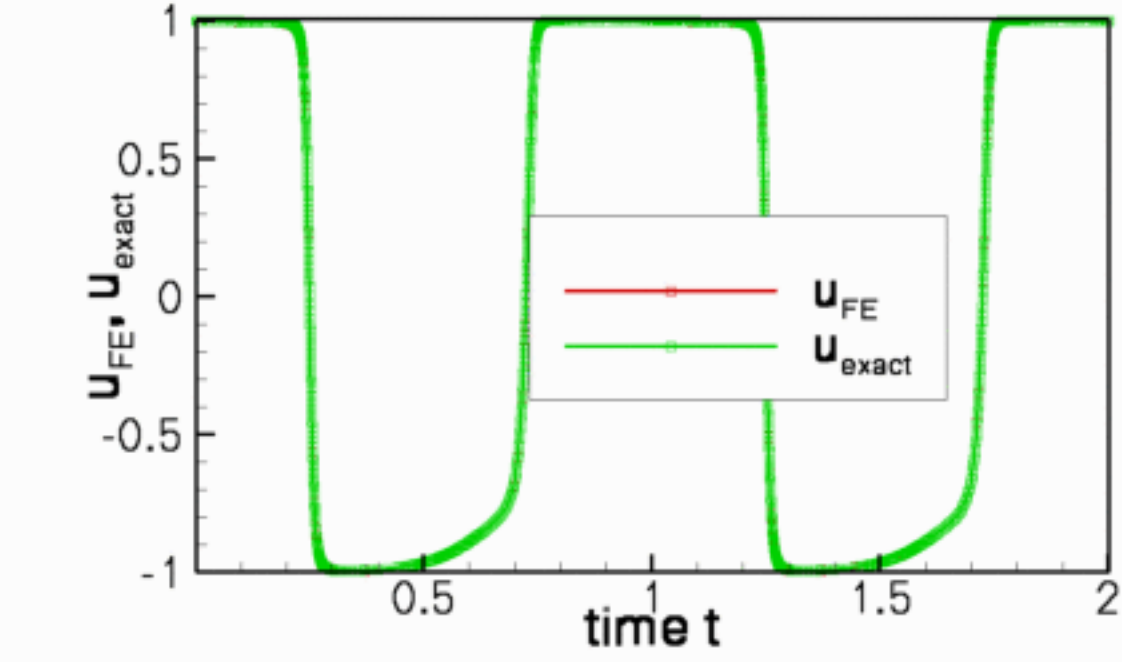
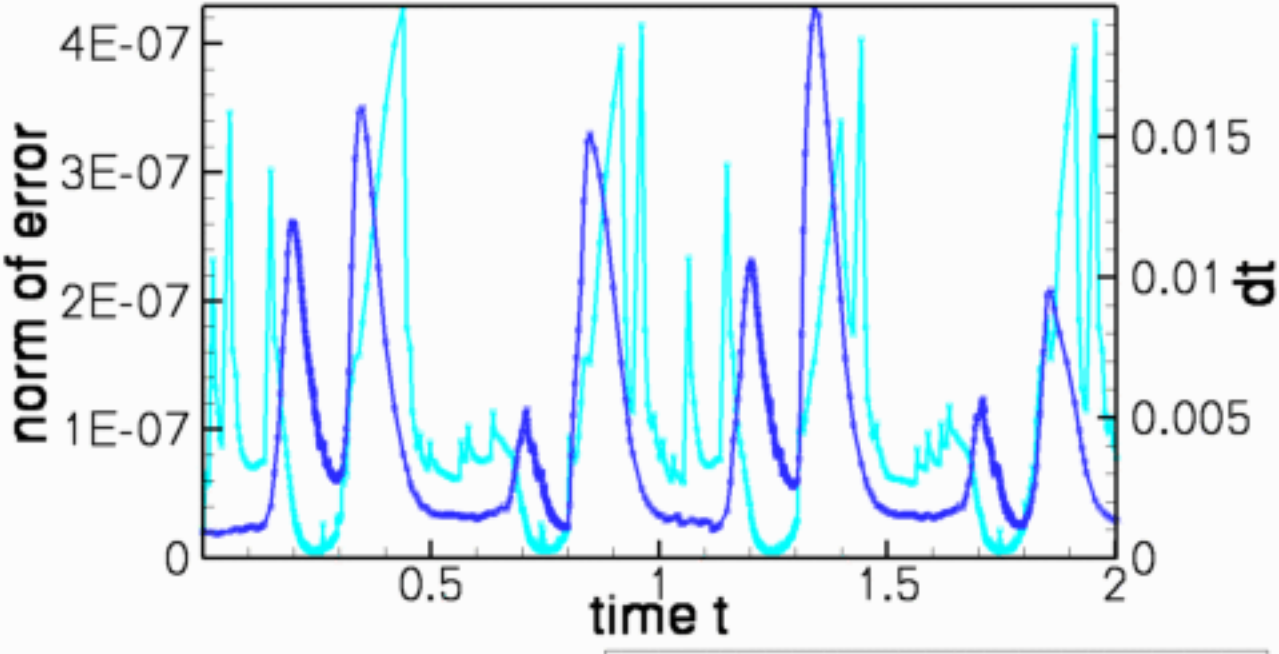
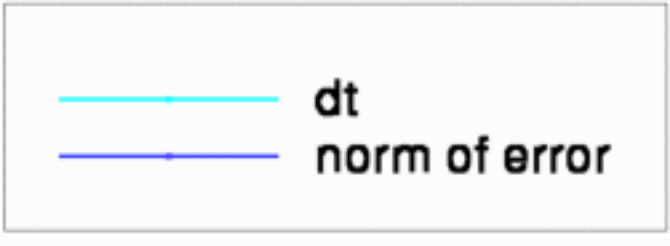

1
0.5
0
-0.5
-1
u_{FE}, u_{exact}
0.5
1
1.5
2
time t
u_{FE}
u_{exact}


4E-07
3E-07
2E-07
1E-07
0
norm of error
0.5
1
1.5
2
time t
0.015
0.01
0.005
0
dt


dt
norm of error