



INFORME TECNICO FINAL

CLIENTE: QUINPE SRL

DOC. DE INGRESO: N/A





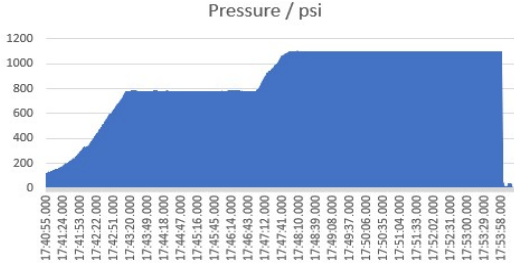


ID DE EQUIPO: MOV 216



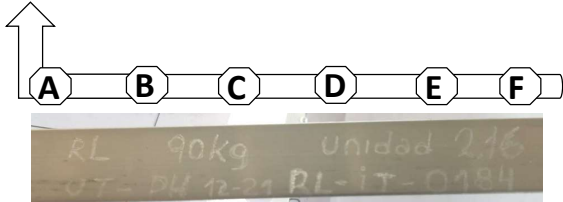

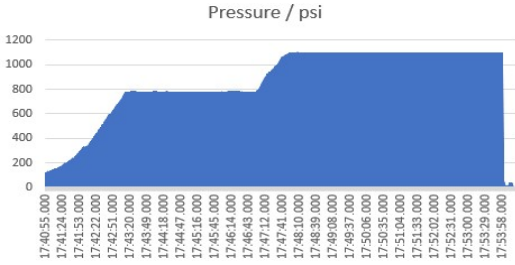

N° INFORME: RL-IT-0184



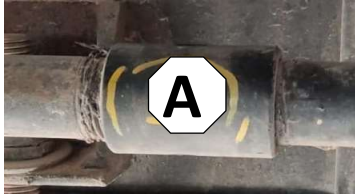

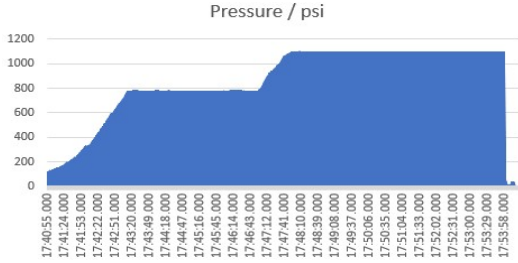


TIPO DE ENSAYO: PH UT



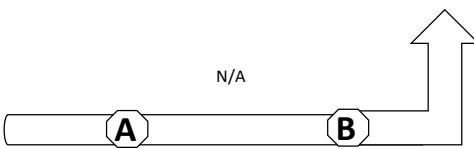


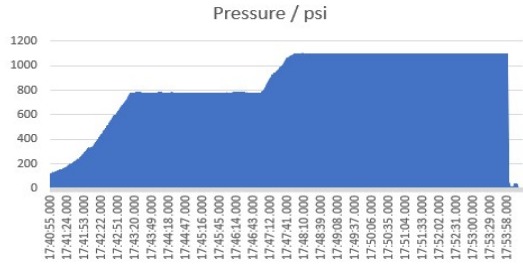


FECHA: 21/12/2021





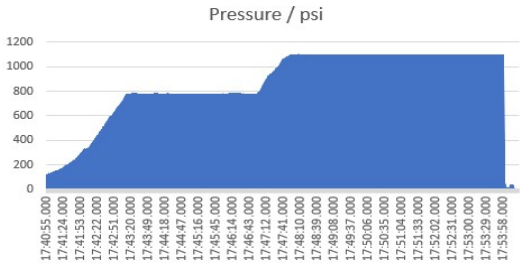


[illegible]



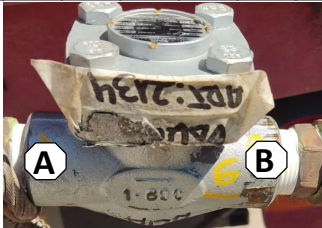

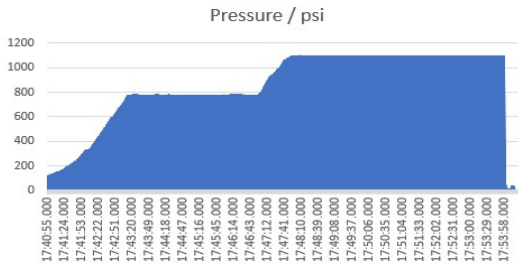


		INFORME TECNICO FINAL				RL-RG-001-02 															
		HOJA		3 DE		10															
N° DE INFORME:		RL-IT-0184		DOC. INGRESO:		IN SITU															
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		21/12/2021															
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO															
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES															
NORMA:		N/A																			
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00																					
DESCRIPCION DE PIEZA:																					
CODO 2"																					
EQUIPO		216		CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)													
PRECINTO		RL 90KG UNI 216 UT-PH 12-21 RL-IT-0184		PUNTO	A	B	C	D	E	F											
TP		80KG /1160 PSI		0	11,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
TRABAJOS REALIZADOS				3	14,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)										
LIMPIEZA PREVIA				6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P.	80KG /1160 PSI									
DESARMADO				9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P.	N/A									
INSPECCION VISUAL																					
CONTROL DIMENSIONAL																					
MEDICION DE ESPESORES																					
ENSAMBLADO																					
LIQUIDOS PENETRANTES																					
PARTICULAS MAGNETIZABLES																					
ENGRASE																					
REEMPLAZO DE SELLOS																					
REEMPLAZO DE PIEZAS																					
PRUEBAS HIDROSTATICAS																					
PINTADO																					
PRECINTADO O ESTAMPADO																					
KIT COMPLETO DE REPARACION																					
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO													
				X																	
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO																	
																					
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A				N/A													
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
OBSERVACIONES:																					
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:													
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:													
																					
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:													
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.																	
FECHA:				FECHA:				FECHA:													
21/12/2021				21/12/2021																	




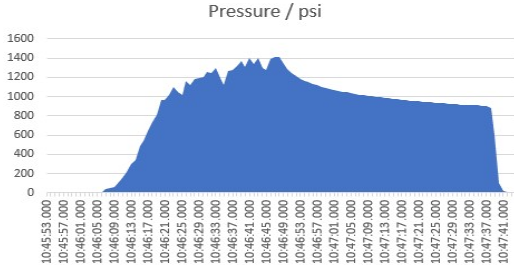


		INFORME TECNICO FINAL				RL-RG-001-02 									
		HOJA		4 DE		10									
N° DE INFORME:		RL-IT-0184		DOC. INGRESO:		IN SITU									
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		21/12/2021									
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO									
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES									
NORMA:		N/A													
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00															
DESCRIPCION DE PIEZA:															
LINEA 2"															
EQUIPO		216		CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)							
PRECINTO		RL 90KG UNI 216 UT-PH 12-21 RL-IT-0184		PUNTO	A	B	C	D	E	F					
TP		80KG /1160 PSI		0	4,9	4,9	4,6	4,3	4,4	4,4	N/A				
TRABAJOS REALIZADOS				SI	NO	3	5,6	4,8	4,7	4,6	4,2	4,6	PH (PSI)		
LIMPIEZA PREVIA				X		6	6,7	4,8	4,4	5,1	5,5	5,8	T.P. 80KG /1160 PSI		
DESARMADO					X	9	N/A	4,6	4,8	4,4	4,8	5,2	W.P. N/A		
INSPECCION VISUAL				X											
CONTROL DIMENSIONAL					X										
MEDICION DE ESPESORES				X											
ENSAMBLADO					X										
LIQUIDOS PENETRANTES					X										
PARTICULAS MAGNETIZABLES					X										
ENGRASE					X										
REEMPLAZO DE SELLOS					X										
REEMPLAZO DE PIEZAS					X										
PRUEBAS HIDROSTATICAS				X											
PINTADO					X										
PRECINTADO O ESTAMPADO				X		THICKNESS	NOMINAL	ALLOWABLE							
KIT COMPLETO DE REPARACION					X	DIAMET.	mm	in.	mm	in.					
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
RESULTADO DE INSPECCION						APTO		NO APTO							
						X									
REGISTRO FOTOGRAFICO						GRÁFICO									
															
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A									
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A								
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A								
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A								
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A								
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A								
OBSERVACIONES:															
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:							
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:							
															
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:							
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.											
FECHA:				FECHA:				FECHA:							
21/12/2021				21/12/2021											




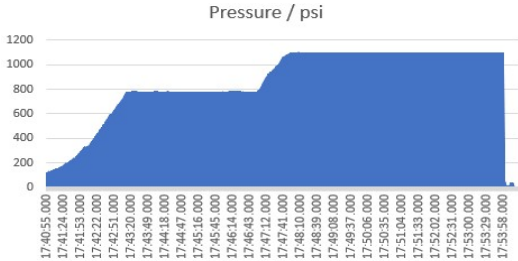


		INFORME TECNICO FINAL				RL-RG-001-02 													
		HOJA		5 DE		10													
N° DE INFORME:		RL-IT-0184		DOC. INGRESO:		IN SITU													
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		21/12/2021													
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO													
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES													
NORMA:		N/A																	
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00																			
DESCRIPCION DE PIEZA:																			
CONECTOR 2"																			
EQUIPO		216		CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)											
PRECINTO		RL 90KG UNI 216 UT-PH 12-21 RL-IT-0184		PUNTO	A	B	C	D	E	F									
TP		80KG /1160 PSI		0	8,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
TRABAJOS REALIZADOS				3	8,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)								
LIMPIEZA PREVIA				6	8,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P.	80KG /1160 PSI							
DESARMADO				9	8,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P.	N/A							
INSPECCION VISUAL																			
CONTROL DIMENSIONAL																			
MEDICION DE ESPESORES																			
ENSAMBLADO																			
LIQUIDOS PENETRANTES																			
PARTICULAS MAGNETIZABLES																			
ENGRASE																			
REEMPAZO DE SELLOS																			
REEMPLAZO DE PIEZAS																			
PRUEBAS HIDROSTATICAS																			
PINTADO																			
PRECINTADO O ESTAMPADO																			
KIT COMPLETO DE REPARACION																			
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO											
				X															
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO															
																			
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A				N/A											
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A			MARCA:	N/A										
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A			MODELO:	N/A										
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A			N° INTERNO:	N/A										
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A			N° SERIE:	N/A										
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A			VTO:	N/A										
OBSERVACIONES:																			
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:											
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:											
																			
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:											
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.															
FECHA:				FECHA:				FECHA:											
21/12/2021				21/12/2021															

		INFORME TECNICO FINAL				RL-RG-001-02 							
		HOJA		5 DE		10							
N° DE INFORME:		RL-IT-0184		DOC. INGRESO:		IN SITU							
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		21/12/2021							
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO							
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES							
NORMA:		N/A											
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00													
DESCRIPCION DE PIEZA:													
LINEA 2"													
EQUIPO		216		CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)					
PRECINTO		RL 90KG UNI 216 UT-PH 12-21 RL-IT-0184		PUNTO	A	B	C	D	E	F			
TP		80KG /1160 PSI		0	4,6	4,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
TRABAJOS REALIZADOS				3	4,4	4,7	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)		
LIMPIEZA PREVIA				6	4,4	4,3	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P.	80KG /1160 PSI	
DESARMADO				9	4,3	4,3	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P.	N/A	
INSPECCION VISUAL													
CONTROL DIMENSIONAL													
MEDICION DE ESPESORES													
ENSAMBLADO													
LIQUIDOS PENETRANTES													
PARTICULAS MAGNETIZABLES													
ENGRASE													
REEMPLAZO DE SELLOS													
REEMPLAZO DE PIEZAS													
PRUEBAS HIDROSTATICAS													
PINTADO				THICKNESS		NOMINAL		ALLOWABLE					
PRECINTADO O ESTAMPADO				DIAMET.		mm		in.		mm		in.	
KIT COMPLETO DE REPARACION				N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO					
				X									
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO									
 													
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A				N/A					
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A		
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A		
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A		
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A		
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A	VTO:	N/A	VTO:	N/A		
OBSERVACIONES:													
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:					
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:					
													
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:					
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.									
FECHA:				FECHA:				FECHA:					
21/12/2021				21/12/2021									

		INFORME TECNICO FINAL				RL-RG-001-02 							
		HOJA		7 DE		10							
N° DE INFORME:		RL-IT-0184		DOC. INGRESO:		IN SITU							
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		21/12/2021							
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO							
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES							
NORMA:		N/A											
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00													
DESCRIPCION DE PIEZA:													
CODO 2"													
EQUIPO		216		CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)					
PRECINTO		RL 90KG UNI 216 UT-PH 12-21 RL-IT-0184		PUNTO	A	B	C	D	E	F			
TP		80KG /1160 PSI		0	15,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
TRABAJOS REALIZADOS				3	14,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)		
LIMPIEZA PREVIA				6	13,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P.	80KG /1160 PSI	
DESARMADO				9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P.	N/A	
INSPECCION VISUAL													
CONTROL DIMENSIONAL													
MEDICION DE ESPESORES													
ENSAMBLADO													
LIQUIDOS PENETRANTES													
PARTICULAS MAGNETIZABLES													
ENGRASE													
REEMPLAZO DE SELLOS													
REEMPLAZO DE PIEZAS													
PRUEBAS HIDROSTATICAS													
PINTADO				THICKNESS		NOMINAL		ALLOWABLE					
PRECINTADO O ESTAMPADO				DIAMET.		mm		in.		mm		in.	
KIT COMPLETO DE REPARACION				N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO					
				X									
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO									
													
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A				N/A					
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A		
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A		
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A		
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A		
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A	VTO:	N/A	VTO:	N/A		
OBSERVACIONES:													
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:					
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:					
													
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:					
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.									
FECHA:				FECHA:				FECHA:					
21/12/2021				21/12/2021									

		INFORME TECNICO FINAL				RL-RG-001-02 													
		HOJA		8 DE		10													
N° DE INFORME:		RL-IT-0184		DOC. INGRESO:		IN SITU													
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		21/12/2021													
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO													
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES													
NORMA:		N/A																	
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00																			
DESCRIPCION DE PIEZA:																			
VALVULA RETENCIÓN																			
EQUIPO		216		CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)											
PRECINTO		RL 90KG UNI 216 UT-PH 12-21 RL-IT-0184		PUNTO	A	B	C	D	E	F									
TP		80KG /1160 PSI		0	8,8	9,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
TRABAJOS REALIZADOS				3	9,3	9,3	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)								
LIMPIEZA PREVIA				6	8	9,1	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P.	80KG /1160 PSI							
DESARMADO				9	9,8	9,6	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P.	N/A							
INSPECCION VISUAL																			
CONTROL DIMENSIONAL																			
MEDICION DE ESPESORES																			
ENSAMBLADO																			
LIQUIDOS PENETRANTES																			
PARTICULAS MAGNETIZABLES																			
ENGRASE																			
REEMPLAZO DE SELLOS																			
REEMPLAZO DE PIEZAS																			
PRUEBAS HIDROSTATICAS																			
PINTADO																			
PRECINTADO O ESTAMPADO																			
KIT COMPLETO DE REPARACION																			
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO											
				X															
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO															
																			
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A													
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A												
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A												
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A												
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A												
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A												
OBSERVACIONES:																			
REALIZO: FIRMA:  NOMBRE Y APELLIDO: SANTIN CATERINO, DAMIAN FECHA: 21/12/2021				APROBO: FIRMA:  NOMBRE Y APELLIDO: RODRIGUEZ, ROBERTO A. FECHA: 21/12/2021				RECIBIO: FIRMA: NOMBRE Y APELLIDO: FECHA:											

		INFORME TECNICO FINAL				RL-RG-001-02 							
		HOJA		9 DE		10							
N° DE INFORME:		RL-IT-0184		DOC. INGRESO:		IN SITU							
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		21/12/2021							
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO							
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES							
NORMA:		N/A											
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00													
DESCRIPCION DE PIEZA:													
VALVULA DEFOGUE													
EQUIPO		216		CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)					
PRECINTO		RL 90KG UNI 216 UT-PH 12-21 RL-IT-0184		PUNTO	A	B	C	D	E	F			
TP		90KG /1305 PSI		0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
TRABAJOS REALIZADOS				3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)		
LIMPIEZA PREVIA				6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P.	90KG /1305 PSI	
DESARMADO				9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P.	N/A	
INSPECCION VISUAL				N/A									
CONTROL DIMENSIONAL													
MEDICION DE ESPESORES													
ENSAMBLADO													
LIQUIDOS PENETRANTES													
PARTICULAS MAGNETIZABLES													
ENGRASE													
REEMPAZO DE SELLOS													
REEMPLAZO DE PIEZAS													
PRUEBAS HIDROSTATICAS													
PINTADO				THICKNESS		NOMINAL		ALLOWABLE					
PRECINTADO O ESTAMPADO				DIAMET.		mm		in.		mm		in.	
KIT COMPLETO DE REPARACION				N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO					
				X									
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO									
													
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A				N/A					
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A		
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A		
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A		
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A		
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A	VTO:	N/A	VTO:	N/A		
OBSERVACIONES:													
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:					
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:					
													
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:					
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.									
FECHA:				FECHA:				FECHA:					
21/12/2021				21/12/2021									

		<h1>INFORME TECNICO FINAL</h1>				RL-RG-001-02						
												
		HOJA		10		DE		10				
N° DE INFORME:		RL-IT-0184		DOC. INGRESO:		IN SITU						
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		21/12/2021						
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO						
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES						
NORMA:		N/A										
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00										
DESCRIPCION DE PIEZA:												
MANGUEROTE												
EQUIPO		216		CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG. (mm)		
PRECINTO		RL 90KG UNI 216 UT-PH 12-21 RL-IT-0184		PUNTO	A	B	C	D	E	F		
TP		80KG /1160 PSI		0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRABAJOS REALIZADOS				SI	NO	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA				X		6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 80KG /1160 PSI
DESARMADO					X	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL				X		N/A						
CONTROL DIMENSIONAL					X							
MEDICION DE ESPESORES					X							
ENSAMBLADO					X							
LIQUIDOS PENETRANTES					X							
PARTICULAS MAGNETIZABLES					X							
ENGRASE					X							
REEMPLAZO DE SELLOS					X							
REEMPLAZO DE PIEZAS					X							
PRUEBAS HIDROSTATICAS				X								
PINTADO					X	THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE			
PRECINTADO O ESTAMPADO				X		DIAMET.	mm	in.	mm	in.		
KIT COMPLETO DE REPARACION					X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
RESULTADO DE INSPECCION						APTO		NO APTO				
						X						
REGISTRO FOTOGRAFICO						GRÁFICO						
												
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A						
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A					
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A					
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A					
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A					
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A					
OBSERVACIONES:												
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:				
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:				
												
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.								
FECHA:				FECHA:				FECHA:				
21/12/2021				21/12/2021								