







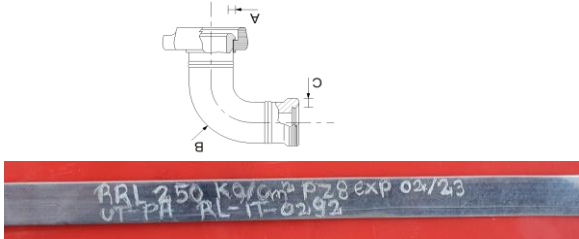

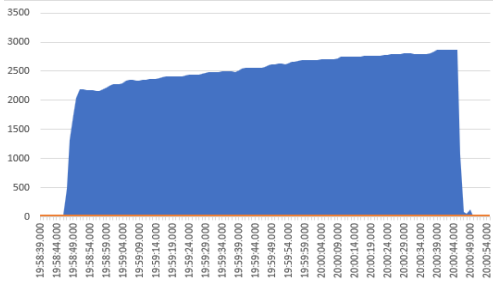



INFORME TECNICO FINAL






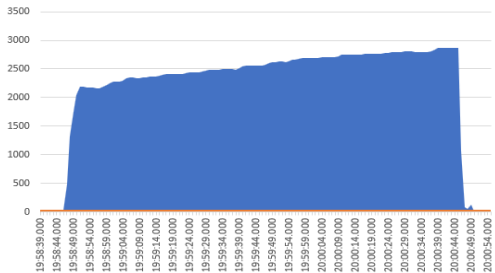



CLIENTE:	QUINPE SRL
DOC. DE INGRESO:	387
ID DE EQUIPO:	CERTIFICACION DE EQUIPO 131
N° INFORME:	RL-IT-0292
TIPO DE ENSAYO:	PH -UT
FECHA:	18/2/2022






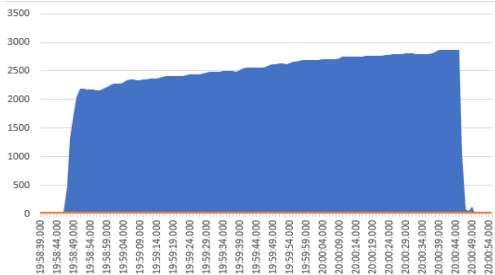


		INFORME TECNICO FINAL				RL-RG-001-02 			
		HOJA		2		DE		24	
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387			
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022			
SECTOR:		TALLER		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO			
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		ID EQUIPO:		CERTIFICACION DE EQUIPO 131			
				INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES			
DETALLE DE PIEZAS									
PIEZA	HOJA	DESCRIPCION	EQUIPO	PRECINTO	TP	FECHA DE INSP.	RESUL	OBS.	
1	1	CODO 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
2	1	LINEA 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
3	1	TEE 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
4	1	LINEA 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
5	1	CODO 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
6	1	LINEA 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
7	1	CODO 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
8	1	LINEA 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
9	1	CODO 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
10	1	LINEA 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
11	1	CODO 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
12	1	LINEA 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
13	1	ACOPLE 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
14	1	TEE 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
15	1	CODO 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
16	1	CODO 2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
17	1	ACOPLE 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
18	1	ACOPLE 2X2"	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
19	1	MANGUEROTE	PZ8 131	RRL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292	250KG/CM - 3500PSI	02/22	APTO		
OBSERVACIONES:									
REALIZO:			APROBO:			RECIBIO:			
FIRMA:			FIRMA:			FIRMA:			
 #####									
NOMBRE Y APELLIDO:			NOMBRE Y APELLIDO:			NOMBRE Y APELLIDO:			
SANTIN CATERINO, DAMIAN			RODRIGUEZ, ROBERTO A.						
FECHA:			FECHA:			FECHA:			
18/2/2022			18/2/2022						





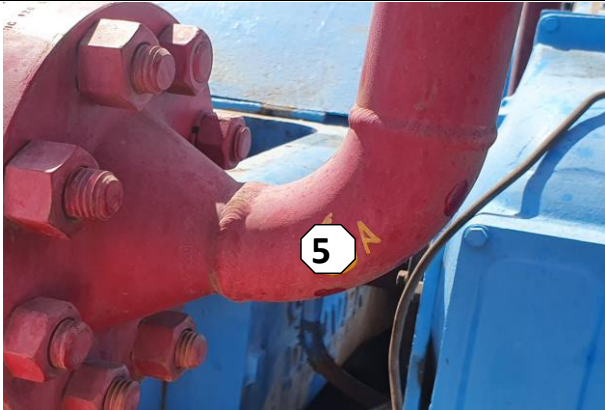
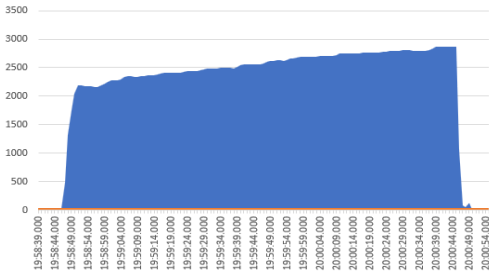


[illegible]





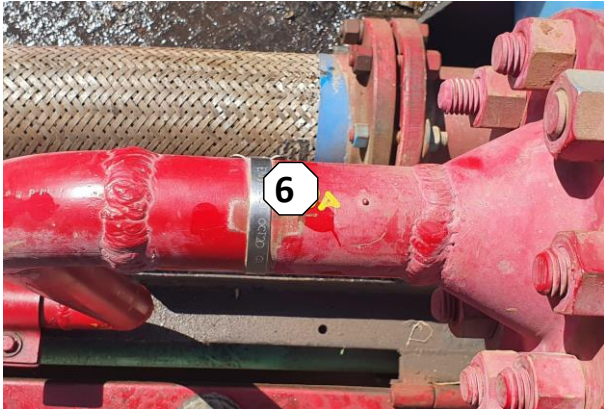
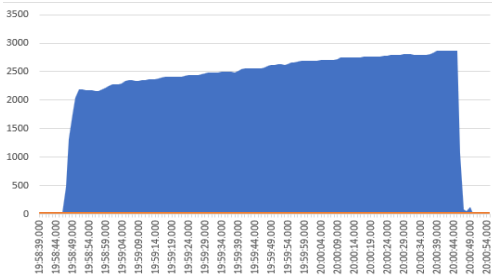


<div><div></div><div>OILFIELD SOLUTIONS</div></div>		<div>INFORME TECNICO FINAL</div>				<div>RL-RG-001-02</div> <div><div></div><div>QUINPE</div></div>					
HOJA		4 DE		24							
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO: 387							
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO: 18/2/2022							
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN: BASE FERNANDEZ ORO							
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO: DAMIAN PAREDES							
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00											
DESCRIPCION DE PIEZA:											
CODO 2X2"											
EQUIPO		PZ8 131		CONTROL DIMENSIONAL (mm)			LONG. (mm)				
PRECINTO		RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029		PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP		250KG/CM - 3500PSI		0	7,5	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	N/A
TRABAJO REALIZADO		SI	NO	3	6,7	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA		X		6	7,2	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	T.P. 50KG/CM - 3500PSI
DESARMADO			X	9	7,9	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL		X		<div></div>							
CONTROL DIMENSIONAL			X								
MEDICION DE ESPESORES		X									
ENSAMBLADO			X								
LIQUIDOS PENETRANTES			X								
PARTICULAS MAGNETIZABLES											
ENGRASE			X								
REEMPAZO DE SELLOS			X								
REEMPLAZO DE PIEZAS			X								
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X		THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE				
PINTADO			X	DIAMET.	mm	in.	mm	in.			
PRECINTADO O ESTAMPADO		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
KIT COMPLETO DE REPARACION			X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
RESULTADO DE INSPECCION				APTO			NO APTO				
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
<div></div>				<div></div>							
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A			N/A				
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:		N/A			
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:		N/A			
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:		N/A			
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:		N/A			
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:		N/A			
OBSERVACIONES:											
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:			
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:			
<div></div>				<div></div>							
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:			
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.							
FECHA:				FECHA:				FECHA:			
18/2/2022				18/2/2022							


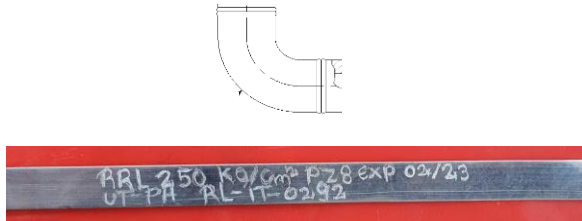

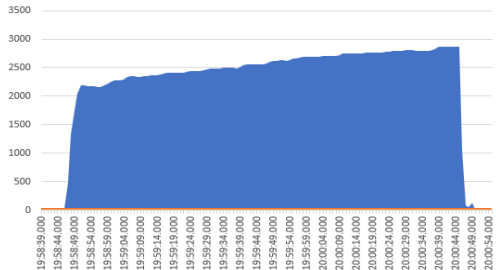



		<h1>INFORME TECNICO FINAL</h1>						RL-RG-001-02 					
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387							
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022							
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO							
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES							
NORMA:		N/A											
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00											
DESCRIPCION DE PIEZA:													
LINEA 2X2"													
EQUIPO	PZ8 131			CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG. (mm)			
PRECINTO	RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029			PUNTO	A	B	C	D	E	F			
TP	250KG/CM - 3500PSI			0	7,9	8	7,5	N/A	N/A	N/A			
TRABAJOS REALIZADOS				SI	NO	3	7,9	8,02	7,6	N/A	N/A	4,6	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA				X		6	8	7,9	7,7	N/A	N/A	5,8	T.P. 50KG/CM - 3500P
DESARMADO					X	9	7,9	7,7	7,7	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL				X		 							
CONTROL DIMENSIONAL					X								
MEDICION DE ESPESORES				X									
ENSAMBLADO					X								
LIQUIDOS PENETRANTES					X								
PARTICULAS MAGNETIZABLES					X								
ENGRASE					X								
REEMPAZO DE SELLOS					X								
REEMPLAZO DE PIEZAS					X								
PRUEBAS HIDROSTATICAS				X									
PINTADO					X								
PRECINTADO O ESTAMPADO				X		THICKNESS		NOMINAL		ALLOWABLE			
KIT COMPLETO DE REPARACION					X	DIAMET.		mm		in.			
						mm		in.					
						N/A		N/A		N/A			
						N/A		N/A		N/A			
RESULTADO DE INSPECCION						APTO		NO APTO					
REGISTRO FOTOGRAFICO						X							
						GRÁFICO							
													
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A							
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A						
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A						
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A						
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A						
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A						
OBSERVACIONES:													
REALIZO:		APROBO:		RECIBIO:									
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:									
													
NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:									
SANTIN CATERINO, DAMIAN		RODRIGUEZ, ROBERTO A.		DAMIAN PAREDES									
FECHA:		FECHA:		FECHA:									
18/2/2022		18/2/2022		18/2/2022									



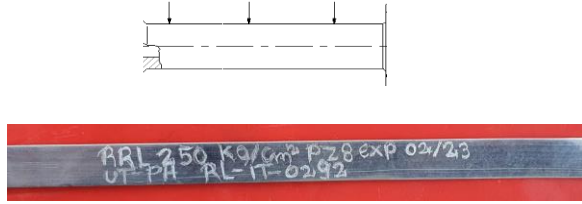

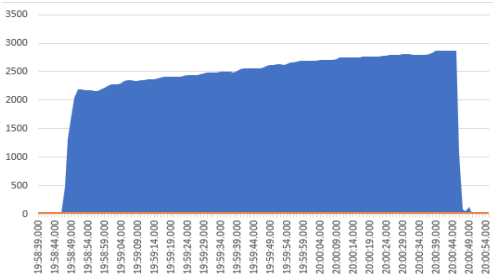



<div><div></div><div>OILFIELD SOLUTIONS</div></div>		<div>INFORME TECNICO FINAL</div>				<div>RL-RG-001-02</div> <div><div></div><div>QUINPE</div></div>					
HOJA		6 DE		24							
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO: 387							
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO: 18/2/2022							
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN: BASE FERNANDEZ ORO							
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO: DAMIAN PAREDES							
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00											
DESCRIPCION DE PIEZA:											
TEE 2X2"											
EQUIPO		PZ8 131		CONTROL DIMENSIONAL (mm)			LONG. (mm)				
PRECINTO		RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029		PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP		250KG/CM - 3500PSI		0	8,9	11,6	11,3	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJO REALIZADO		SI NO		3	9,7	11,7	11,5	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA		X		6	8,4	12,2	11,6	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500PSI
DESARMADO		X		9	10,4	11,4	11	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL		X		<div></div>							
CONTROL DIMENSIONAL		X									
MEDICION DE ESPESORES		X									
ENSAMBLADO		X									
LIQUIDOS PENETRANTES		X									
PARTICULAS MAGNETIZABLES		X									
ENGRASE		X									
REEMPAZO DE SELLOS		X									
REEMPLAZO DE PIEZAS		X									
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X									
PINTADO		X		THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE				
PRECINTADO O ESTAMPADO		X		DIAMET.	mm	in.	mm	in.			
KIT COMPLETO DE REPARACION		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
RESULTADO DE INSPECCION				APTO			NO APTO				
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
<div></div>				<div></div>							
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A			N/A				
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A				
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A				
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A				
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A				
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A				
OBSERVACIONES:											
REALIZO:		APROBO:		RECIBIO:							
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:							
<div></div>		<div></div>		<div></div>							
NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:							
SANTIN CATERINO, DAMIAN		RODRIGUEZ, ROBERTO A.		DAMIAN PAREDES							
FECHA:		FECHA:		FECHA:							
18/2/2022		18/2/2022		18/2/2022							



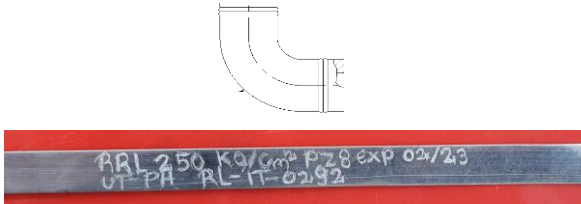

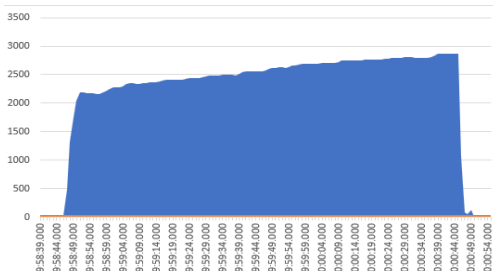


<div><div></div><div>OILFIELD SOLUTIONS</div></div>		<div>INFORME TECNICO FINAL</div>				<div>RL-RG-001-02</div> <div><div></div><div>QUINPE</div></div>																		
HOJA		7 DE		24																				
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387																		
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022																		
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO																		
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES																		
NORMA:		N/A																						
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00																						
DESCRIPCION DE PIEZA:																								
LINEA 2X2"																								
EQUIPO		PZ8 131		CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)																
PRECINTO		RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029		PUNTO	A	B	C	D	E	F														
TP		250KG/CM - 3500PSI		0	7,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A													
TRABAJO REALIZADO		SI	NO	3	8,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)													
LIMPIEZA PREVIA		X		6	8,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500P													
DESARMADO			X	9	8,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A													
INSPECCION VISUAL		X		<div></div> <div></div>																				
CONTROL DIMENSIONAL			X																					
MEDICION DE ESPESORES		X																						
ENSAMBLADO			X																					
LIQUIDOS PENETRANTES			X																					
PARTICULAS MAGNETIZABLES			X																					
ENGRASE			X	<div><table><tr><th>THICKNESS</th><th>NOMINAL</th><th>ALLOWABLE</th></tr><tr><td>DIAMET.</td><td>mm</td><td>in.</td><td>mm</td><td>in.</td></tr><tr><td></td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table></div>								THICKNESS	NOMINAL	ALLOWABLE	DIAMET.	mm	in.	mm	in.		N/A	N/A	N/A	N/A
THICKNESS	NOMINAL	ALLOWABLE																						
DIAMET.	mm	in.	mm									in.												
	N/A	N/A	N/A	N/A																				
REEMPAZO DE SELLOS			X																					
REEMPLAZO DE PIEZAS			X																					
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X																						
PINTADO			X																					
PRECINTADO O ESTAMPADO		X																						
KIT COMPLETO DE REPARACION			X																					
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO																
				X																				
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO																				
<div></div>				<div></div>																				
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A																		
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A																	
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A																	
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A																	
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A																	
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A																	
OBSERVACIONES:																								
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:																
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:																
<div></div>				<div></div>																				
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:																
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.																				
FECHA:				FECHA:				FECHA:																
18/2/2022				18/2/2022																				



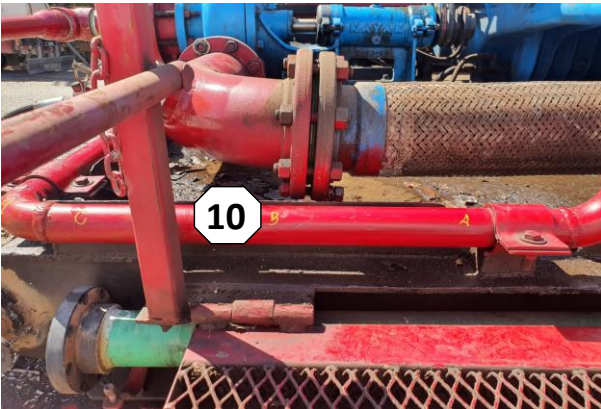
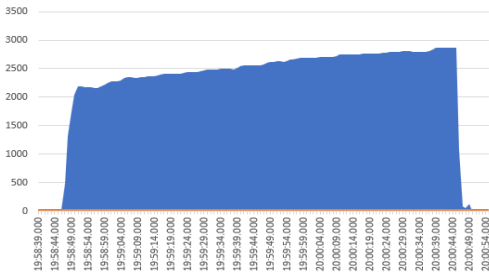


		INFORME TECNICO FINAL						RL-RG-001-02 			
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387		HOJA 8 DE 24			
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00									
DESCRIPCION DE PIEZA:											
CODIGO 2X2"											
EQUIPO		PZ8 131		CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG. (mm)	
PRECINTO		RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029		PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP		250KG/CM - 3500PSI		0	7,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS		SI	NO	3	6,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA		X		6	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500P
DESARMADO			X	9	6,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL		X		 							
CONTROL DIMENSIONAL			X								
MEDICION DE ESPESORES		X									
ENSAMBLADO			X								
LIQUIDOS PENETRANTES			X								
PARTICULAS MAGNETIZABLES			X								
ENGRASE			X								
REEMPAZO DE SELLOS			X								
REEMPLAZO DE PIEZAS			X								
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X									
PINTADO			X	THICKNESS		NOMINAL		ALLOWABLE			
PRECINTADO O ESTAMPADO		X		DIAMET.		mm		in.		mm	
KIT COMPLETO DE REPARACION			X	N/A		N/A		N/A		N/A	
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO			
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
											
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A				N/A			
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A	VTO:	N/A	VTO:	N/A
OBSERVACIONES:											
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:			
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:			
											
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:			
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.							
FECHA:				FECHA:				FECHA:			
18/2/2022				18/2/2022							



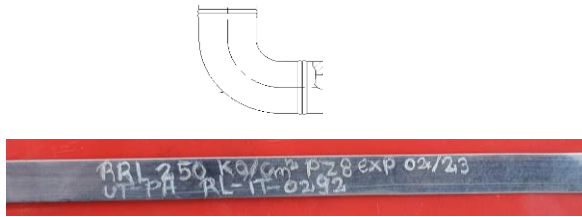

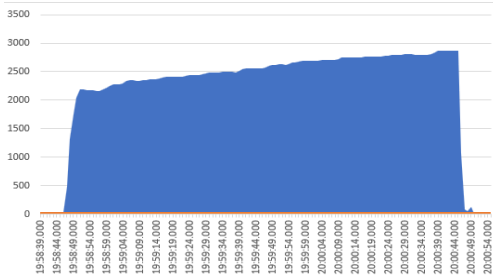


<div><div></div><div>OILFIELD SOLUTIONS</div></div>		<div>INFORME TECNICO FINAL</div>				<div>RL-RG-001-02</div> <div><div></div><div>QUINPE</div></div>																		
HOJA		9 DE		24																				
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO: 387																				
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO: 18/2/2022																				
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN: BASE FERNANDEZ ORO																				
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO: DAMIAN PAREDES																				
NORMA:		N/A																						
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00																								
DESCRIPCION DE PIEZA:																								
LINEA 2X2"																								
EQUIPO		PZ8 131		CONTROL DIMENSIONAL (mm)			LONG. (mm)																	
PRECINTO		RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029		PUNTO	A	B	C	D	E	F														
TP		250KG/CM - 3500PSI		0	8,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A													
TRABAJO REALIZADO		SI	NO	3	8,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)													
LIMPIEZA PREVIA		X		6	7,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500PSI													
DESARMADO			X	9	8,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A													
INSPECCION VISUAL		X		<div></div> <div></div>																				
CONTROL DIMENSIONAL			X																					
MEDICION DE ESPESORES		X																						
ENSAMBLADO			X																					
LIQUIDOS PENETRANTES			X																					
PARTICULAS MAGNETIZABLES			X																					
ENGRASE			X	<div><table><tr><th>THICKNESS</th><th>NOMINAL</th><th>ALLOWABLE</th></tr><tr><td>DIAMET.</td><td>mm</td><td>in.</td><td>mm</td><td>in.</td></tr><tr><td></td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table></div>								THICKNESS	NOMINAL	ALLOWABLE	DIAMET.	mm	in.	mm	in.		N/A	N/A	N/A	N/A
THICKNESS	NOMINAL	ALLOWABLE																						
DIAMET.	mm	in.	mm									in.												
	N/A	N/A	N/A	N/A																				
REEMPAZO DE SELLOS			X																					
REEMPLAZO DE PIEZAS			X																					
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X																						
PINTADO			X																					
PRECINTADO O ESTAMPADO		X																						
KIT COMPLETO DE REPARACION			X																					
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO																
				X																				
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO																				
<div></div>				<div></div>																				
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A				N/A																
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A			MARCA:	N/A															
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A			MODELO:	N/A															
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A			N° INTERNO:	N/A															
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A			N° SERIE:	N/A															
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A			VTO:	N/A															
OBSERVACIONES:																								
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:																
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:																
<div></div>				<div></div>																				
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:																
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.																				
FECHA:				FECHA:				FECHA:																
18/2/2022				18/2/2022																				

		INFORME TECNICO FINAL						RL-RG-001-02 			
		HOJA		10 DE		24					
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387					
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00									
DESCRIPCION DE PIEZA:											
CODO 2X2"											
EQUIPO		PZ8 131		CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG. (mm)	
PRECINTO		RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029		PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP		250KG/CM - 3500PSI		0	7,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS		SI	NO	3	7,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA		X		6	6,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500P
DESARMADO			X	9	7,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL		X									
CONTROL DIMENSIONAL			X								
MEDICION DE ESPESORES		X									
ENSAMBLADO			X								
LIQUIDOS PENETRANTES			X								
PARTICULAS MAGNETIZABLES			X								
ENGRASE			X								
REEMPAZO DE SELLOS			X								
REEMPLAZO DE PIEZAS			X								
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X									
PINTADO			X	THICKNESS		NOMINAL		ALLOWABLE			
PRECINTADO O ESTAMPADO		X		DIAMET.		mm		in.		mm	
KIT COMPLETO DE REPARACION			X	N/A		N/A		N/A		N/A	
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO			
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
											
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A					
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A				
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A				
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A				
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A				
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A				
OBSERVACIONES:											
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:			
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:			
											
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:			
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.				DAMIAN PAREDES			
FECHA:				FECHA:				FECHA:			
18/2/2022				18/2/2022				18/2/2022			






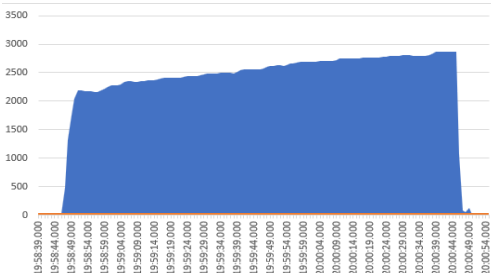


	<h1 style="text-align: center;">INFORME TECNICO FINAL</h1>						RL-RG-001-02						
													
HOJA		11		DE		24							
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387							
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022							
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO							
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES							
NORMA:		N/A											
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00											
DESCRIPCION DE PIEZA:													
LINEA 2X2"													
EQUIPO	PZ8 131			CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG.			
PRECINTO	RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029			PUNTO	A	B	C	D	E	F	(mm)		
TP	250KG/CM - 3500PSI			0	8,3	8,3	8,5	N/A	N/A	N/A	N/A		
TRABAJOS REALIZADOS				SI	NO						PH (PSI)		
LIMPIEZA PREVIA				X		3	8,1	7,4	8	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
DESARMADO					X	6	8,2	8,2	8,2	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500P
INSPECCION VISUAL				X		9	8,1	8,1	8	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
CONTROL DIMENSIONAL					X								
MEDICION DE ESPESORES				X									
ENSAMBLADO					X								
LIQUIDOS PENETRANTES					X								
PARTICULAS MAGNETIZABLES					X								
ENGRASE					X								
REEMPAZO DE SELLOS					X								
REEMPLAZO DE PIEZAS					X								
PRUEBAS HIDROSTATICAS				X									
PINTADO					X								
PRECINTADO O ESTAMPADO				X		THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE				
KIT COMPLETO DE REPARACION					X	DIAMET.	mm	in.	mm	in.			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
RESULTADO DE INSPECCION						APTO		NO APTO					
REGISTRO FOTOGRAFICO						X							
						GRÁFICO							
													
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A							
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A						
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A						
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A						
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A						
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A						
OBSERVACIONES:													
REALIZO:		APROBO:		RECIBIO:									
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:									
													
NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:									
SANTIN CATERINO, DAMIAN		RODRIGUEZ, ROBERTO A.		DAMIAN PAREDES									
FECHA:		FECHA:		FECHA:									
18/2/2022		18/2/2022		18/2/2022									






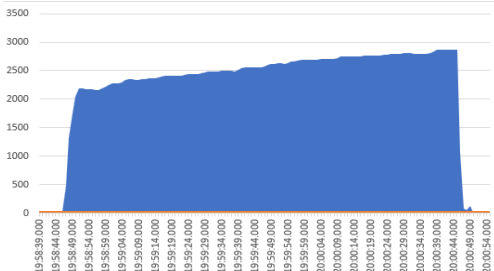


	<h1 style="text-align: center;">INFORME TECNICO FINAL</h1>						RL-RG-001-02					
												
HOJA		12		DE		24						
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387						
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022						
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO						
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES						
NORMA:		N/A										
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00										
DESCRIPCION DE PIEZA:												
CODO 2X2"												
EQUIPO	PZ8 131			CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG.		
PRECINTO	RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029			PUNTO	A	B	C	D	E	F	(mm)	
TP	250KG/CM - 3500PSI			0	8,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRABAJOS REALIZADOS				SI	NO						PH (PSI)	
LIMPIEZA PREVIA				X		3	8,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESARMADO					X	6	8,5	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500P
INSPECCION VISUAL				X		9	8,6	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
CONTROL DIMENSIONAL					X							
MEDICION DE ESPESORES				X								
ENSAMBLADO					X							
LIQUIDOS PENETRANTES					X							
PARTICULAS MAGNETIZABLES					X							
ENGRASE					X							
REEMPAZO DE SELLOS					X							
REEMPLAZO DE PIEZAS					X							
PRUEBAS HIDROSTATICAS				X								
PINTADO					X							
PRECINTADO O ESTAMPADO				X		THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE			
KIT COMPLETO DE REPARACION					X	DIAMET.	mm	in.	mm	in.		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
RESULTADO DE INSPECCION						APTO		NO APTO				
						X						
REGISTRO FOTOGRAFICO						GRÁFICO						
												
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A						
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A					
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A					
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A					
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A					
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A					
OBSERVACIONES:												
REALIZO:				APROBO:		RECIBIO:						
FIRMA:				FIRMA:		FIRMA:						
												
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:						
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.								
FECHA:				FECHA:		FECHA:						
18/2/2022				18/2/2022								



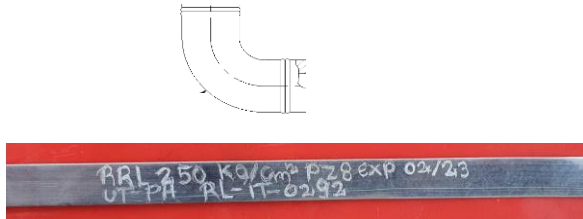

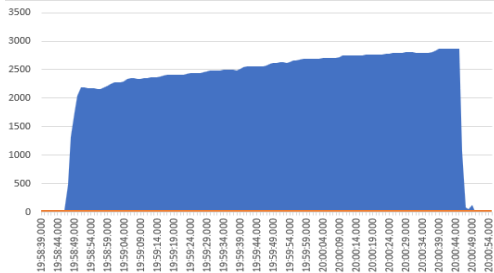


<div><div></div><div>OILFIELD SOLUTIONS</div></div>		<div>INFORME TECNICO FINAL</div>				<div>RL-RG-001-02</div> <div><div></div><div>QUINPE</div></div>						
HOJA		13		DE		24						
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387						
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022						
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO						
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES						
NORMA:		N/A										
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00										
DESCRIPCION DE PIEZA:												
LINEA 2X2"												
EQUIPO		PZ8 131		CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG. (mm)		
PRECINTO		RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029		PUNTO	A	B	C	D	E	F		
TP		250KG/CM - 3500PSI		0	5,1	5,1	5,2	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRABAJOS REALIZADOS		SI	NO	3	5,5	5,2	5,7	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)	
LIMPIEZA PREVIA		X		6	5,5	5,6	5,7	N/A	N/A	N/A	T.P.	50KG/CM - 3500P
DESARMADO			X	9	5,5	5,2	5,6	N/A	N/A	N/A	W.P.	N/A
INSPECCION VISUAL		X										
CONTROL DIMENSIONAL			X									
MEDICION DE ESPESORES		X										
ENSAMBLADO			X									
LIQUIDOS PENETRANTES			X									
PARTICULAS MAGNETIZABLES			X									
ENGRASE			X									
REEMPAZO DE SELLOS			X									
REEMPLAZO DE PIEZAS			X									
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X		THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE					
PINTADO			X	DIAMET.	mm	in.	mm	in.				
PRECINTADO O ESTAMPADO		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
KIT COMPLETO DE REPARACION			X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO				
				X								
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO								
												
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A						
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A					
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A					
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A					
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A					
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A					
OBSERVACIONES:												
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:				
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:				
												
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.								
FECHA:				FECHA:				FECHA:				
18/2/2022				18/2/2022								





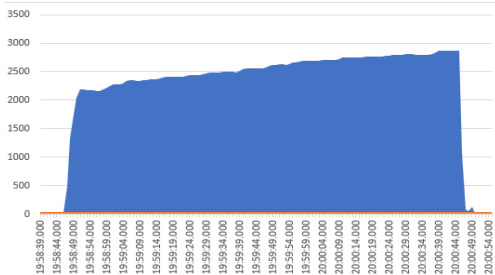


		INFORME TECNICO FINAL						RL-RG-001-02 			
		HOJA		14 DE		24					
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387					
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00									
DESCRIPCION DE PIEZA:											
CODO 2X2"											
EQUIPO		PZ8 131		CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG. (mm)	
PRECINTO		RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292		PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP		250KG/CM - 3500PSI		0	8,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS		SI	NO	3	8,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA		X		6	8,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500P
DESARMADO			X	9	8,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL		X									
CONTROL DIMENSIONAL			X								
MEDICION DE ESPESORES		X									
ENSAMBLADO			X								
LIQUIDOS PENETRANTES			X								
PARTICULAS MAGNETIZABLES			X								
ENGRASE			X								
REEMPAZO DE SELLOS			X								
REEMPLAZO DE PIEZAS			X								
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X									
PINTADO			X	THICKNESS		NOMINAL		ALLOWABLE			
PRECINTADO O ESTAMPADO		X		DIAMET.		mm	in.	mm	in.		
KIT COMPLETO DE REPARACION			X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO			
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
											
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A				N/A			
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A			MARCA:	N/A		
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A			MODELO:	N/A		
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A			N° INTERNO:	N/A		
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A			N° SERIE:	N/A		
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A			VTO:	N/A		
OBSERVACIONES:											
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:			
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:			
											
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:			
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.							
FECHA:				FECHA:				FECHA:			
18/2/2022				18/2/2022							






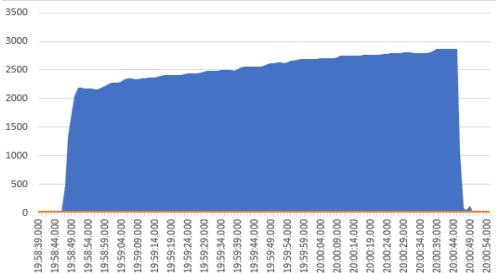


	<h1 style="text-align: center;">INFORME TECNICO FINAL</h1>						RL-RG-001-02						
													
HOJA		15		DE		24							
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387							
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022							
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO							
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES							
NORMA:		N/A											
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00											
DESCRIPCION DE PIEZA:													
LINEA 2X2"													
EQUIPO	PZ8 131			CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG.			
PRECINTO	RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029			PUNTO	A	B	C	D	E	F	(mm)		
TP	250KG/CM - 3500PSI			0	5,6	5,6	5,5	N/A	N/A	N/A	N/A		
TRABAJOS REALIZADOS				SI	NO						PH (PSI)		
LIMPIEZA PREVIA				X		3	5,8	5	5,7	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
DESARMADO					X	6	5,5	5,5	5,3	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500P
INSPECCION VISUAL				X		9	5,8	5,1	5,7	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
CONTROL DIMENSIONAL					X	 							
MEDICION DE ESPESORES				X									
ENSAMBLADO					X								
LIQUIDOS PENETRANTES					X								
PARTICULAS MAGNETIZABLES					X								
ENGRASE					X								
REEMPAZO DE SELLOS					X								
REEMPLAZO DE PIEZAS					X								
PRUEBAS HIDROSTATICAS				X									
PINTADO					X								
PRECINTADO O ESTAMPADO				X		THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE				
KIT COMPLETO DE REPARACION					X	DIAMET.	mm	in.	mm	in.			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
RESULTADO DE INSPECCION						APTO		NO APTO					
						X							
REGISTRO FOTOGRAFICO						GRÁFICO							
													
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A							
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A						
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A						
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A						
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A						
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A						
OBSERVACIONES:													
REALIZO:		APROBO:		RECIBIO:									
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:									
													
NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:									
SANTIN CATERINO, DAMIAN		RODRIGUEZ, ROBERTO A.		DAMIAN PAREDES									
FECHA:		FECHA:		FECHA:									
18/2/2022		18/2/2022		18/2/2022									

<div><div></div><div>OILFIELD SOLUTIONS</div></div>		<div>INFORME TECNICO FINAL</div>				<div>RL-RG-001-02</div> <div><div></div><div>QUINPE</div></div>					
HOJA		16		DE		24					
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387					
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00									
DESCRIPCION DE PIEZA:											
ACOPLE 2X2"											
EQUIPO		PZ8 131		CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)			
PRECINTO		RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029		PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP		250KG/CM - 3500PSI		0	8,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS		SI	NO	3	8,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA		X		6	8,8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500PSI
DESARMADO			X	9	8,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL		X		<div></div> <div></div>							
CONTROL DIMENSIONAL			X								
MEDICION DE ESPESORES		X									
ENSAMBLADO			X								
LIQUIDOS PENETRANTES			X								
PARTICULAS MAGNETIZABLES			X								
ENGRASE			X								
REEMPAZO DE SELLOS			X								
REEMPLAZO DE PIEZAS			X								
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X									
PINTADO			X	THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE				
PRECINTADO O ESTAMPADO		X		DIAMET.	mm	in.	mm	in.			
KIT COMPLETO DE REPARACION			X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO			
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
<div></div>				<div></div>							
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A				N/A			
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A		MARCA:	N/A			
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A		MODELO:	N/A			
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A		N° INTERNO:	N/A			
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A		N° SERIE:	N/A			
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A		VTO:	N/A			
OBSERVACIONES:											
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:			
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:			
<div></div>				<div></div>							
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:			
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.							
FECHA:				FECHA:				FECHA:			
18/2/2022				18/2/2022							




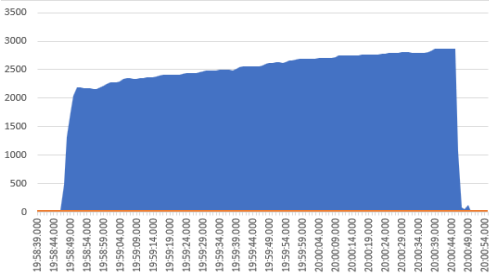


	<h1 style="text-align: center;">INFORME TECNICO FINAL</h1>						RL-RG-001-02				
											
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387		HOJA	17	DE	24
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00									
DESCRIPCION DE PIEZA:											
TEE 2X2"											
EQUIPO	PZ8 131			CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG. (mm)	
PRECINTO	RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029			PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP	250KG/CM - 3500PSI			0	8,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS				SI	NO	PH (PSI)					
LIMPIEZA PREVIA				X		T.P. 50KG/CM - 3500P					
DESARMADO					X	W.P. N/A					
INSPECCION VISUAL				X		 					
CONTROL DIMENSIONAL					X						
MEDICION DE ESPESORES				X							
ENSAMBLADO					X						
LIQUIDOS PENETRANTES					X						
PARTICULAS MAGNETIZABLES					X						
ENGRASE					X						
REEMPAZO DE SELLOS					X						
REEMPLAZO DE PIEZAS					X						
PRUEBAS HIDROSTATICAS				X							
PINTADO				X		THICKNESS		NOMINAL		ALLOWABLE	
PRECINTADO O ESTAMPADO				X		DIAMET.		mm		in.	
KIT COMPLETO DE REPARACION					X	N/A		N/A		N/A	
RESULTADO DE INSPECCION						APTO			NO APTO		
						X					
REGISTRO FOTOGRAFICO						GRÁFICO					
											
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A					
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A				
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A				
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A				
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A				
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A				
OBSERVACIONES:											
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:			
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:			
											
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:			
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.							
FECHA:				FECHA:				FECHA:			
18/2/2022				18/2/2022							




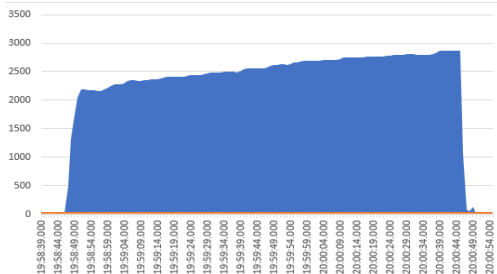

	<h1 style="text-align: center;">INFORME TECNICO FINAL</h1>						RL-RG-001-02					
												
HOJA		18		DE		24						
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387						
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022						
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO						
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES						
NORMA:		N/A										
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00										
DESCRIPCION DE PIEZA:												
CODO 2X2"												
EQUIPO	PZ8 131			CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG.		
PRECINTO	RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029			PUNTO	A	B	C	D	E	F	(mm)	
TP	250KG/CM - 3500PSI			0	17,8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRABAJOS REALIZADOS				SI	NO						PH (PSI)	
LIMPIEZA PREVIA				X		3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DESARMADO					X	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500P
INSPECCION VISUAL				X		9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
CONTROL DIMENSIONAL					X							
MEDICION DE ESPESORES				X								
ENSAMBLADO					X							
LIQUIDOS PENETRANTES					X							
PARTICULAS MAGNETIZABLES					X							
ENGRASE					X							
REEMPAZO DE SELLOS					X							
REEMPLAZO DE PIEZAS					X							
PRUEBAS HIDROSTATICAS				X								
PINTADO				X								
PRECINTADO O ESTAMPADO				X		THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE			
KIT COMPLETO DE REPARACION					X	DIAMET.	mm	in.	mm	in.		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
RESULTADO DE INSPECCION						APTO		NO APTO				
						X						
REGISTRO FOTOGRAFICO						GRÁFICO						
												
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A						
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A					
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A					
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A					
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A					
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A					
OBSERVACIONES:												
REALIZO:				APROBO:		RECIBIO:						
FIRMA:				FIRMA:		FIRMA:						
												
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:						
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.								
FECHA:				FECHA:		FECHA:						
18/2/2022				18/2/2022								

<div><div></div><div>OILFIELD SOLUTIONS</div></div>		<div>INFORME TECNICO FINAL</div>				<div>RL-RG-001-02</div> <div><div></div><div>QUINPE</div></div>					
HOJA		19		DE		24					
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387					
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00											
DESCRIPCION DE PIEZA:											
CODO 2"											
EQUIPO		PZ8 131		CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)			
PRECINTO		RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029		PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP		250KG/CM - 3500PSI		0	15,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS		SI	NO	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA		X		6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500P
DESARMADO			X	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL		X		<div></div>							
CONTROL DIMENSIONAL			X								
MEDICION DE ESPESORES		X									
ENSAMBLADO			X								
LIQUIDOS PENETRANTES			X								
PARTICULAS MAGNETIZABLES			X								
ENGRASE			X								
REEMPAZO DE SELLOS			X								
REEMPLAZO DE PIEZAS			X								
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X		THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE				
PINTADO			X	DIAMET.	mm	in.	mm	in.			
PRECINTADO O ESTAMPADO		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
KIT COMPLETO DE REPARACION			X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO			
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
<div></div>				<div></div>							
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A				N/A			
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A		MARCA:	N/A			
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A		MODELO:	N/A			
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A		N° INTERNO:	N/A			
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A		N° SERIE:	N/A			
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A		VTO:	N/A			
OBSERVACIONES:											
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:			
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:			
<div></div>				<div></div>							
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:			
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.							
FECHA:				FECHA:				FECHA:			
18/2/2022				18/2/2022							

<div><div></div><div>OILFIELD SOLUTIONS</div></div>		<div>INFORME TECNICO FINAL</div>				<div>RL-RG-001-02</div> <div><div></div><div>QUINPE</div></div>					
HOJA		20		DE		24					
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387					
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00									
DESCRIPCION DE PIEZA:											
ACOUPLE 2X2"											
EQUIPO		PZ8 131		CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)			
PRECINTO		RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029		PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP		250KG/CM - 3500PSI		0	5,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJO REALIZADO		SI	NO	3	5,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA		X		6	5,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500PSI
DESARMADO			X	9	5,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL		X		<div></div> <div></div>							
CONTROL DIMENSIONAL			X								
MEDICION DE ESPESORES		X									
ENSAMBLADO			X								
LIQUIDOS PENETRANTES			X								
PARTICULAS MAGNETIZABLES			X								
ENGRASE			X								
REEMPLAZO DE SELLOS			X								
REEMPLAZO DE PIEZAS			X								
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X		THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE				
PINTADO			X	DIAMET.	mm	in.	mm	in.			
PRECINTADO O ESTAMPADO		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
KIT COMPLETO DE REPARACION			X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO			
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
<div></div>				<div></div>							
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A					
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A			MARCA:	N/A		
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A			MODELO:	N/A		
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A			N° INTERNO:	N/A		
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A			N° SERIE:	N/A		
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A			VTO:	N/A		
OBSERVACIONES:											
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:			
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:			
<div></div>				<div></div>							
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:			
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.							
FECHA:				FECHA:				FECHA:			
18/2/2022				18/2/2022							

		INFORME TECNICO FINAL						RL-RG-001-02 			
		HOJA		21 DE		24					
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387					
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00									
DESCRIPCION DE PIEZA:											
ACOPLE 2X2"											
EQUIPO		PZ8 131		CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG. (mm)	
PRECINTO		RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-0292		PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP		250KG/CM - 3500PSI		0	8,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS		SI	NO	3	8,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA		X		6	7,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500P
DESARMADO			X	9	8,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL		X									
CONTROL DIMENSIONAL			X								
MEDICION DE ESPESORES		X									
ENSAMBLADO			X								
LIQUIDOS PENETRANTES			X								
PARTICULAS MAGNETIZABLES			X								
ENGRASE			X								
REEMPAZO DE SELLOS			X								
REEMPLAZO DE PIEZAS			X								
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X									
PINTADO			X	THICKNESS		NOMINAL		ALLOWABLE			
PRECINTADO O ESTAMPADO		X		DIAMET.		mm	in.	mm	in.		
KIT COMPLETO DE REPARACION			X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO			
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
 											
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A					
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A				
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A				
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A				
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A				
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A				
OBSERVACIONES:											
REALIZO:		APROBO:		RECIBIO:							
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:							
											
NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:							
SANTIN CATERINO, DAMIAN		RODRIGUEZ, ROBERTO A.									
FECHA:		FECHA:		FECHA:							
18/2/2022		18/2/2022									

<div><div></div><div>OILFIELD SOLUTIONS</div></div>		<div>INFORME TECNICO FINAL</div>				<div>RL-RG-001-02</div> <div><div></div><div>QUINPE</div></div>					
HOJA		22		DE		24					
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387					
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00											
DESCRIPCION DE PIEZA:											
MANGUEROTE											
EQUIPO		PZ8 131		CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG.			
PRECINTO		RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029		PUNTO	A	B	C	D	E	F	(mm)
TP		250KG/CM - 3500PSI		0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS		SI	NO	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA		X		6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 50KG/CM - 3500P
DESARMADO			X	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL		X		N/A							
CONTROL DIMENSIONAL			X								
MEDICION DE ESPESORES		X									
ENSAMBLADO			X								
LIQUIDOS PENETRANTES			X								
PARTICULAS MAGNETIZABLES			X								
ENGRASE			X								
REEMPAZO DE SELLOS			X								
REEMPLAZO DE PIEZAS			X								
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X									
PINTADO			X	DIAMET.	mm	in.	mm	in.			
PRECINTADO O ESTAMPADO		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
KIT COMPLETO DE REPARACION			X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO			
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
											
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A				N/A			
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A			MARCA:	N/A		
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A			MODELO:	N/A		
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A			N° INTERNO:	N/A		
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A			N° SERIE:	N/A		
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A			VTO:	N/A		
OBSERVACIONES:											
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:			
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:			
											
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:			
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.							
FECHA:				FECHA:				FECHA:			
18/2/2022				18/2/2022							

		<h1>INFORME TECNICO FINAL</h1>						RL-RG-001-02 		
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387				
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022				
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO				
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES				
NORMA:		N/A								
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00								
DESCRIPCION DE PIEZA:										
CHECK VALVE										
EQUIPO	PZ8 131			CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG. (mm)
PRECINTO	RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029			PUNTO	A	B	C	D	E	F
TP	250KG/CM - 3500PSI			0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS				SI	NO					PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA				X						T.P.
DESARMADO					X					W.P.
INSPECCION VISUAL				X						N/A
CONTROL DIMENSIONAL					X					
MEDICION DE ESPESORES				X						
ENSAMBLADO					X					
LIQUIDOS PENETRANTES					X					
PARTICULAS MAGNETIZABLES					X					
ENGRASE					X					
REEMPAZO DE SELLOS					X					
REEMPLAZO DE PIEZAS					X					
PRUEBAS HIDROSTATICAS				X						
PINTADO					X					
PRECINTADO O ESTAMPADO				X						
KIT COMPLETO DE REPARACION					X					
RESULTADO DE INSPECCION					APTO			NO APTO		
					X					
REGISTRO FOTOGRAFICO					GRÁFICO					
										
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A			N/A			
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A			
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A			
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A			
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A			
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A			
OBSERVACIONES:										
REALIZO:			APROBO:			RECIBIO:				
FIRMA:			FIRMA:			FIRMA:				
										
NOMBRE Y APELLIDO:			NOMBRE Y APELLIDO:			NOMBRE Y APELLIDO:				
SANTIN CATERINO, DAMIAN			RODRIGUEZ, ROBERTO A.							
FECHA:			FECHA:			FECHA:				
18/2/2022			18/2/2022							

	<h1 style="text-align: center;">INFORME TECNICO FINAL</h1>						RL-RG-001-02							
														
HOJA		24		DE		24								
N° DE INFORME:		RL-IT-0292		DOC. INGRESO:		387								
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		18/2/2022								
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO								
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES								
NORMA:		N/A												
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00												
DESCRIPCION DE PIEZA:														
VALVULA DE ALIVIO														
EQUIPO		PZ8 131				CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG. (mm)		
PRECINTO		RL 250 KG/CM PZ8 EXP. 02/23 UT-PH RL-IT-029				PUNTO	A	B	C	D	E	F		
TP		200KG- 2900PSI				0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRABAJOS REALIZADOS		SI	NO			3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)	
LIMPIEZA PREVIA		X				6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P.	50KG/CM - 3500P
DESARMADO			X			9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P.	N/A
INSPECCION VISUAL		X				N/A								
CONTROL DIMENSIONAL			X											
MEDICION DE ESPESORES		X												
ENSAMBLADO			X											
LIQUIDOS PENETRANTES			X											
PARTICULAS MAGNETIZABLES			X											
ENGRASE			X											
REEMPAZO DE SELLOS			X											
REEMPLAZO DE PIEZAS			X											
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X												
PINTADO			X			THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE					
PRECINTADO O ESTAMPADO		X				DIAMET.	mm	in.	mm	in.				
KIT COMPLETO DE REPARACION			X			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
RESULTADO DE INSPECCION						APTO			NO APTO					
						X								
REGISTRO FOTOGRAFICO						GRÁFICO								
 														
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A								
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A			
MODELO:	MED. UTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A			
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A			
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A			
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A	VTO:	N/A	VTO:	N/A			
OBSERVACIONES:														
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:						
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:						
														
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:						
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.										
FECHA:				FECHA:				FECHA:						
18/2/2022				18/2/2022										