



# INFORME TECNICO FINAL

**CLIENTE:** QUINPE SRL

**DOC. DE INGRESO:** N/A





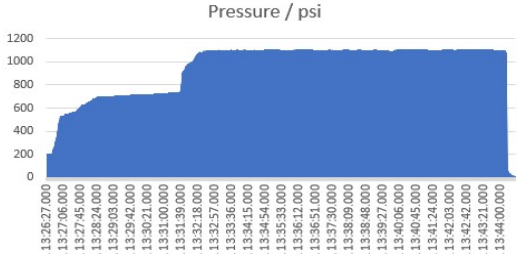


**ID DE EQUIPO:** MOV 224


**N° INFORME:** RL-IT-0210





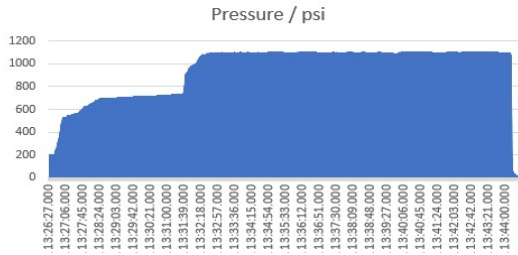


**TIPO DE ENSAYO:** PH UT




**FECHA:** 4/1/2022





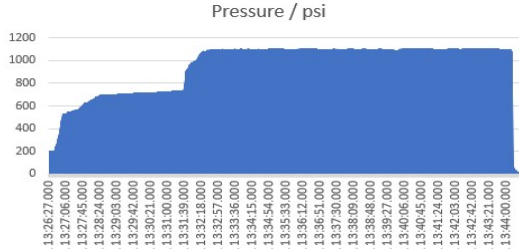


[illegible]

		<b>INFORME TECNICO FINAL</b>				RL-RG-001-02 					
		HOJA		3 DE		12					
N° DE INFORME:		RL-IT-0210		DOC. INGRESO:		IN SITU					
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		4/1/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00									
DESCRIPCION DE PIEZA:											
CODO 2"											
EQUIPO	224			CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)			
PRECINTO	RL 90KG UNI 224 UT-PH 12-21 RL-IT-0210			PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP	80KG /1160 PSI			0	4,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS	SI	NO	3	4,8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA	X		6	4,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 80KG /1160 PSI
DESARMADO		X	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL	X										
CONTROL DIMENSIONAL		X									
MEDICION DE ESPESORES	X										
ENSAMBLADO		X									
LIQUIDOS PENETRANTES		X									
PARTICULAS MAGNETIZABLES											
ENGRASE		X									
REEMPLAZO DE SELLOS		X									
REEMPLAZO DE PIEZAS		X									
PRUEBAS HIDROSTATICAS	X										
PINTADO		X	THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE					
PRECINTADO O ESTAMPADO	X		DIAMET.	mm	in.	mm	in.				
KIT COMPLETO DE REPARACION		X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
RESULTADO DE INSPECCION				APTO		NO APTO					
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
											
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A					
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A				
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A				
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A				
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A				
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A				
OBSERVACIONES:											
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:			
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:			
											
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:			
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.							
FECHA:				FECHA:				FECHA:			
4/1/2022				4/1/2022							





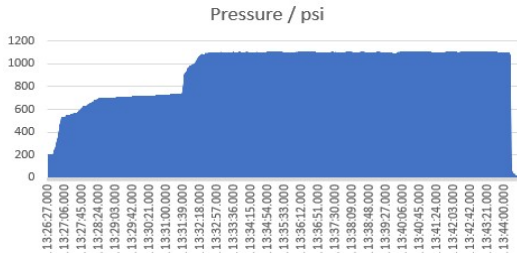


		<b>INFORME TECNICO FINAL</b>				RL-RG-001-02		
								
						HOJA	4 DE 12	
N° DE INFORME:		RL-IT-0210		DOC. INGRESO:		IN SITU		
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		4/1/2022		
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO		
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES		
NORMA:		N/A						
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00								
DESCRIPCION DE PIEZA:								
LINEA 2"								
EQUIPO	224			CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)
PRECINTO	RL 90KG UNI 224 UT-PH 12-21 RL-IT-0210			PUNTO	A	B	C	D
TP	80KG /1160 PSI				E	F		
TRABAJOS REALIZADOS	SI	NO		3	6,1	5,3	4,6	4,4
LIMPIEZA PREVIA	X			6	5,9	5,1	4,4	4,5
DESARMADO		X		9	4,2	4,3	N/A	4,2
INSPECCION VISUAL	X				4,5	4,3		
CONTROL DIMENSIONAL		X			4,2	4,3	N/A	
MEDICION DE ESPESORES	X				4,2	4,3	N/A	
ENSAMBLADO		X			4,4	4,2	N/A	
LIQUIDOS PENETRANTES		X			4,2	4,2	N/A	
PARTICULAS MAGNETIZABLES		X						
ENGRASE		X						
REEMPLAZO DE SELLOS		X						
REEMPLAZO DE PIEZAS		X						
PRUEBAS HIDROSTATICAS	X							
PINTADO		X						
PRECINTADO O ESTAMPADO	X							
KIT COMPLETO DE REPARACION		X						
RESULTADO DE INSPECCION				APTO		NO APTO		
				X				
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO				
								
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A		
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A	
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A	
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A	
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A	
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A	
OBSERVACIONES:								
REALIZO:		APROBO:		RECIBIO:				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:				
								
NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:				
SANTIN CATERINO, DAMIAN		RODRIGUEZ, ROBERTO A.						
FECHA:		FECHA:		FECHA:				
4/1/2022		4/1/2022						

		<b>INFORME TECNICO FINAL</b>				RL-RG-001-02					
											
						HOJA	5 DE 12				
N° DE INFORME:		RL-IT-0210		DOC. INGRESO:		IN SITU					
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		4/1/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00									
DESCRIPCION DE PIEZA:											
TEE 2"											
EQUIPO	224			CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)			
PRECINTO	RL 90KG UNI 224 UT-PH 12-21 RL-IT-0210			PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP	80KG /1160 PSI			0	7,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS				SI	NO	3	7,2	N/A	N/A	N/A	N/A
LIMPIEZA PREVIA				X		6	7,1	N/A	N/A	N/A	N/A
DESARMADO					X	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INSPECCION VISUAL				X							
CONTROL DIMENSIONAL					X						
MEDICION DE ESPESORES				X							
ENSAMBLADO					X						
LIQUIDOS PENETRANTES					X						
PARTICULAS MAGNETIZABLES					X						
ENGRASE					X						
REEMPAZO DE SELLOS					X						
REEMPLAZO DE PIEZAS					X						
PRUEBAS HIDROSTATICAS				X							
PINTADO					X	THICKNESS	NOMINAL	ALLOWABLE			
PRECINTADO O ESTAMPADO				X		DIAMET.	mm	in.	mm	in.	
KIT COMPLETO DE REPARACION					X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
RESULTADO DE INSPECCION						APTO		NO APTO			
						X					
REGISTRO FOTOGRAFICO						GRÁFICO					
											
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A					
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A				
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A				
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A				
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A				
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A				
OBSERVACIONES:											
REALIZO:		APROBO:		RECIBIO:							
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:							
											
NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:							
SANTIN CATERINO, DAMIAN		RODRIGUEZ, ROBERTO A.									
FECHA:		FECHA:		FECHA:							
4/1/2022		4/1/2022									





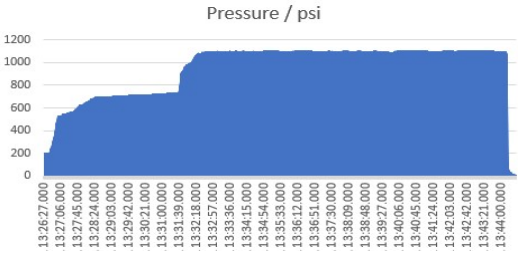


		<b>INFORME TECNICO FINAL</b>				RL-RG-001-02						
												
						HOJA	5 DE 12					
N° DE INFORME:		RL-IT-0210		DOC. INGRESO:		IN SITU						
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		4/1/2022						
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO						
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES						
NORMA:		N/A										
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00												
DESCRIPCION DE PIEZA:												
VALV. RETENCION												
EQUIPO	224			CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)				
PRECINTO	RL 90KG UNI 224 UT-PH 12-21 RL-IT-0210			PUNTO	A	B	C	D	E	F		
TP	80KG /1160 PSI			0	8,6	8,6	8,6	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRABAJOS REALIZADOS				SI	NO	3	8,4	N/A	8,5	N/A	N/A	N/A
LIMPIEZA PREVIA				X		6	8,6	N/A	8,6	N/A	N/A	N/A
DESARMADO					X	9	S/D	N/A	S/D	N/A	N/A	N/A
INSPECCION VISUAL				X								
CONTROL DIMENSIONAL					X							
MEDICION DE ESPESORES				X								
ENSAMBLADO					X							
LIQUIDOS PENETRANTES					X							
PARTICULAS MAGNETIZABLES					X							
ENGRASE					X							
REEMPLAZO DE SELLOS					X							
REEMPLAZO DE PIEZAS					X							
PRUEBAS HIDROSTATICAS				X								
PINTADO					X	THICKNESS		NOMINAL		ALLOWABLE		
PRECINTADO O ESTAMPADO				X		DIAMET.		mm	in.	mm	in.	
KIT COMPLETO DE REPARACION					X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
RESULTADO DE INSPECCION						APTO		NO APTO				
						X						
REGISTRO FOTOGRAFICO						GRÁFICO						
												
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A						
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A					
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A					
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A					
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A					
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A					
OBSERVACIONES:												
REALIZO:		APROBO:		RECIBIO:								
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:								
												
NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:		NOMBRE Y APELLIDO:								
SANTIN CATERINO, DAMIAN		RODRIGUEZ, ROBERTO A.										
FECHA:		FECHA:		FECHA:								
4/1/2022		4/1/2022										




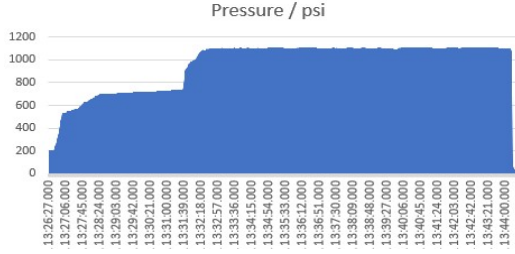


		<b>INFORME TECNICO FINAL</b>				RL-RG-001-02					
											
						HOJA	7 DE 12				
N° DE INFORME:		RL-IT-0210		DOC. INGRESO:		IN SITU					
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		4/1/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00									
DESCRIPCION DE PIEZA:											
LINEA 2"											
EQUIPO	224			CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)			
PRECINTO	RL 90KG UNI 224 UT-PH 12-21 RL-IT-0210			PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP	80KG /1160 PSI			0	4,4	4,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS	SI	NO		3	4,6	4,5	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA	X			6	4,4	4,6	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 80KG /1160 PSI
DESARMADO		X		9	4,6	4,6	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL	X										
CONTROL DIMENSIONAL		X									
MEDICION DE ESPESORES	X										
ENSAMBLADO		X									
LIQUIDOS PENETRANTES		X									
PARTICULAS MAGNETIZABLES		X									
ENGRASE		X									
REEMPAZO DE SELLOS		X									
REEMPLAZO DE PIEZAS		X									
PRUEBAS HIDROSTATICAS	X										
PINTADO		X		THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE				
PRECINTADO O ESTAMPADO	X			DIAMET.	mm	in.	mm	in.			
KIT COMPLETO DE REPARACION		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO			
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
											
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A					
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A				
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A				
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A				
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A				
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A				
OBSERVACIONES:											
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:			
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:			
											
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:			
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.							
FECHA:				FECHA:				FECHA:			
4/1/2022				4/1/2022							




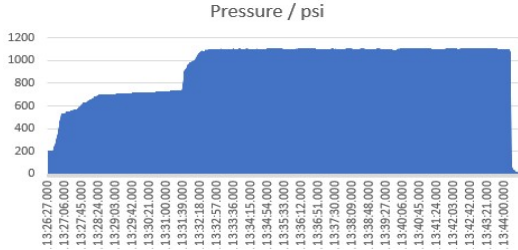







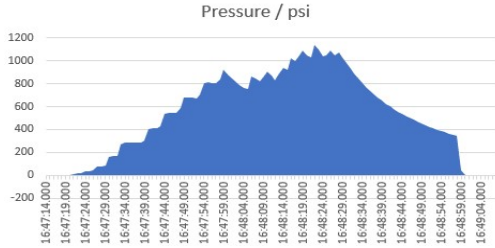


		<b>INFORME TECNICO FINAL</b>				RL-RG-001-02 					
		HOJA		8 DE		12					
N° DE INFORME:		RL-IT-0210		DOC. INGRESO:		IN SITU					
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		4/1/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00									
DESCRIPCION DE PIEZA:											
ACOPLE											
EQUIPO	224			CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)			
PRECINTO	RL 90KG UNI 224 UT-PH 12-21 RL-IT-0210			PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP	80KG /1160 PSI			0	5,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS	SI	NO		3	5,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA	X			6	5,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 80KG /1160 PSI
DESARMADO		X		9	5,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL	X										
CONTROL DIMENSIONAL		X									
MEDICION DE ESPESORES	X										
ENSAMBLADO		X									
LIQUIDOS PENETRANTES		X									
PARTICULAS MAGNETIZABLES		X									
ENGRASE		X									
REEMPLAZO DE SELLOS		X									
REEMPLAZO DE PIEZAS		X									
PRUEBAS HIDROSTATICAS	X										
PINTADO		X		THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE				
PRECINTADO O ESTAMPADO	X			DIAMET.	mm	in.	mm	in.			
KIT COMPLETO DE REPARACION		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
RESULTADO DE INSPECCION				APTO				NO APTO			
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
											
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A					
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A				
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A				
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A				
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A				
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A				
OBSERVACIONES:											
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:			
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:			
											
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:			
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.							
FECHA:				FECHA:				FECHA:			
4/1/2022				4/1/2022							



		<b>INFORME TECNICO FINAL</b>				RL-RG-001-02 						
		HOJA		9 DE		12						
N° DE INFORME:		RL-IT-0210		DOC. INGRESO:		IN SITU						
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		4/1/2022						
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO						
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES						
NORMA:		N/A										
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00												
DESCRIPCION DE PIEZA:												
CODO 2"												
EQUIPO		224		CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)				
PRECINTO		RL 90KG UNI 224 UT-PH 12-21 RL-IT-0210		PUNTO	A	B	C	D	E	F		
TP		80KG /1160 PSI		0	5,8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRABAJOS REALIZADOS				SI	NO	3	5,6	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA				X		6	5,8	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 80KG /1160 PSI
DESARMADO					X	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL				X								
CONTROL DIMENSIONAL					X							
MEDICION DE ESPESORES					X							
ENSAMBLADO					X							
LIQUIDOS PENETRANTES					X							
PARTICULAS MAGNETIZABLES					X							
ENGRASE					X							
REEMPLAZO DE SELLOS					X							
REEMPLAZO DE PIEZAS					X							
PRUEBAS HIDROSTATICAS				X								
PINTADO					X	THICKNESS		NOMINAL		ALLOWABLE		
PRECINTADO O ESTAMPADO				X		DIAMET.		mm	in.	mm	in.	
KIT COMPLETO DE REPARACION					X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
RESULTADO DE INSPECCION						APTO		NO APTO				
						X						
REGISTRO FOTOGRAFICO						GRÁFICO						
												
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A						
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A					
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A					
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A					
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A					
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A					
OBSERVACIONES:												
REALIZO:				APROBO:				RECIBIO:				
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:				
												
NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				NOMBRE Y APELLIDO:				
SANTIN CATERINO, DAMIAN				RODRIGUEZ, ROBERTO A.								
FECHA:				FECHA:				FECHA:				
4/1/2022				4/1/2022								

		<b>INFORME TECNICO FINAL</b>				RL-RG-001-02					
											
						HOJA 10 DE 12					
N° DE INFORME:		RL-IT-0210		DOC. INGRESO:		IN SITU					
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		4/1/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00									
DESCRIPCION DE PIEZA:											
TEE 2"											
EQUIPO	224			CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG. (mm)	
PRECINTO	RL 90KG UNI 224 UT-PH 12-21 RL-IT-0210			PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP	80KG /1160 PSI			0	10,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS				3	10,8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				6	10,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LIMPIEZA PREVIA											
DESARMADO											
INSPECCION VISUAL											
CONTROL DIMENSIONAL											
MEDICION DE ESPESORES											
ENSAMBLADO											
LIQUIDOS PENETRANTES											
PARTICULAS MAGNETIZABLES											
ENGRASE											
REEMPLAZO DE SELLOS											
REEMPLAZO DE PIEZAS											
PRUEBAS HIDROSTATICAS											
PINTADO											
PRECINTADO O ESTAMPADO											
KIT COMPLETO DE REPARACION											
RESULTADO DE INSPECCION				APTO			NO APTO				
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
											
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A					
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:		N/A			
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:		N/A			
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:		N/A			
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:		N/A			
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:		N/A			
OBSERVACIONES:											
REALIZO: FIRMA:  NOMBRE Y APELLIDO: SANTIN CATERINO, DAMIAN FECHA: 4/1/2022				APROBO: FIRMA:  NOMBRE Y APELLIDO: RODRIGUEZ, ROBERTO A. FECHA: 4/1/2022			RECIBIO: FIRMA: NOMBRE Y APELLIDO: FECHA:				

		<b>INFORME TECNICO FINAL</b>				RL-RG-001-02					
				HOJA	11	DE	12				
N° DE INFORME:		RL-IT-0210		DOC. INGRESO:		IN SITU					
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		4/1/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO:		RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00									
DESCRIPCION DE PIEZA:											
MANG. 1-1/2"											
EQUIPO		224		CONTROL DIMENSIONAL (mm)						LONG. (mm)	
PRECINTO		RL 90KG UNI 224 UT-PH 12-21 RL-IT-0210		PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP		80KG /1160 PSI		0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS		SI	NO	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA		X		6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 80KG /1160 PSI
DESARMADO			X	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL		X		N/A							
CONTROL DIMENSIONAL			X								
MEDICION DE ESPESORES			X								
ENSAMBLADO			X								
LIQUIDOS PENETRANTES			X								
PARTICULAS MAGNETIZABLES			X								
ENGRASE			X								
REEMPAZO DE SELLOS			X								
REEMPLAZO DE PIEZAS			X								
PRUEBAS HIDROSTATICAS		X									
PINTADO			X	THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE				
PRECINTADO O ESTAMPADO		X		DIAMET.	mm	in.	mm	in.			
KIT COMPLETO DE REPARACION			X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
RESULTADO DE INSPECCION				APTO			NO APTO				
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
											
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A					
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:		N/A			
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:		N/A			
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:		N/A			
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:		N/A			
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:		N/A			
OBSERVACIONES:											
<b>REALIZO:</b> <b>FIRMA:</b>  <b>NOMBRE Y APELLIDO:</b> SANTIN CATERINO, DAMIAN <b>FECHA:</b> 4/1/2022				<b>APROBO:</b> <b>FIRMA:</b>  <b>NOMBRE Y APELLIDO:</b> RODRIGUEZ, ROBERTO A. <b>FECHA:</b> 4/1/2022				<b>RECIBIO:</b> <b>FIRMA:</b> <b>NOMBRE Y APELLIDO:</b> <b>FECHA:</b>			

		<b>INFORME TECNICO FINAL</b>				RL-RG-001-02 					
		HOJA		12	DE		12				
N° DE INFORME:		RL-IT-0210		DOC. INGRESO:		IN SITU					
CLIENTE:		QUINPE SRL		FECHA DE INGRESO:		4/1/2022					
SECTOR:		N/A		UBICACIÓN:		BASE FERNANDEZ ORO					
RESP. CLIENTE:		BADILLA JORGE		INF. REALIZADO:		DAMIAN PAREDES					
NORMA:		N/A									
PROCEDIMIENTO APLICADO: RL-SER-PO-010.00 / RL-SER-PO-005.00											
DESCRIPCION DE PIEZA:											
VALV. DE ALIVIO											
EQUIPO	224			CONTROL DIMENSIONAL (mm)				LONG. (mm)			
PRECINTO	RL 90KG UNI 224 UT-PH 12-21 RL-IT-0210			PUNTO	A	B	C	D	E	F	
TP	90KG /1305 PSI			0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRABAJOS REALIZADOS	SI	NO		3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PH (PSI)
LIMPIEZA PREVIA	X			6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T.P. 90KG /1305 PSI
DESARMADO		X		9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W.P. N/A
INSPECCION VISUAL	X			N/A							
CONTROL DIMENSIONAL		X									
MEDICION DE ESPESORES		X									
ENSAMBLADO		X									
LIQUIDOS PENETRANTES		X									
PARTICULAS MAGNETIZABLES		X									
ENGRASE		X									
REEMPLAZO DE SELLOS		X									
REEMPLAZO DE PIEZAS		X									
PRUEBAS HIDROSTATICAS	X										
PINTADO		X		THICKNESS	NOMINAL		ALLOWABLE				
PRECINTADO O ESTAMPADO	X			DIAMET.	mm	in.	mm	in.			
KIT COMPLETO DE REPARACION		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
RESULTADO DE INSPECCION				APTO		NO APTO					
				X							
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRÁFICO							
											
EQUIPO UT		MANOMETRO DIGITAL		N/A		N/A					
MARCA:	LOTFANCY	MARCA:	WIKA	MARCA:	N/A	MARCA:	N/A				
MODELO:	MED. ULTRASONIC	MODELO:	CPG1500	MODELO:	N/A	MODELO:	N/A				
N° INTERNO:	UT-RL-01	N° INTERNO:	MAN-RL-08	N° INTERNO:	N/A	N° INTERNO:	N/A				
N° SERIE:	JJ:2298471	N° SERIE:	1A0112P791K	N° SERIE:	N/A	N° SERIE:	N/A				
VTO:	19/11/2022	VTO:	19/4/2022	VTO:	N/A	VTO:	N/A				
OBSERVACIONES:											
REALIZO: FIRMA:  NOMBRE Y APELLIDO: SANTIN CATERINO, DAMIAN FECHA: 4/1/2022				APROBO: FIRMA:  NOMBRE Y APELLIDO: RODRIGUEZ, ROBERTO A. FECHA: 4/1/2022			RECIBIO: FIRMA: NOMBRE Y APELLIDO: FECHA:				