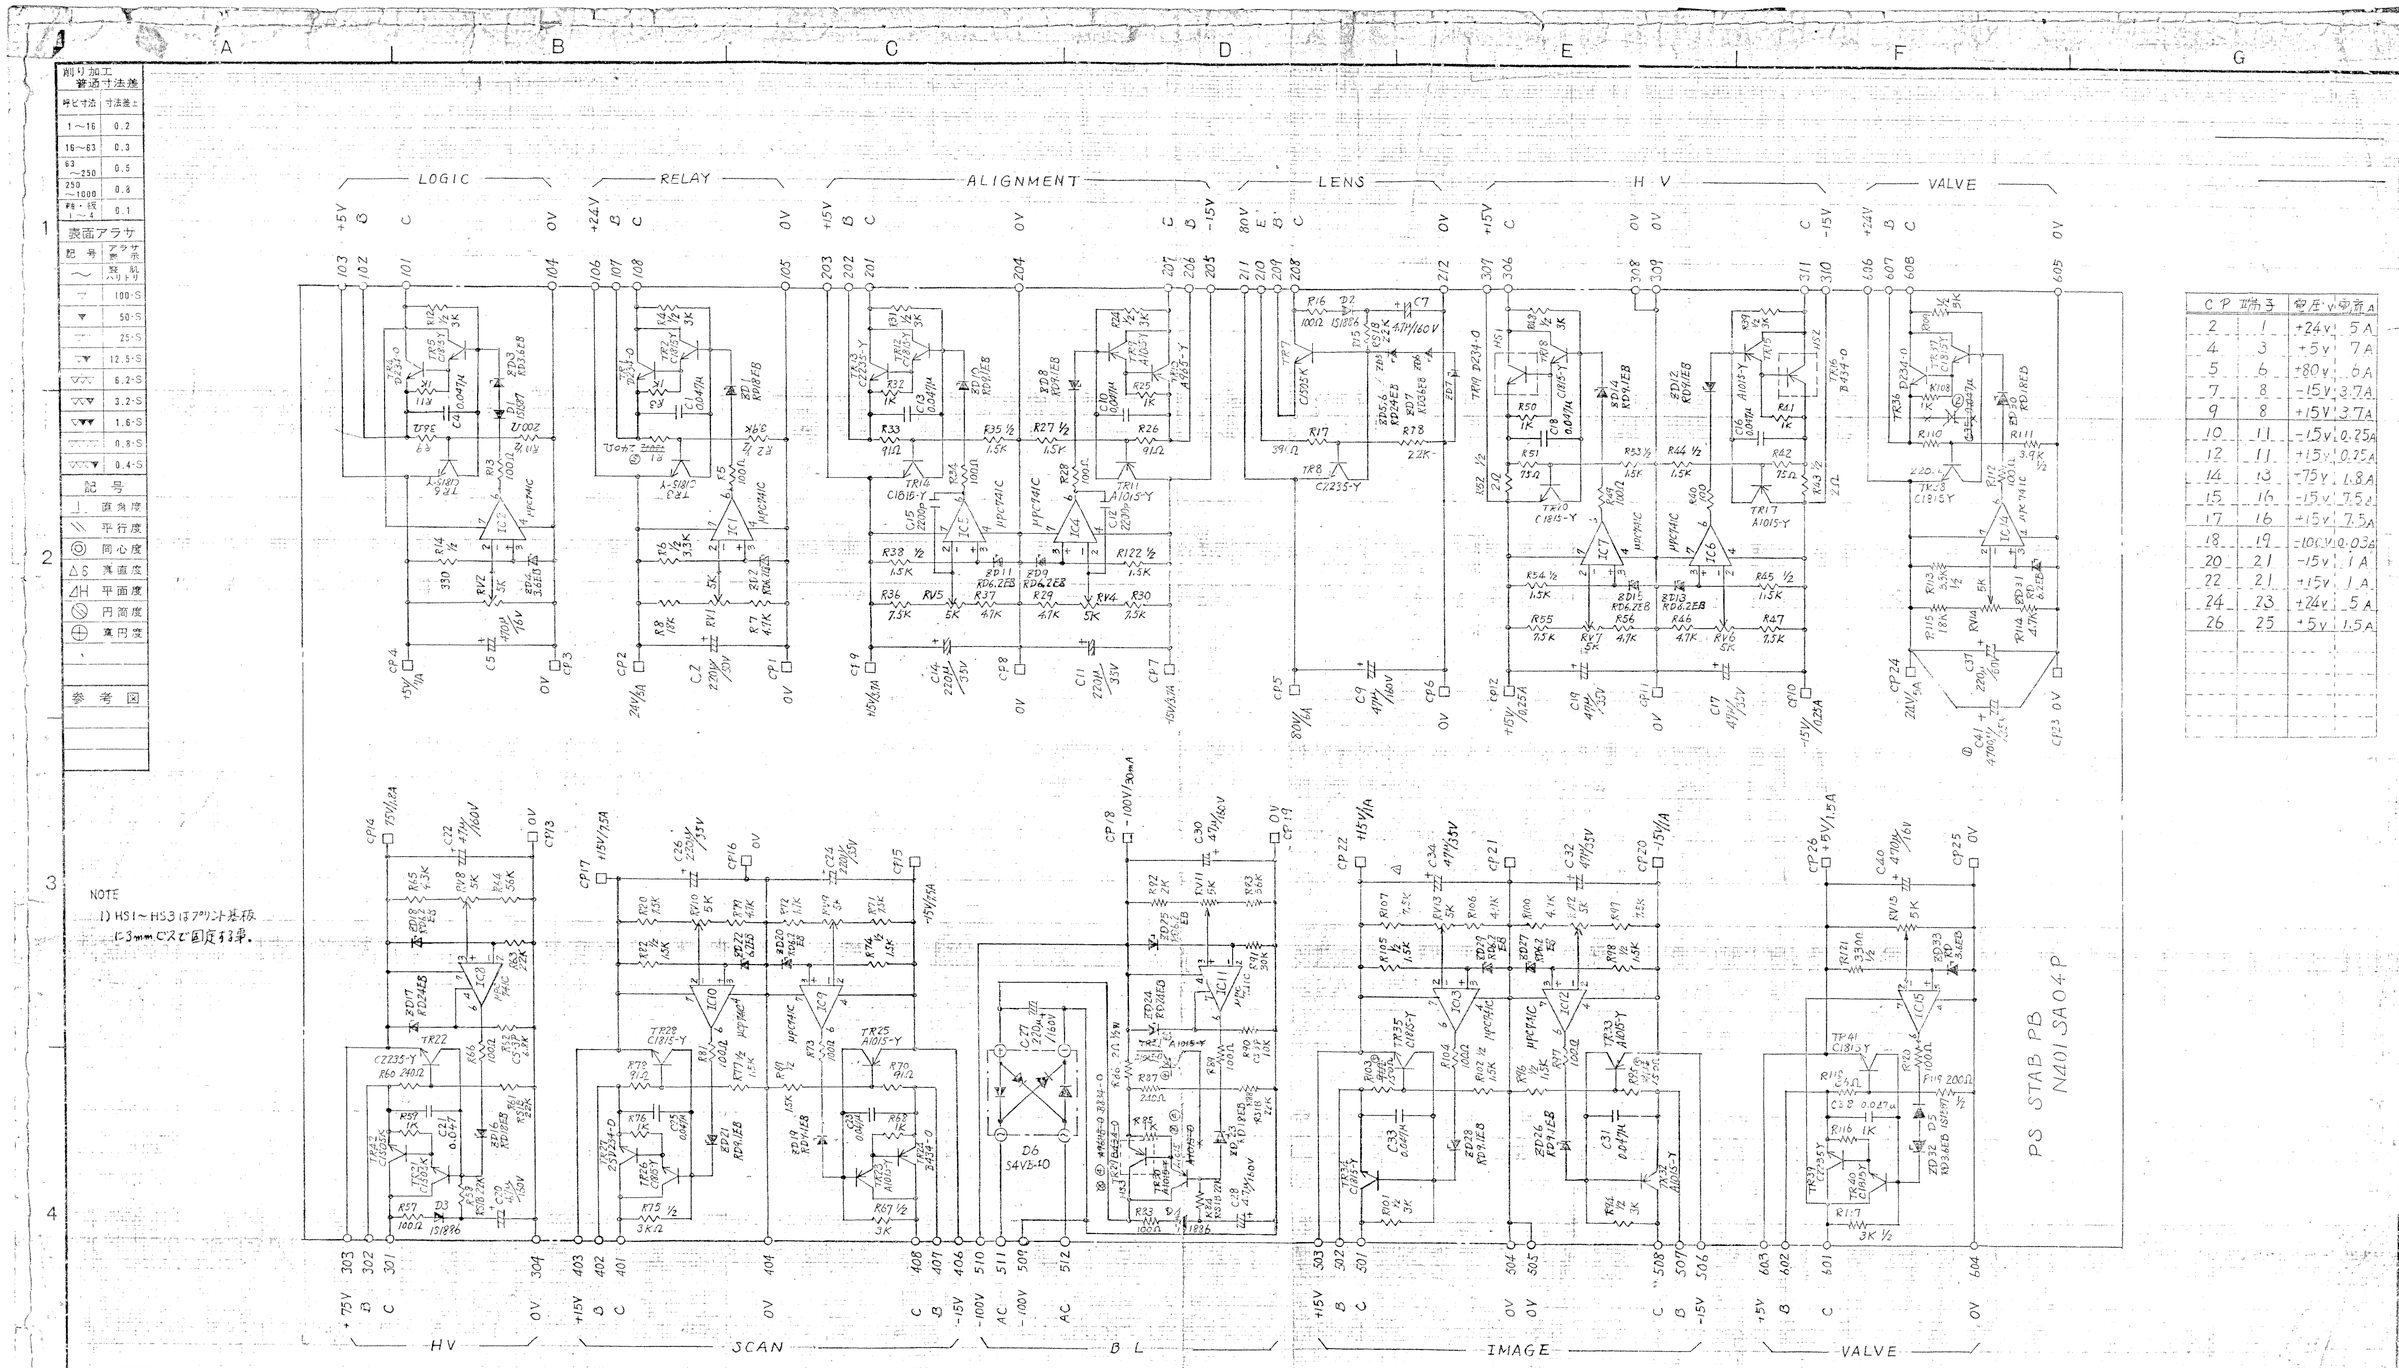

CP	端子	電圧V	電流A
2	1	+24V	5A
4	3	+5V	7A
5	6	+80V	6A
7	8	-15V	3.7A
9	8	+15V	3.7A
10	11	-15V	0.25A
12	11	+15V	0.25A
14	13	-75V	1.8A
15	16	-15V	7.5A
17	16	+15V	7.5A
18	19	-100V	0.03A
20	21	-15V	1A
22	21	+15V	1A
24	23	+24V	5A
26	25	+5V	1.5A

訂正理由	氏名	日付	番号
リミッター設定変更	オオツカ	61.3.27	⑥
TR29,30追加 TR31削除	コダマ	60.5.21	⑤
TRの変更 K54152～ SCB基板	コダマ	59.12.28	④
C33削除 発振対策	コダマ	59.6.19	③
C41追加 発振対策	コダマ	59.4.3	②

工番		個数
工程		
加工先		
予定		
材料寸法		

熱処理	
塗装	IC15 D6 C40 ZD38
表面処理	TR42 RV15 CP26 R122
鍍金	

材質	
重量	尺度
検図 設計 作図	

機種	SEM-401
名称	結線図
図番	N401SA04
昭和54年6月20日	明石製作所

N401SA02 G