

P/A 4-6-19；二级反应器上清液入库
A/2026/05/22 0830

铂金生物科技（北京）有限公司
PLATINUM LIFE EXCELLENCE BIOTECH

细胞培养上清液入库申请单

文件类型	原件	文件编码：REC-YZ-SMP-QA-04-027		受控文件
入库细胞培养上清液名称：	☐	PO 代细胞培养上清液	☐	P1 代细胞培养上清液
	☐	一级生物反应器上清液	☒	二级生物反应器上清液
	☐	三级生物反应器上清液		
	其它：_____			
细胞产品批号	A?2?2026?0520			
无菌培养基产品	☒	牛血清	☐	其它：_____
预灌装数量				
申请人	赵林	申请日期	2026.05.22	
复核人	范梅	批准日期	2026.05.22	
接收人	入库日期			
入库保存位置	4 号箱?			
备注：				

第 1 页共 1 页
盖梅? 2026.05.22

细胞培养上清液出库申请单

文件类型	原件	文件编码：REC-YZ-SMP-QA-04-027		受控文件
出库细胞培养上清液名称：	☐	PO 代细胞培养上清液	☐	P1 代细胞培养上清液
	☐	一级生物反应器上清液	☒	二级生物反应器上清液
	☐	三级生物反应器上清液		
	其它：_____			
细胞产品批号	A?2?2026?0520	出库细胞培养上清液数量	约 36 瓶	
出库用途	C.C. 试验（生产）	申请日期	2026.05.22	
申请人	赵林	批准日期	2026.05.22	
部门经理	桔梅?	批准日期		
总经理	/	批准日期	/	
出库人	夏丹?	出库日期	2026.05.22	
接收人	严莉?	接收日期	2026.05.22	
备注：	<			

注释：公司的内部生产使用细胞培养上清液时无需经理签字，委外使用细胞培养上清液时需总经理签字。

赵梅? 2026.05.22

桔梅? 2026.05.22

盖梅? 2026.05.22

住院患者用药记录

基本信息

姓名	文字过小，无法可靠辨认	性别	文字过小，无法可靠辨认
年龄	文字过小，无法可靠辨认	科室	文字过小，无法可靠辨认
床号	文字过小，无法可靠辨认	住院号	文字过小，无法可靠辨认
入院日期	文字过小，无法可靠辨认	记录日期	2024-05-22

医嘱及执行记录

时间	医嘱内容	剂量/规格	执行情况
07:20	药品名称无法可靠辨认		
07:40	药品名称无法可靠辨认		
07:50	药品名称无法可靠辨认		
08:20	药品名称无法可靠辨认		
08:40	药品名称无法可靠辨认		
08:50	药品名称无法可靠辨认		
09:00	药品名称无法可靠辨认		
09:10	药品名称无法可靠辨认		
09:20	药品名称无法可靠辨认		
09:30	药品名称无法可靠辨认		
09:40	药品名称无法可靠辨认		
09:50	药品名称无法可靠辨认		
10:00	药品名称无法可靠辨认		
10:10	药品名称无法可靠辨认		
10:20	药品名称无法可靠辨认		
10:30	药品名称无法可靠辨认		
10:40	药品名称无法可靠辨认		
10:50	药品名称无法可靠辨认		
11:00	药品名称无法可靠辨认		
11:10	药品名称无法可靠辨认		
11:20	药品名称无法可靠辨认		
11:30	药品名称无法可靠辨认		
11:40	药品名称无法可靠辨认		
11:50	药品名称无法可靠辨认		
12:00	药品名称无法可靠辨认		
12:10	药品名称无法可靠辨认		
12:20	药品名称无法可靠辨认		
12:30	药品名称无法可靠辨认		
12:40	药品名称无法可靠辨认		
12:50	药品名称无法可靠辨认		
13:00	药品名称无法可靠辨认		
13:10	药品名称无法可靠辨认		
13:20	药品名称无法可靠辨认		
13:30	药品名称无法可靠辨认		
13:40	药品名称无法可靠辨认		
13:50	药品名称无法可靠辨认		
14:00	药品名称无法可靠辨认		
14:10	药品名称无法可靠辨认		
14:20	药品名称无法可靠辨认		
14:30	药品名称无法可靠辨认		
14:40	药品名称无法可靠辨认		
14:50	药品名称无法可靠辨认		

阿片类药物使用情况记录
1120.00
500.5
1/

Visible inventory/list table; text illegible at supplied resolution

[illegible]

Second visible inventory/list table; text illegible at supplied resolution

[illegible]

Upper list *[printed identifiers and descriptions illegible at supplied resolution]*

[additional printed rows visible; transcription requires a higher-resolution source]

Lower list *[printed identifiers and descriptions illegible at supplied resolution]*

[additional printed rows visible; transcription requires a higher-resolution source]

4/7

[illegible][illegible]

签名：[难以辨认]

日期：2025 年? 月 22 日

Graph panel (upper left)



Visible axes include time labels approximately 09:48:41,
11:18:41, and 13:18:41.
The vertical axis is labeled in millivolts;
multiple colored traces and a legend are visible.

Graph panel (upper right)

Visible axes include time labels approximately 09:48:41,
11:18:41, and 13:18:41.
The vertical axis is labeled in millivolts;
several colored traces and a legend are visible.

Graph panel (lower)

Visible vertical scale markings are 0, 96, 192, 288, 384, and 480.
The horizontal axis shows time labels approximately 09:48:41,
11:18:41, and 13:18:41.
An orange trace and legend are visible.

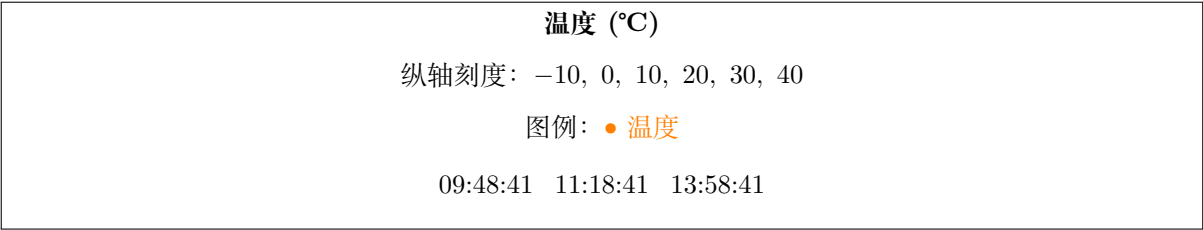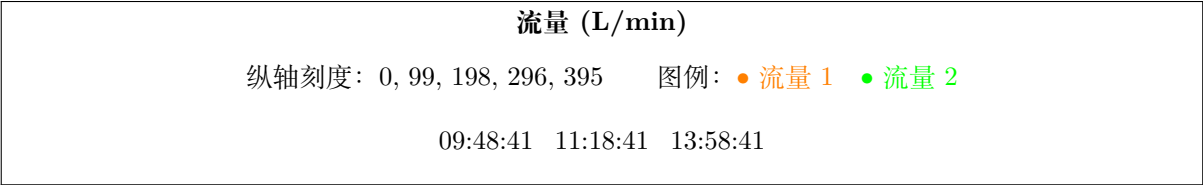

Visible multi-series pressure chart

Pressure axis labeled “压力 (kPa)”, with four plotted series (“压力 1”, “压力 2”, “压力 3”, and “压力 4”).

子样? 1:
交接.....
.....

计数样本交接表

品名	蛇毒抗体复合物	规格	1.5 ml/0.5 ml?
生产批号	2026.....	生产工序	2 级.....
样品编码	26b0-AP2720-260409-PI-浸 润-640 pmL		
样品类型	☐ EP 管，_____ 管，每管 ≤ 0.3 ml		
	☒ 血样，_____ 支，每支 ≥ 0.3 ml		
送样时间	2026 年 09 月 22 日 08 时 02 分		
样本送交人/日期	张楠 2026.09.22	复核人/日期	赵敏 2026.05.22
样本接收人/日期	张楠 2026.05.22		
样本计数结果	活细胞密度	110 ×10 ⁷ cells/ml	
	细胞活率	97.3%	
计数人/日期	张楠 2026.05.22	递交/复核人/日期	赵楠 2026.05.22

细胞计数记录

AO/PI 染液批号：2026.05.22-001	细胞计数仪编号：11700?		
细胞计数仪内部编号	活细胞密度 (cells/ml)	细胞活率	活细胞直径 (μm)
2026-05-22-260409-PI-浸 润-640 pmL-1-1	1.03×10 ⁷	97.9%	14.2
2026-05-22-260409-PI-浸 润-640 pmL-1-2-1	1.19×10 ⁷	97.1%	13.6
2026-05-22-260409-PI-浸 润-640 pmL-1-3-1	1.08×10 ⁷	96.8%	13.6
	×10 ⁷	%	
	×10 ⁷	%	
	×10 ⁷	%	
样本计数复写值		活细胞密度	1.6×10 ⁷ cells/ml
		细胞活率	97.3%
如需增加计数数据，可增加附件。			

计数人/日期：张楠 2026.05.22

复核人/日期：张楠 2026.05.22

05/22/2026 12:08:51

Assay: MSC

Cell Type F1: MSC (A0)

Cell Type F2: MSC (P1)


Sample ID: 260522-A37?220?2605030-P5-jie?hong-604.00m-1-1-1

Dilution: 2.00

Results:

Count	Concentration	Mean Diameter
Total: 2929	1.05×10^7 cells/mL	14.1 micron
Live: 2909	1.03×10^7 cells/mL	14.2 micron
Dead: 63	2.21×10^5 cells/mL	12.2 micron


Viability: 97.9%




Assay: MSC
05/22/2026 11:12:42
Cell Type F1: MSC (A0)
Cell Type F2: MSC (PI)
Sample ID: 260522-A37220120260530-P5-jiezhong-604_00n1-1-2-1
Dilution: 2.00

Results:


Count	Concentration	Mean Diameter
=====	=====	
Total: 3493	1.23×10^7 cells/mL	13.6 micron
Live: 3390	1.19×10^7 cells/mL	13.6 micron
Dead: 103	3.62×10^5 cells/mL	12.8 micron
Viability: 97.1%		




Microscopy image



Microscopy image



Microscopy image



Microscopy image

操作人: 邱小舟

日期: 2026.05.22

复核人: 张小帅

日期: 2026.05.22

Assay: MSC05/22/2026 12:14:47

Cell Type F1: MSC (A0)

Cell Type F2: MSC (P1)



Sample ID: 260522-A372201202605030-P5-jiezhong-604.00ml-1-3-1

Dilution: 2.00

Results:

	Count	Concentration	Mean Diameter
Total: 3181	1.12×10^7 cells/mL	13.6 micron	
Live: 3078	1.08×10^7 cells/mL	13.6 microns	
Dead: 103	3.62×10^5 cells/mL	13.0 micron	

Viability: 96.8%

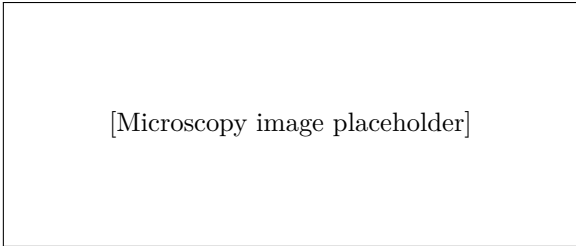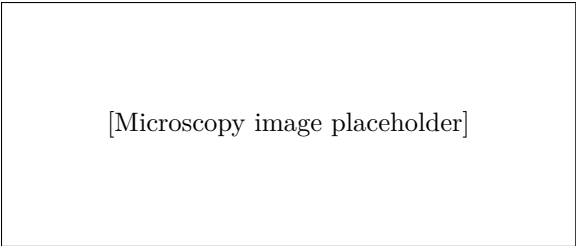

操作人：[illegible signature]日期：2026.05.22

复核人：[illegible signature]日期：2026.05.22

Visible chromatogram with multiple overlaid traces, axes, and instrument controls.
[Figure placeholder]

[illegible blue handwritten annotation]
[illegible blue handwritten annotation]
[illegible blue handwritten annotation]
[illegible blue handwritten annotation]
//

Visible control-panel selections

Option 1	☐	Option 2	☐
Option 3	☐	Option 4	☐
Option 5	☐	Option 6	☐
Option 7	☐	Option 8	☐
Option 9	☐	Option 10	☐
Option 11	☐	Option 12	☐
Option 13	☐	Option 14	☐
Option 15	☐	Option 16	☐
Option 17	☐	Option 18	☐
Option 19	☐	Option 20	☐
Option 21	☐	Option 22	☐
Option 23	☐	Option 24	☐
Option 25	☐	Option 26	☐
Option 27	☐	Option 28	☐
Option 29	☐	Option 30	☐
Option 31	☐	Option 32	☐
Option 33	☐	Option 34	☐
Option 35	☐	Option 36	☐

Printed field values

Date/year	2026
Identifier	F5
Sample or file number	[illegible alphanumeric value]

附件 1：乙肝病毒载量检测报告

肝功能检测报告

Date: 2026/05/21
Time: 14:07:51
EP, Value, Unit, Temp
AE 7.42 pH 23.7°C ATC
结果日期：7 月 05.21

乙肝病毒载量检测报告

2026-05-23 12:02:53
样本号： 3122?260?
检测结果： 8.88 mmol/L
浓度： 7.13 mmol/L
复核

BSZY 不清晰

附图 1：实验检测记录（文字部分较小，个别内容难以辨认）

A?202?010605030 三角测量
Date: 2025/05/21
Time: 14:07:51
EP,Value,Unit,Temp
RE 7.42pH 23.7°C ATC

中文批注
2025.05.21

A? 检测记录（部分文字难以辨认）
2025-05-23 12:02:53
样本号: 372238030502
样本名称: (难以辨认)
检测项目: 钙?
结果: 8.81 mmol/L
乳酸: 7.13 mmol/L
BSZY 中文签名

中文批注

附件 4: ... (请验单中...)

请验单

文档编码: REC-ZY-SMP-QC-01-001-03

版本号: 2.0

样品名称	三甲胺...	样品代码	2Y0403
样品编号	M...	样品规格/数量	2.0...?
样品类别	☒ 生产过程检验产品 ☐ 待包装产品 ☐ 成品 ☐ 其他 ()		
检验类型	☒ 初检 ☐ 复验 ☐ 退货 ☐ 稳定性 ☐ 留样		
请验目的	☒ 自检 ☐ 其他(制剂...))		
请验部门	☒ 生产部 ☐ 物料管理部 ☐ 其他 ()		
样品情况	☒ 随请验单一起提供 ☐ 未随请验单一起提供		
请验人	许...	请验日期	2026.05.26
收货人	丁...	收货日期	2026.05.27
备注	66 h / 89.1 kg		

采样...

请验单

样品名称	三...		样品代码	G?0?0b
样品批号	A?3>...		样品规格/数量	约 20mL 及若干克
样品类别	☒	生产过程中检验样品		☐ 包装产品
	☐	成品		☐ 其他 ()
检验类型	☐	初验		☐ 复验
	☐	退货		☐ 稳定性
	☒	留样		
请验项目	☐	全检		☒ 留样
	☐	其他 ()		
请验部门	☒	生产部		☐ 物料管理部
	☐	其他 ()		
样品情况	☒	随请验单一起提供		☐ 未随请验单一起提供
请验人	张...		请验日期	2025.03.25
收验人	陈...		收验日期	2025.05.25
备注	70?4			

... 2025.05.25

... 2025.05.25

请验单

样品名称	三...		样品代码	G?0?0b
样品批号	A?3>...		样品规格/数量	约 20mL 及若干克
样品类别	☒	生产过程中检验样品		☐ 包装产品
	☐	成品		☐ 其他 ()
检验类型	☒	初验		☐ 复验
	☐	退货		☐ 稳定性
	☐	留样		
请验项目	☐	全检		☐ 留样
	☒	其他 (委托...)		
请验部门	☒	生产部		☐ 物料管理部
	☐	其他 ()		
样品情况	☒	随请验单一起提供		☐ 未随请验单一起提供
请验人	张...		请验日期	2025.03.25
收验人	陈...		收验日期	2025.05.25
备注	70?4			

手写签注

P?1 2025.05.10

请验单

RP-PD-2026-02737

文件编号：REC-YZ-SMP-QC-01-001-03 版本号：2.0

样品名称	三氯... 玻璃...	样品代码	Gly0b
样品批号	A?22?0?b?0...	样品规格/数量	30ml/瓶...
样品类别	生产过程检验 ☒	待包装产品 ☐	成品 ☐
	其他 (☐)		
检验类型	初验 ☒ 复验 ☐ 退货 ☐	稳定性 ☐ 回样 ☐	
		☐	
请验目的	留样 ☐ 回收 ☐ 其他 (☒ 细胞培养...)		
请验部门	生产部 ☒ 物料管理部 ☐	其 他 (☐)	
样品情况	随请验单一起提供 ☒	未随请验单一起提供 ☐	
请验人	汪? 强	请验日期	2026.05.25
收验人	高? 鹏	收验日期	2026.05.25
备注	70.7h; 检验结果: PD 00?04?		

...

文件编号：REC-YZ-SOP-QC-99-006-02 版本号：2.0

生物反应器细胞液检测通知单

名称	生物反应器细胞液	批号	A?202?06?03?
取样时间	2026 年 07 月 14 日	报告时间	2026 年 07 月 1? 日
内 容			
检测类别	检测项目	检测方法	检测结果
【细胞活性】	细胞密度	AO/PI 染色	6.94×10^6 个细胞/ml
	细胞活率	AO/PI 染色	97%
	反应罐细胞总数	AO/PI 染色	4.37×10^7 个细胞/罐
备注	6h 48.9kg		

报告人：李海丽

复核人：柳玲

日 期：2026.05.05

日 期：2026.07.07

生物反应器细胞浓度检测通知单

文档编号：REC-YZ-SOP-99-006-02 版本号：2.0

RP-QC-2026-02767

名称	生物反应器细胞浓度	批号	A3?3?-?4?
取样时间	2026 年 2 月 17 日	报告时间	2026 年 02 月 17 日
内容			
检测类别	检测项目	检测方法	检测结果
【细胞活性】	细胞密度	AO/PI 染色	8.73×10^5 个细胞/ml
	细胞活率	AO/PI 染色	98 %
	反应细胞总数	AO/PI 染色	4.27×10^7 个细胞/皿
备注	6h 细胞?		

报告人：邓? 森

复核人：杨钟静

日 期：2026.02.24

日 期：2026.05.25

样品：细胞库入库液申请单相关备注

1 细胞培养上清液入库申请单

文件编号：REC-YZ-SMP-QA-04-007

入库细胞培养上清液名称	P0 代细胞培养上清液	☐	P1 代细胞培养上清液	☐	P2 代细胞培养上清液	☐
	一级生物反应器上清液	☐	二级生物反应器上清液	☐	三级生物反应器上清液	☒
	其它： ☐					
细胞培养液批号	A?3?0-?0?0					
无血清培养基	☒ 其它： ☐					
报装数量	10?					
申请人	申请人签名					
复核人	复核人签名					
接收人	接收人签名					
备注	—					

净重	ml/kg
申请日期	2024.05.27
批准日期	2024.05.27
入库日期	2024.05.25

申请单相关备注

2 细胞培养上清液出库申请单

文件编号：REC-YZ-SMP-QA-04-007

出库细胞培养上清液名称	P0 代细胞培养上清液	☐	P1 代细胞培养上清液	☐	P2 代细胞培养上清液	☐
	一级生物反应器上清液	☐	二级生物反应器上清液	☐	三级生物反应器上清液	☒
	其它： ☐					
细胞库批号	A?3?0-?0?0					
出库用途	细胞培养液相关实验用途					
申请人	刘?					
部门经理	林芳					
总经理	—					
出库人	刘?					
接收人	刘?					
备注	—					

出库细胞培养上清液数量	50?
申请日期	2024.05.25
批准日期	2024.05.25
出库日期	2024.06.25
接收日期	2024.06.25

注释：公司内部库使用细胞培养上清液时无需总经理签字，委外使用细胞培养上清液时需总经理签字。
2024.06.25

工艺记录

工艺编号	2026-05-29-04-09	工序号	C002
日期	2020-05-29 04:09	版本	V18.0
工件号	20200529-04-09	批次号	20200529
生产单位	[字迹不清]	操作者	[字迹不清]

序号	时间	工序内容	工艺参数、检验结果
1	08:00	准备工作	[字迹不清]
2	09:00	材料检查	[字迹不清]
3	09:00	装配、连接	[字迹不清]
4	09:00	外观检查	[字迹不清]
5	09:00	尺寸检查	[字迹不清]
6	10:00	性能检查	[字迹不清]
7	10:00	记录确认	[字迹不清]
8	12:00	最终检查	[字迹不清]

测量记录：

项目	记录值	单位或备注
测量项目 1	54.43	mL
测量项目 2	10.0	mL
测量项目 3	[字迹不清]	mL

手写补充记录：

7/24/??
202?
16?
1/24

(中文编号及品名清单，逐项内容待核对)

(中文编号及品名清单，逐项内容待核对)

Printed list of entries (left column).

Printed list of entries (right column).


编号	项目内容
13-15-54	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-46	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-44	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-43	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-42	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-41	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-40	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-39	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-38	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-37	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-36	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-35	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-34	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-33	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-32	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-31	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-30	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-29	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-28	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-27	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-26	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-25	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-24	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-23	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-22	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-21	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-20	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-19	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-18	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-17	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-16	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-15	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-14	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-13	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
13-15-12	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/


编号	项目内容
14-15-58	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-57	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-56	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-55	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-54	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-53	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-52	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-51	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-50	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-49	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-48	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-47	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-46	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-45	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-44	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-43	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-42	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-41	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-40	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-39	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-38	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-37	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-36	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-35	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-34	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-33	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-32	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-31	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-30	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-29	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-28	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-27	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-26	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/
14-15-25	/中文项目内容过小，无法可靠辨识/


14.2.4.22	中文项目文字（待核对）
14.2.4.21	中文项目文字（待核对）
14.2.4.20	中文项目文字（待核对）
14.2.4.11	中文项目文字（待核对）
14.2.4.15	中文项目文字（待核对）
14.2.4.06	中文项目文字（待核对）
14.2.4.10	中文项目文字（待核对）
14.2.4.09	中文项目文字（待核对）
14.2.4.08	中文项目文字（待核对）
14.2.4.07	中文项目文字（待核对）
14.2.4.03	中文项目文字（待核对）
14.2.4.04	中文项目文字（待核对）
14.2.4.02	中文项目文字（待核对）
14.2.4.01	中文项目文字（待核对）
14.2.4.00	中文项目文字（待核对）
14.2.4.24	中文项目文字（待核对）
14.2.4.20	中文项目文字（待核对）
14.2.4.19	中文项目文字（待核对）
14.2.4.18	中文项目文字（待核对）
14.2.4.17	中文项目文字（待核对）
14.2.4.16	中文项目文字（待核对）
14.2.4.15	中文项目文字（待核对）
14.2.4.14	中文项目文字（待核对）
14.2.4.13	中文项目文字（待核对）
14.2.4.12	中文项目文字（待核对）
15.0.0.01	中文项目文字（待核对）
15.0.0.02	中文项目文字（待核对）
15.0.0.03	中文项目文字（待核对）
15.0.0.04	中文项目文字（待核对）
15.0.0.05	中文项目文字（待核对）
15.0.0.06	中文项目文字（待核对）



审核：[姓名不清] 日期：2025.7.18?

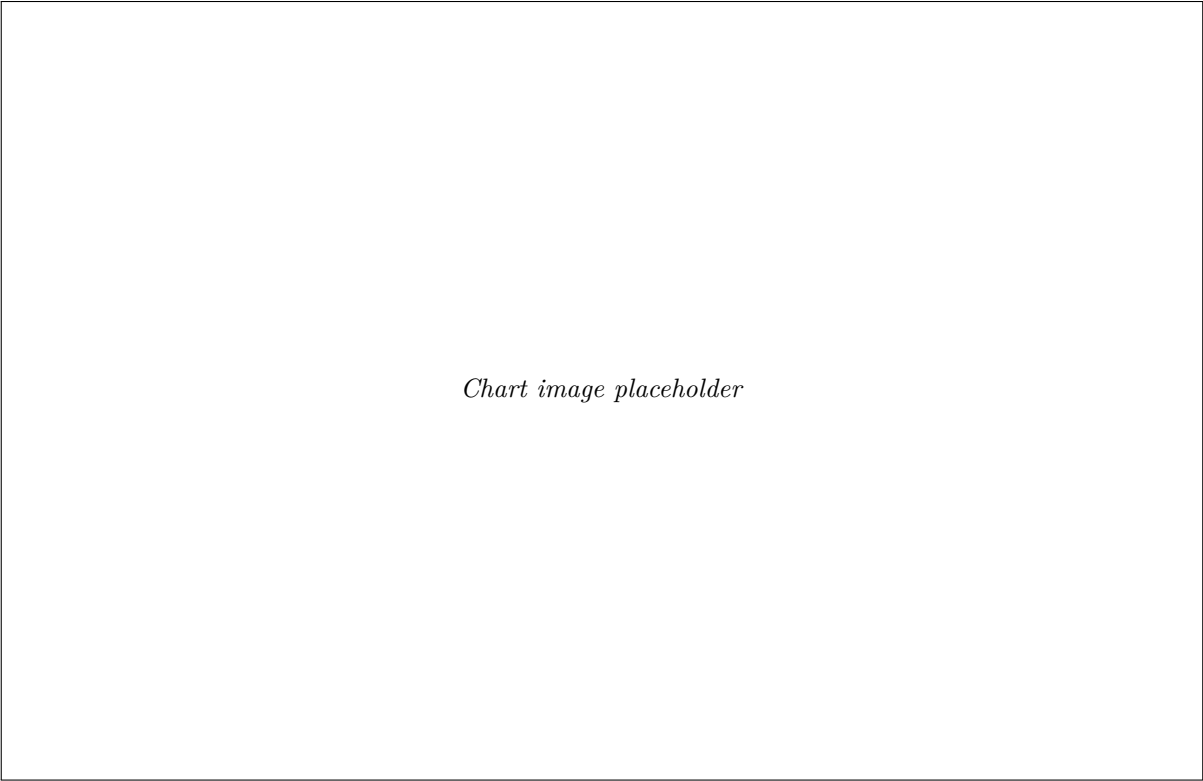

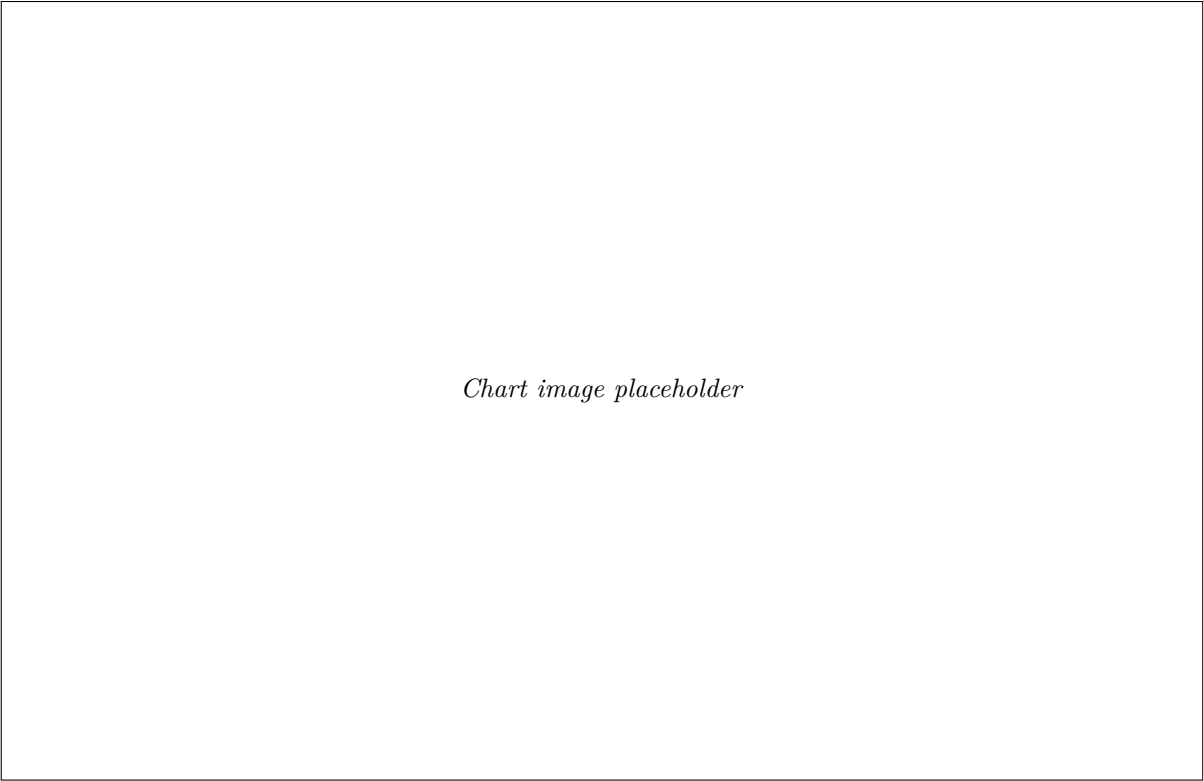

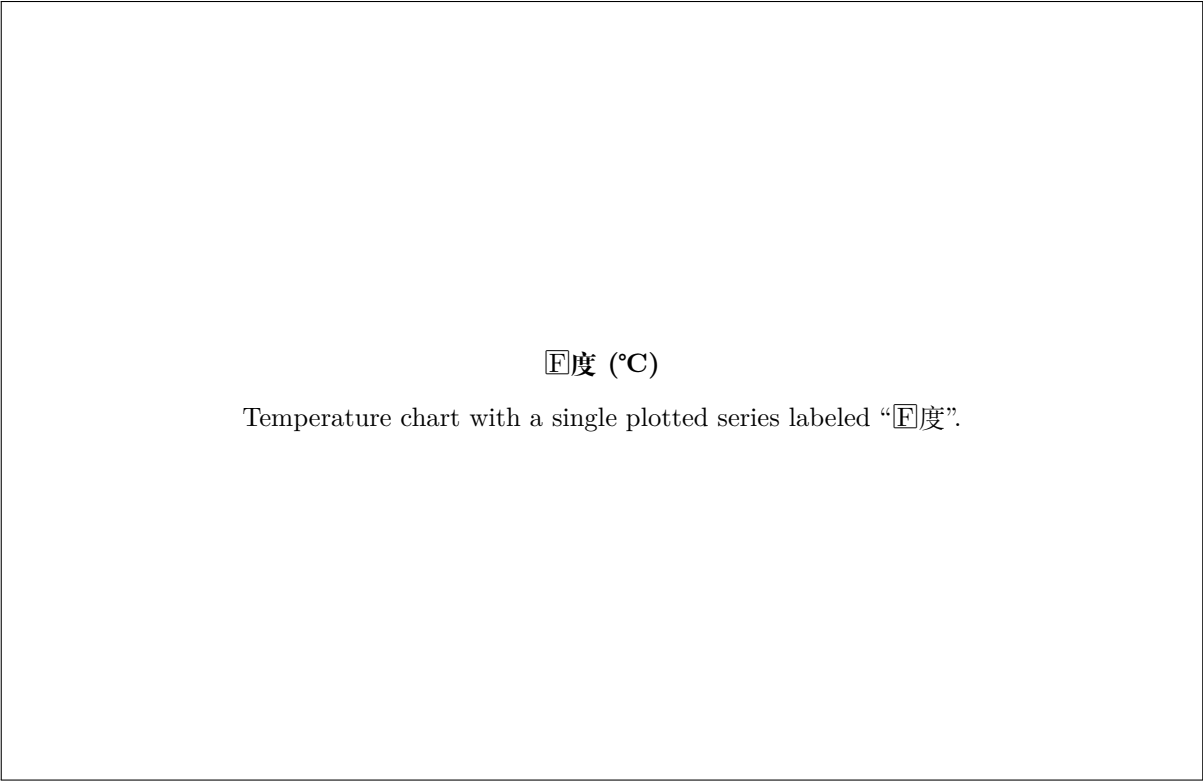

3 工艺记录


工艺编号	Prod-4H-C002	记录日期	2024-09-25 09:20:04
开始时间	2024-09-25 09:50:45	版本	V1.0
产品名称	[无法辨认]	规格型号	[无法辨认]
工艺参数	[无法辨认]	操作人员	[无法辨认]

3.1 原材料及用量

材料名称	用量	材料名称	用量
材料一	520.0 mL	材料二	50.0 mL
材料三	50.0 mL	材料四	50.0 mL
材料五	[无法辨认]	材料六	110.0 mL

3.2 工艺过程记录

时间	工序名称	工艺参数	备注
12:00:04	[无法辨认]	[无法辨认]	[无]
12:01:04	[无法辨认]	[无法辨认]	[无]
12:02:04	[无法辨认]	[无法辨认]	[无]
12:03:04	[无法辨认]	[无法辨认]	[无]
12:04:04	[无法辨认]	[无法辨认]	[无]
12:05:04	[无法辨认]	[无法辨认]	[无]

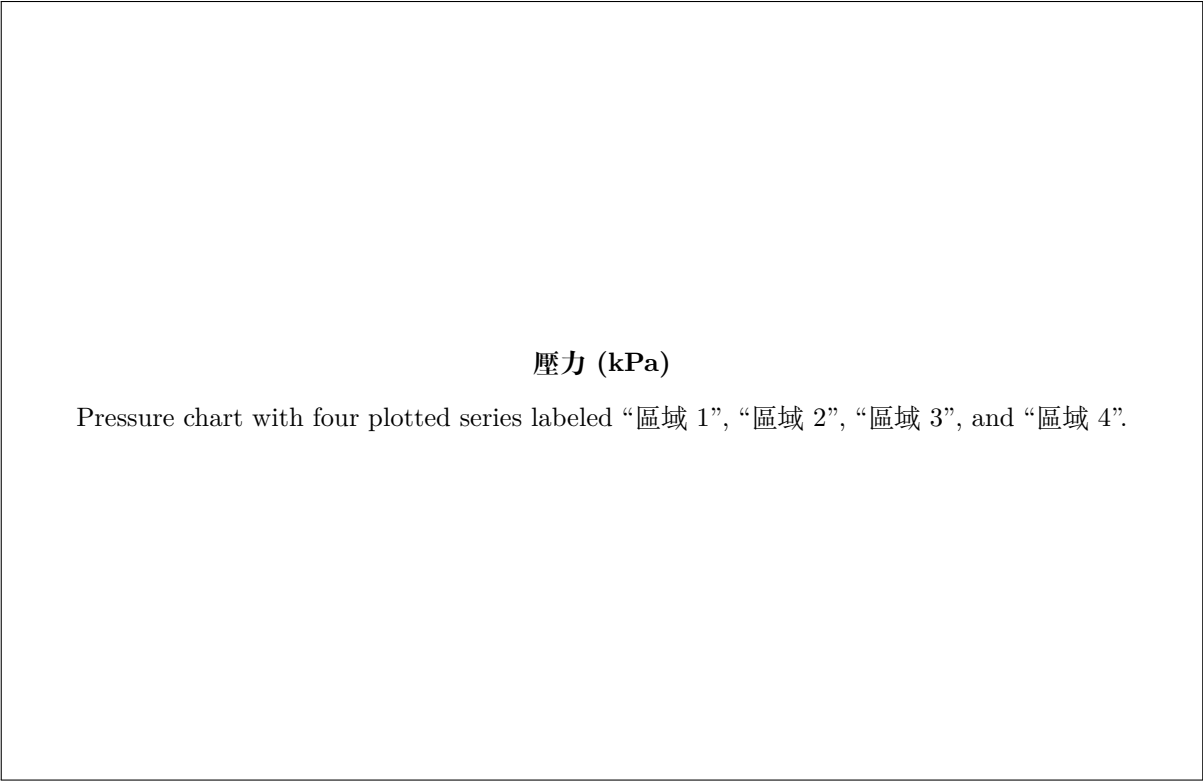

3.3 簽字及补充记录

112? / 高? / 3?45?5
%??

1254501	氯化钠注射液 0.9%，250 ml，1 瓶
1254502	氯化钠注射液 0.9%，100 ml，1 瓶
1254503	葡萄糖注射液 5%，250 ml，1 瓶
1254504	葡萄糖注射液 10%，250 ml，1 瓶
1254505	氯化钾注射液 10 ml：1 g，1 支
1254506	维生素 C 注射液 2 ml：0.5 g，1 支
1254507	维生素 B ₆ 注射液 2 ml：0.1 g，1 支
1254508	地塞米松磷酸钠注射液 1 ml：5 mg，1 支
1254509	呋塞米注射液 2 ml：20 mg，1 支
1254510	盐酸甲氧氯普胺注射液 1 ml：10 mg，1 支
1254511	肌苷注射液 2 ml：0.1 g，1 支
1254512	注射用青霉素钠，80 万单位，1 支
1254513	注射用头孢唑林钠，0.5 g，1 支
1254514	注射用头孢曲松钠，1 g，1 支
1254515	注射用头孢呋辛钠，0.75 g，1 支
1254516	注射用阿莫西林钠，0.5 g，1 支
1254517	注射用乳糖酸红霉素，0.25 g，1 支
1254518	硫酸庆大霉素注射液 2 ml：80 000 单位，1 支
1254519	盐酸左氧氟沙星注射液 100 ml：0.2 g，1 瓶
1254520	甲硝唑氯化钠注射液 100 ml，1 瓶
1254521	复方氨基酸注射液，250 ml，1 瓶
1254522	脂肪乳注射液，250 ml，1 瓶

125?	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠, 1.5 g, 1 支
125?	注射用头孢他啶, 1 g, 1 支
125?	注射用头孢噻肟钠, 1 g, 1 支
125?	注射用头孢西丁钠, 1 g, 1 支
125?	注射用氨苄西林钠, 0.5 g, 1 支
125?	注射用美洛西林钠, 1 g, 1 支
125?	注射用哌拉西林钠, 1 g, 1 支
125?	注射用盐酸万古霉素, 0.5 g, 1 支
125?	盐酸克林霉素注射液 2 ml: 0.3 g, 1 支
125?	硫酸阿米卡星注射液 2 ml: 0.2 g, 1 支
125?	氟康唑氯化钠注射液 100 ml: 0.2 g, 1 瓶
125?	阿昔洛韦注射液, 0.25 g, 1 支
125?	甘露醇注射液 250 ml: 50 g, 1 瓶
125?	复方电解质注射液, 500 ml, 1 瓶
125?	右旋糖酐 40 葡萄糖注射液, 500 ml, 1 瓶
125?	乳酸钠林格注射液, 500 ml, 1 瓶
125?	复方氯化钠注射液, 500 ml, 1 瓶
125?	维生素 B ₁ 注射液 2 ml: 50 mg, 1 支
125?	盐酸异丙嗪注射液 1 ml: 25 mg, 1 支
125?	盐酸山莨菪碱注射液 1 ml: 10 mg, 1 支
125?	盐酸消旋山莨菪碱注射液 1 ml: 10 mg, 1 支
125?	注射用水, 2 ml, 1 支

药品编码及名称、规格、数量 (左栏)	药品编码及名称、规格、数量 (右栏)
1535790	1537709
1535791	1537710
1535792	1537711
1535793	1537712
1535794	1537713
1535795	1537714
1535796	1537715
1535797	1537716
1535798	1537717
1535799	1537718
1535800	1537719
1535801	1537720
1535802	1537721
1535803	1537722
1535804	1537723
1535805	1537724
1535806	1537725
1535807	1537726
1535808	1537727
1535809	1537728
1535810	1537729
1535811	1537730
1535812	1537731
1535813	1537732
1535814	1537733
1535815	1537734
1535816	1537735
1535817	1537736
[illegible handwritten notation]	

Upper printed list *[Printed entries visible but illegible in the supplied scan.]*

Lower printed list *[Printed entries visible but illegible in the supplied scan.]*

12/4/

[Rotated Chinese item listing; transcription requires a higher-resolution page image]

13/??

TODO: insert the visible two-panel graph from this page



The graph contains colored line plots, axes, legends, and date/time tick marks.



illegible

illegible

5/25 日

10/4

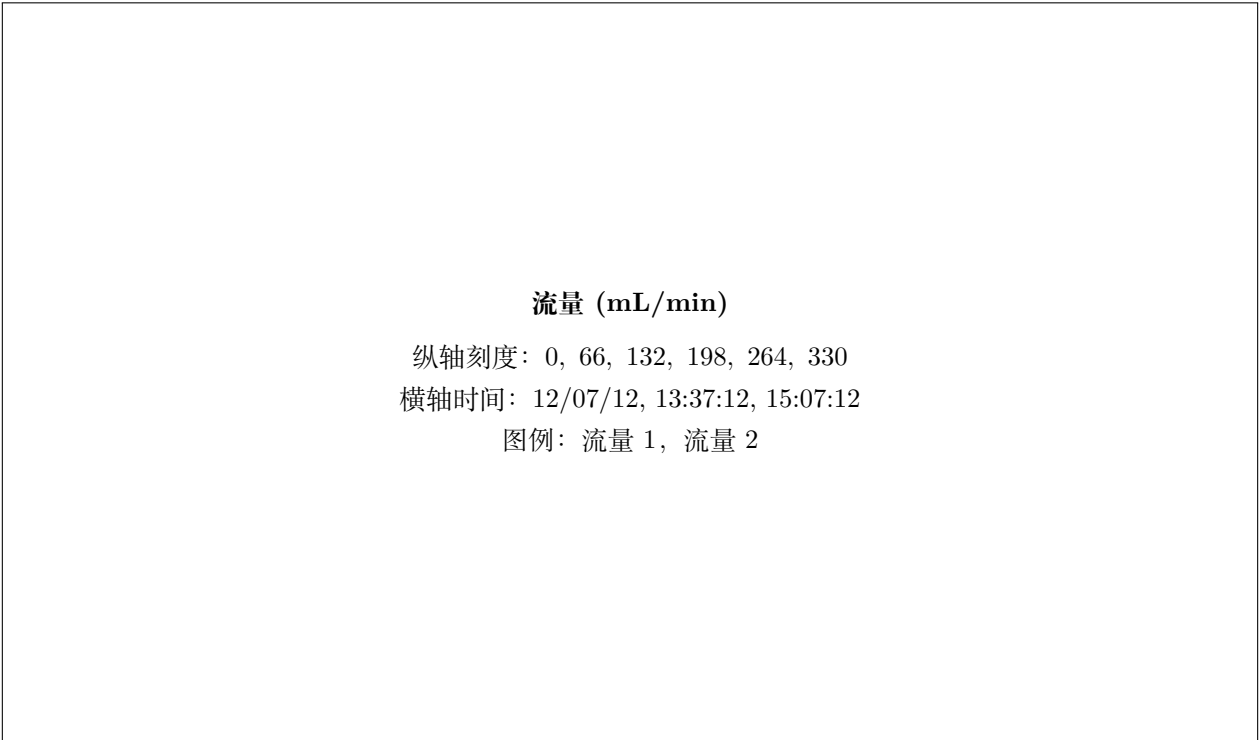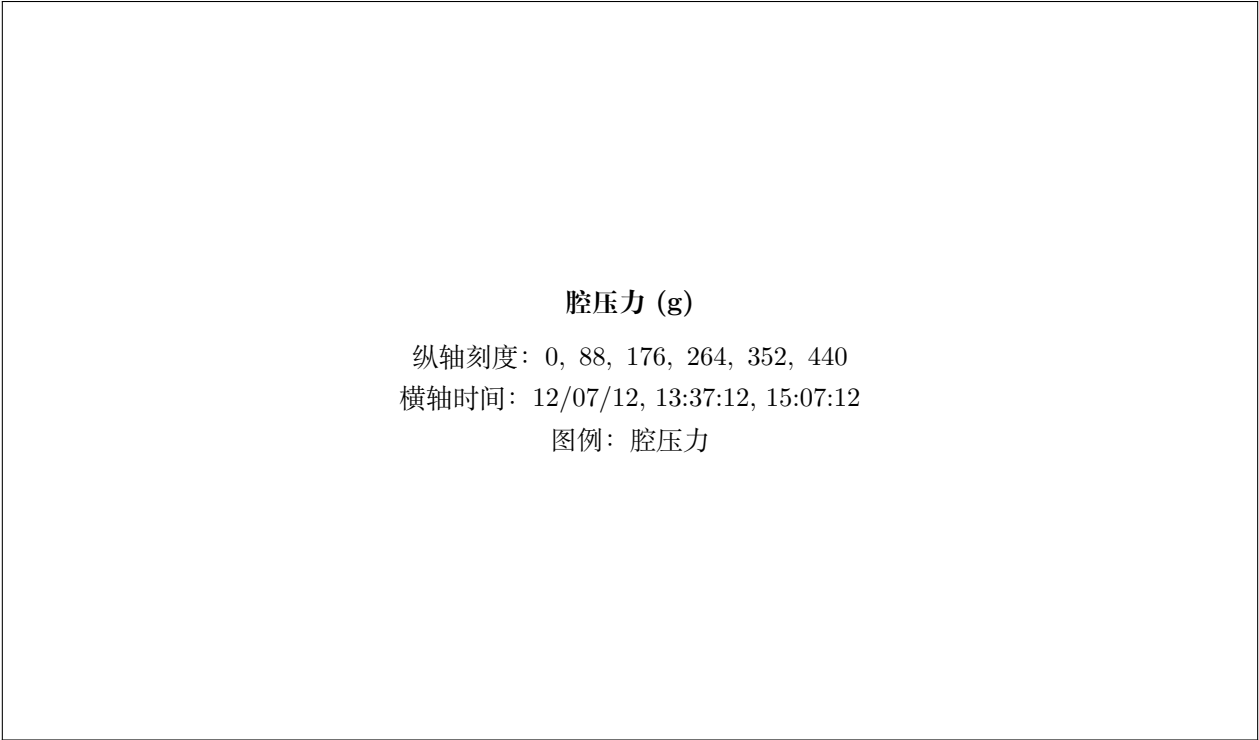

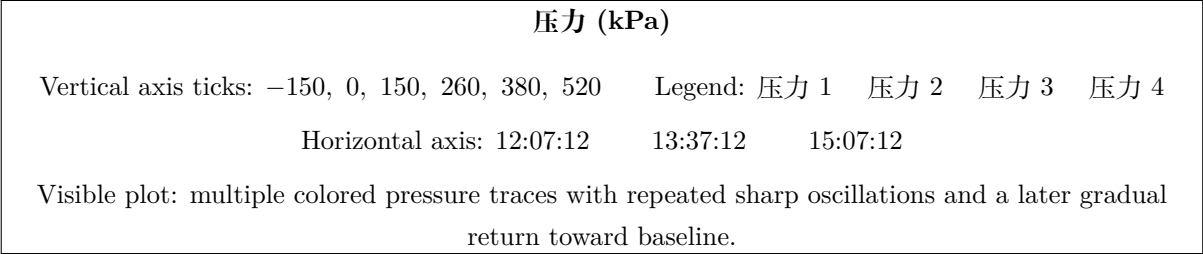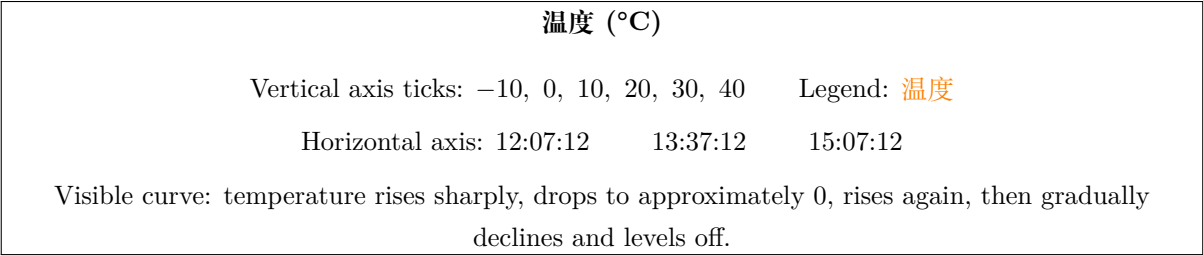

工程记录			
工程信息		工程量信息	
工程编号	C002	工程量	4807.2 mL
导出日期	2020-05-25 15:05:54	工程量	4960 mL
日期	2020-05-25 15:05:54	工程量	1685 mL
版本	V1.8	工程量	509 mL
		工程量	1013.0 mL
工程基本信息		测量记录	
工程名称		测量日期	2020-05-25
施工单位		测量人员	
监理单位		测量范围	
设计单位		备注	
建设单位			
工程地点			
记录数据			
编号	记录值	编号	记录值
1227/03		1227/04	
1227/05		1227/06	
1227/07		1227/08	
1227/09		1227/10	
1227/11		1227/12	
1227/13		1227/14	
1227/15		1227/16	
1227/17		1227/18	
1227/19		1227/20	
1227/21		1227/22	
11.06 米			
全深度			
2006.8.25			

Item code	Catalog description
1254280	[catalog text illegible]
1254290	[catalog text illegible]
1254300	[catalog text illegible]
1254310	[catalog text illegible]
1254320	[catalog text illegible]
1254330	[catalog text illegible]
1254340	[catalog text illegible]
1254350	[catalog text illegible]
1254360	[catalog text illegible]
1254370	[catalog text illegible]
1254380	[catalog text illegible]
1254390	[catalog text illegible]
1254400	[catalog text illegible]
1254410	[catalog text illegible]
1254420	[catalog text illegible]
1254430	[catalog text illegible]
1254440	[catalog text illegible]
1254450	[catalog text illegible]
1254460	[catalog text illegible]
1254470	[catalog text illegible]
1254480	[catalog text illegible]

Item code	Catalog description
1524241	[catalog text illegible]
1524242	[catalog text illegible]
1524243	[catalog text illegible]
1524244	[catalog text illegible]
1524245	[catalog text illegible]
1524246	[catalog text illegible]
1524247	[catalog text illegible]
1524248	[catalog text illegible]
1524249	[catalog text illegible]
1524250	[catalog text illegible]
1524251	[catalog text illegible]
1524252	[catalog text illegible]
1524253	[catalog text illegible]
1524254	[catalog text illegible]
1524255	[catalog text illegible]
1524256	[catalog text illegible]
1524257	[catalog text illegible]
1524258	[catalog text illegible]
1524259	[catalog text illegible]
1524260	[catalog text illegible]
1524261	[catalog text illegible]
1524262	[catalog text illegible]
1524263	[catalog text illegible]
1524264	[catalog text illegible]
1524265	[catalog text illegible]

4006

[Dense vertically oriented tabular content visible in the upper portion of the page.]

[Dense vertically oriented tabular content visible in the lower portion of the page.]

项目代码	项目名称及规格
(本页上半部分; 内容为续表)	
[打印内容过小, 无法可靠辨识]	
项目代码	项目名称及规格
(本页下半部分; 内容为续表)	
[打印内容过小, 无法可靠辨识]	

[日期; 具体数字及字迹不清]

[签名或备注; 字迹不清]

[Rotated printed item list; transcription required]

[Rotated printed item list; transcription required]

2/14

(实验记录)

姓名: (姓名, 字迹不清)

日期: 2024 年 05 月 21 日



图 1: 实验数据曲线图

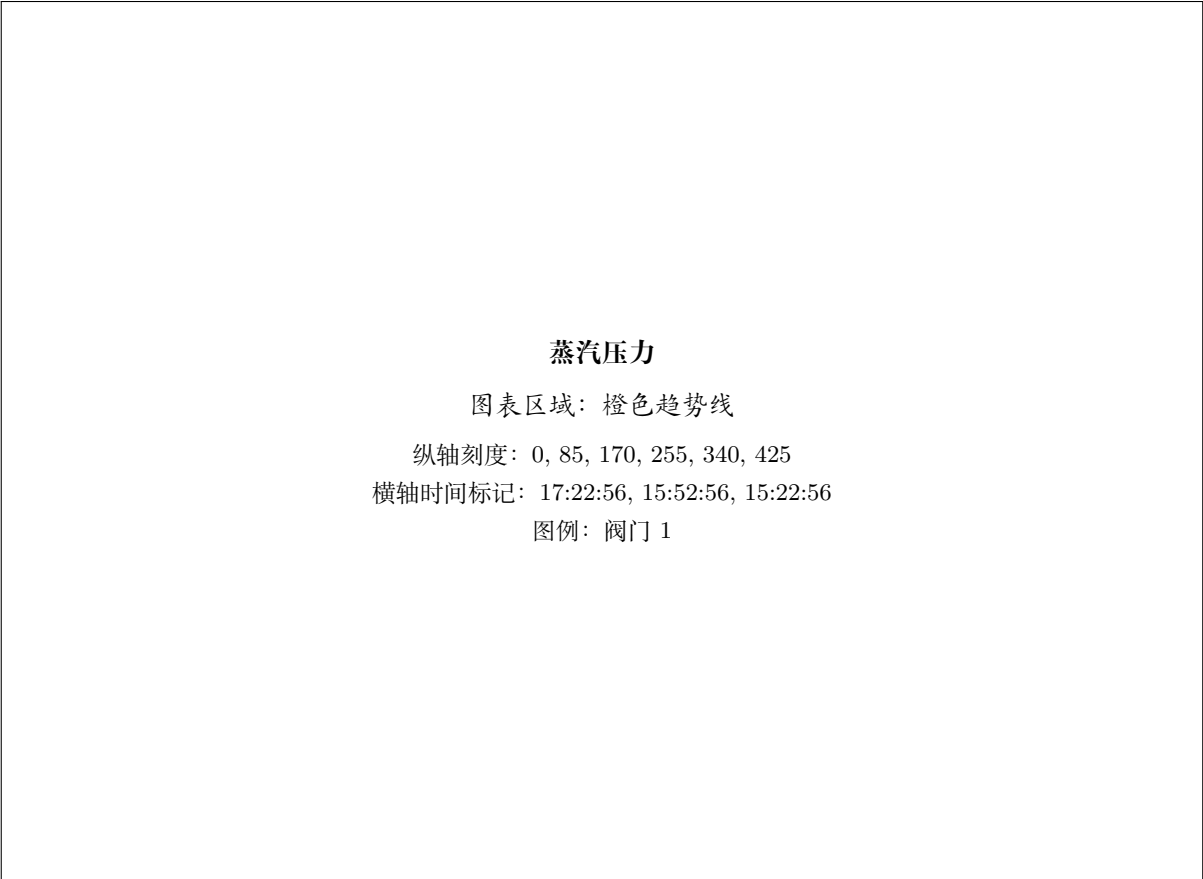


图 2: 蒸汽压力趋势图



图 3: 流量趋势图

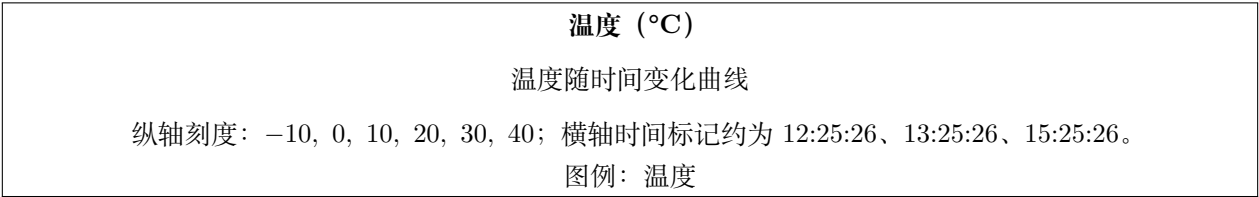


图 4: 温度曲线

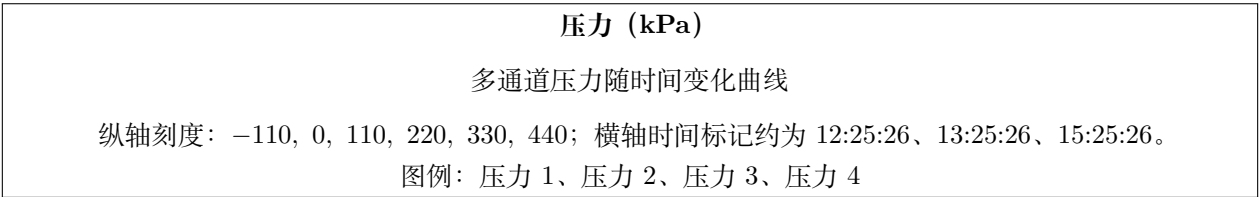


图 5: 压力曲线

审核
11/14
7/06/23

蒸汽灭菌器使用记录

文档编号： RP-D-2026-0151 文件编号： REC-YK-SOP-PD-0145-01 版本号： 2.0
(手写备注，字迹不清)

日期	灭菌时间	灭菌温度	灭菌压力	监测结果	监测人	复核人	备注
2025.9.26	11:00	134.6	0.21	合格 ☒ 不合格 ☐	王娟	李小明	—
2025.9.27	11:00	134.6	0.21	合格 ☒ 不合格 ☐	王娟	李小明	—
2025.9.28	11:00	134.6	0.21	合格 ☒ 不合格 ☐	王娟	李小明	—
2025.9.29	11:00	134.6	0.21	合格 ☒ 不合格 ☐	王娟	李小明	—
2025.9.30	11:00	134.6	0.21	合格 ☒ 不合格 ☐	王娟	李小明	—
日期	灭菌时间	灭菌温度	灭菌压力	合格 ☐ 不合格 ☐			
日期	灭菌时间	灭菌温度	灭菌压力	合格 ☐ 不合格 ☐			
日期	灭菌时间	灭菌温度	灭菌压力	合格 ☐ 不合格 ☐			
日期	灭菌时间	灭菌温度	灭菌压力	合格 ☐ 不合格 ☐			
日期	灭菌时间	灭菌温度	灭菌压力	合格 ☐ 不合格 ☐			

PAL Flowstar IV 流量计结果


日期	2025/12/28
时间	10:21
Serial number	2380344?
型号	SH-SP?2002?A
测量介质	C
介质温度	K
介质密度	800 kg/m³
流量范围	0-?
仪表系数	SH?ST?002?
脉冲宽度	1 ms
输出	4-20 mA
最大流量	1400 l/min
最小流量	600 l/min
压力	1600 mbar
测试时间	22/12/2025 15:39
验收日期：2025.05.22	

签名

PAL Flowstar IV 流量计结果

日期：2025/12/28 时间：15:38

2 of 2

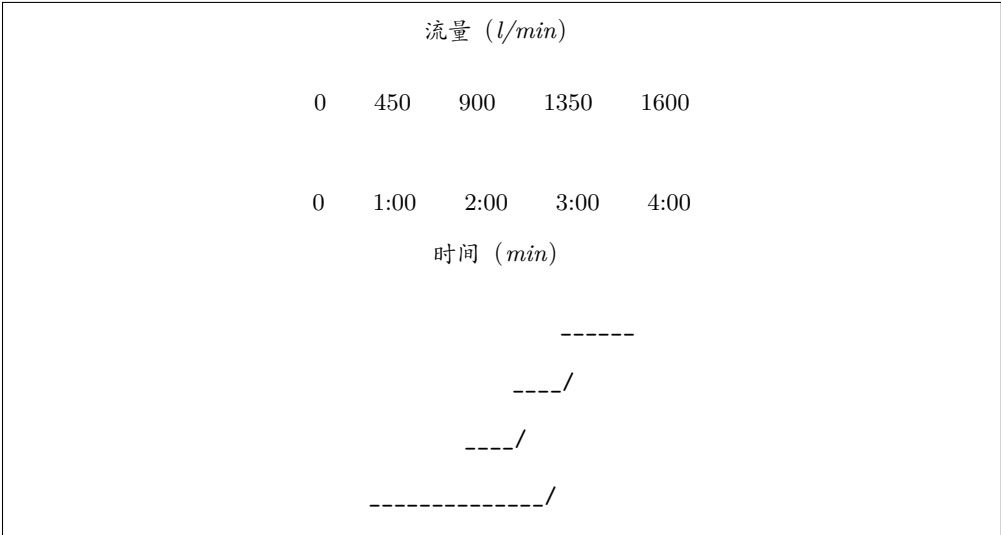

验收日期：2025.05.22


//

Palltronic Flowstar IV 测试结果

日期	22/Mar/2026 15:28:38
时间	1.0 d
Palltronic 流量测试仪编号	2388047436
序列号	[不清晰]
测试结果	OK
测试类型	[不清晰]
设备名称	[不清晰]
产品名称	[不清晰]
产品编号	[不清晰]
测试介质	Air
测试压力	4.0 bar
测试持续时间	1,000 mbar
测试气体	Air
测试压力范围	1600 mbar
报告签署时间	22/Mar/2026 15:35:39
[日期, 疑似 2026.03.22]	

Palltronic Flowstar IV 测试结果

日期	22/Mar/2026 15:28:38
时间	2.0 d

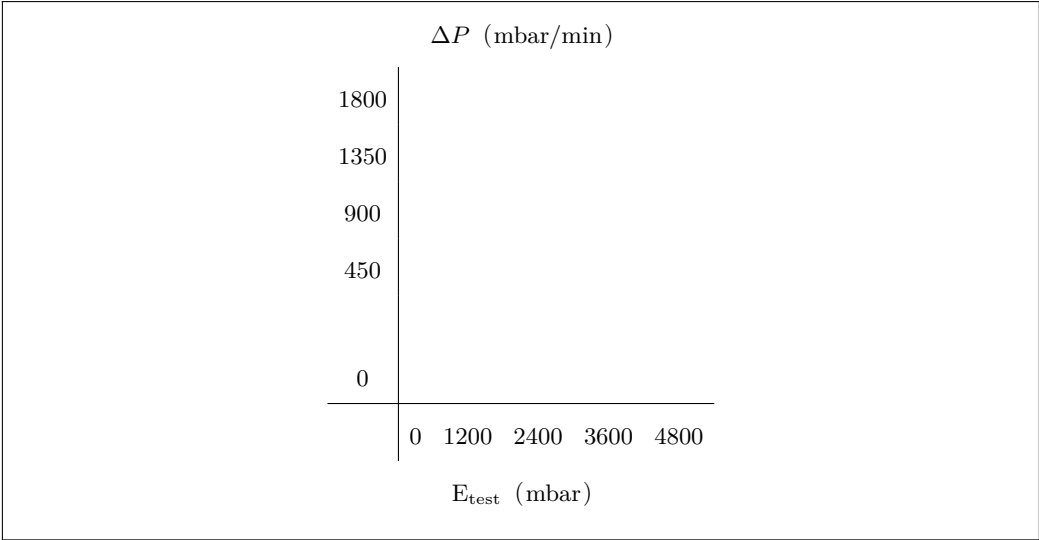

[签名/日期, 无法清晰辨认]

3/1

4 Panasonic Flowstar IV 流量计检定结果

Panasonic Flowstar IV 流量计检定结果

日期：22/02/2025 15:40:27
压力：2.0 d

压力 (mbar/min)	
1800	
1350	
900	
450	

流量 (m³/min)

1200
2400
3600
4800
6000

赵旭明 2025.02.22

5 流量计检定记录

Panasonic Flowstar IV 流量计检定记录

项目	记录
型号	2Z?2/??26/??
编号	1.02
介质	T?G?44
Serial number	285?4980
流量范围	SH?P?10?2GM
输出信号	C
连接方式	N?T?
供电电源	Shy?0?8
温度范围	1?200?08
压力等级	12?0?08
精度等级	SH?P?0?2?50
显示方式	SH?P?0?2?GM
安装方式	IP?A-4.0?1
防护等级	SH?P?0?2?GM
量程比	4A?
最小流量	1:1000
最大工作压力	4000 mbar
压力范围	6000 mbar

测试结果：合格

测试介质：空气

测试压力范围：22mbar/6000 mbar

赵旭明 2025.02.22

6 **Palltronic Flowstar IV 测试结果**

日期	2025/02/26 15:40:27
序列号	150?C?22?
设备号	150?C?22?
测试名称	?
测试方法编号	200?
检测介质	Air
测试压力	2.0 bar
测试时间	?
测试结果	Pass
泄漏率	?
最大允许泄漏率	?
测试压力曲线	?
赵立?	
2025.2.27	

7 **Palltronic Flowstar IV 测试结果**

日期	2025/02/26 15:40:27
结果	2.0?



赵立?
2025.2.22

8 Pathronic Flowstar IV 测试结果


日期	26/May/2025 15:26:02
时间	1 of 2
Serial/Results number	2388044012
测试模式	FS01?G?R / 2?1
测试介质	PC
单位	SH?P?T0022GH
气体类型	C
设备名称	Sinoflow
产品型号	432?020?506?0
产品序列号	?
测试范围	1-?
测试压力	1.1?
测试流量	1.1?
最大压力	1.1?
结果	6000 mbar

2025?05?26

9 测试曲线

PAIL Pathronic Flowstar IV 测试结果

日期：26/May/2025 15:26:02
1 of 2

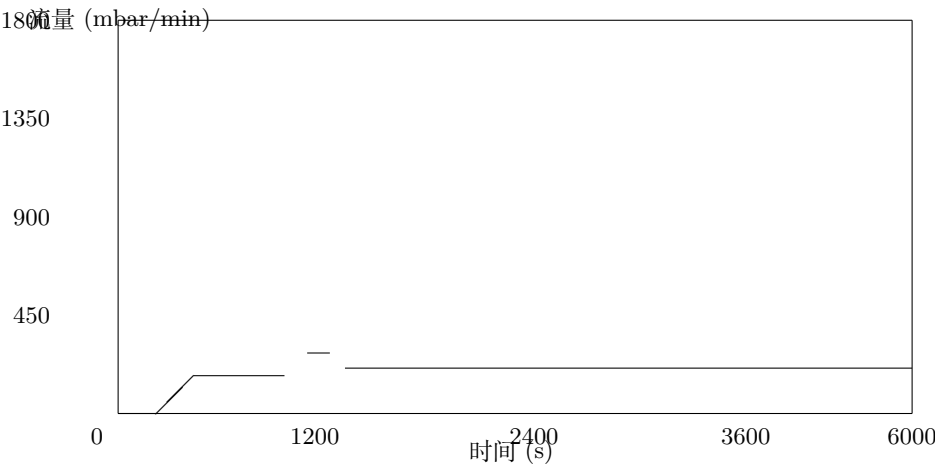

2025.05.14


PALL Palltronic Flowstar IV 流量报告

日期	26/May/2026 15:26:02
序列号	FS?
软件版本	2.38.024
测试类型	Pressure Hold
测试程序	SHSP?0023?
环境温度	24.6
压力单位	kPa
测试压力	1200
流量单位	mbar
测试持续时间	60 s
测试结果	PASS

测试压力：1200 mbar
于海 2026.5.26

PALL Palltronic Flowstar IV 流量报告

日期	26/May/2026 15:26:02
页码	2 of 2

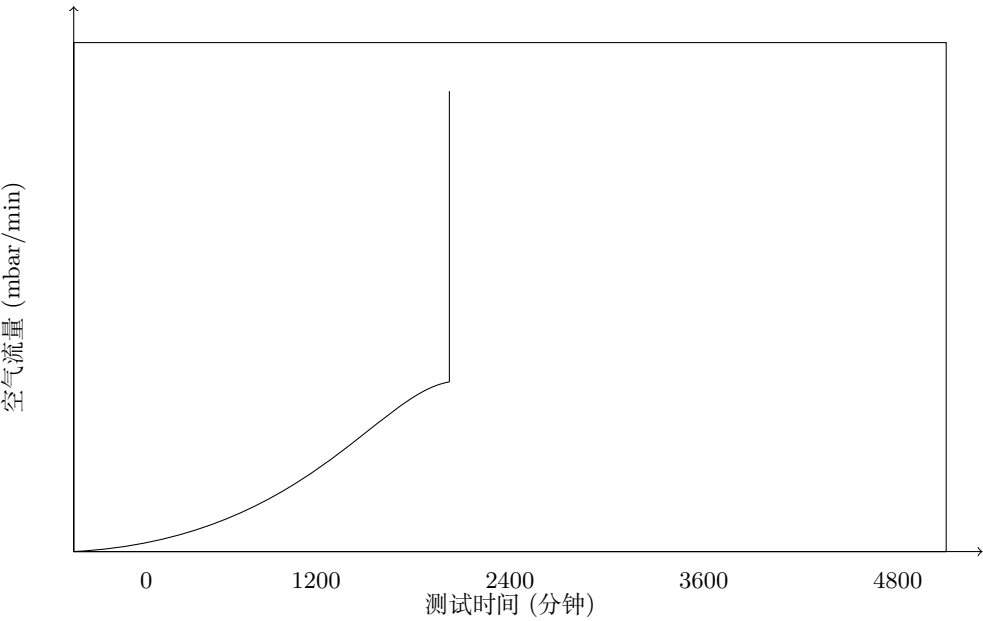

于海 2026.5.26

Palltronic Flowstar IV 测试结果


日期	23/May/2026 15:37:50
测试编号	FS?
序列号	F?
仪器序列号	2?
测试压力	2.8 bar
温度	20 °C
测试气体	Air
测试项目	Flow
程序名称	S?
测试结果	Pass
测试流量	1800 mbar

测试压力范围：1850 mbar
流量：1800 mbar
日期/时间： 23/May/2026 15:36:33

[illegible handwritten date or notation]

Palltronic Flowstar IV 测试结果

日期： 23/May/2026 15:37:50
测试时间： 2:02

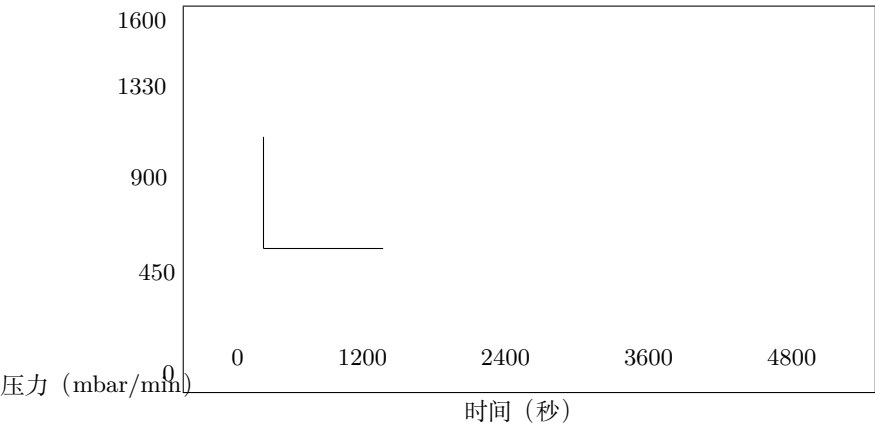

[illegible handwritten date or notation]

ok


Palltronic Flowstar IV 测试报告


日期	26/May/2025 15:39:50
测试编号	1.02
序列号	[不清晰]
测试过滤器编号	SH5FPT0020260A
测试气体	N ₂
测试压力	1000
压力单位	mbar
产品名称	[不清晰]
产品编号	1226244C
产品批号	[不清晰]
过滤器类型	PFA
过滤器材质	[不清晰]
测试结果	通过
最大压力	1100 mbar
最小压力	600 mbar
保压时间	1850 mbar
结论	通过

签名 2025.05.26

Palltronic Flowstar IV 测试结果

日期	26/May/2025 15:39:50
测试编号	2.02

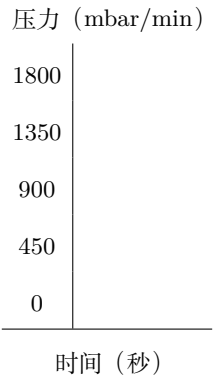



签名 2025.05.26
711

PALL Pantronic Flowscan IV 测试结果

日期	26/Mar/2025 18:38:38
时间	10:00
Sample number	FSH?G?L?/2?41
仪器型号	FSH?G?L?/2?41
测试模式	PC
程序	FSH?P?002?M
地点	Shanghai
样品温度	N?Z?C
样品编号	043?202?C?009?0
国家	JAP
测试压力	1.2?A
压力单位	mbar
升压速率	1.000
降压速率	1.000
最大压力	6000 mbar
25? 2025.03.21	
结果	指定范围内：1800 mbar
测量范围	1800 mbar
报告日期	28/Mar/2025

PALL Pantronic Flowscan IV 测试结果


10 Pulmonary Flowability IV 检测结果

日期	26/May/2025 15:48:34
患者号	100
姓名	F...
病历号	28...
性别	女
年龄	28
检查项目	肺功能
设备型号	Spiro...
检查模式	C
其他报告参数	[部分难以辨认]
备注	[空白]
检查时间	26/May/2025 15:53:03
签名	[签名]

25 年 06.26

11 Pulmonary Flowability IV 测量结果

日期	26/May/2025 15:48:31
页码/次数	2 of 2

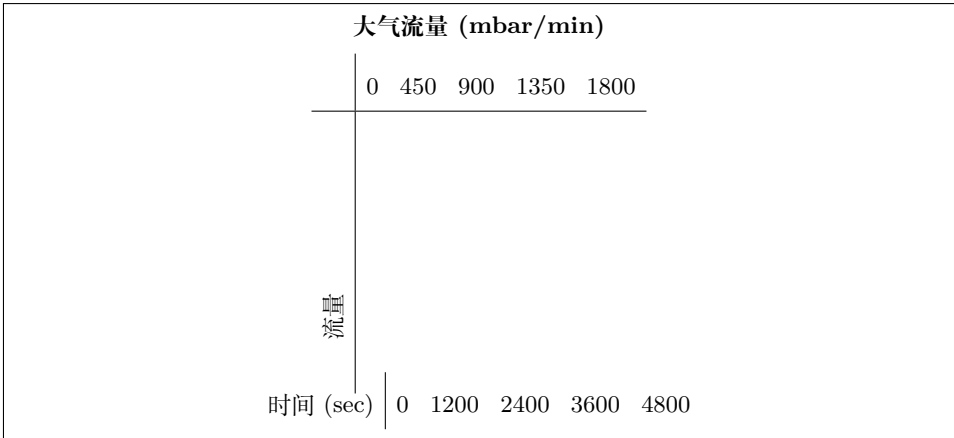

[黑色手写文字]

74?kg

20?5.8.11

附件 2: 扫描仪对……校准……记录

202? 年?? 月?? 日

METTLER TOLEDO
Model: HE2280/02
S/N: C224227?22
Date: 2026/05/22
Time: 12:41:29

A?……

Signature: illegible signature

illegible signature 2026 年 05 月 22 日