




Numero de equipo: IM-060 (C21377921)
 Descripción equipo: ATORNILLADOR DE TORQUE
 Área de la empresa: SUSENSIONES
 Resolución: 01.000 Nm
 Tolerancia Inf.: -00.500 Nm

Fecha estudio: Sep-23
 Frecuencia: 12 MESES
 Próximo estudio: Sep-24
 Alcance: 15.0 Nm
 Tolerancia Sup.: 0.5 Nm
 Temperatura: 19.8 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS

METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de Referencia		
2.025		
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	2.038	0.013
2	2.021	-0.004
3	2.029	0.004
4	2.013	-0.012
5	2.026	0.001
6	2.039	0.014
7	2.042	0.017
8	2.033	0.008
9	2.048	0.023
10	2.015	-0.01
11	2.010	-0.015
12	2.038	0.013
PROMEDIO		0.0043

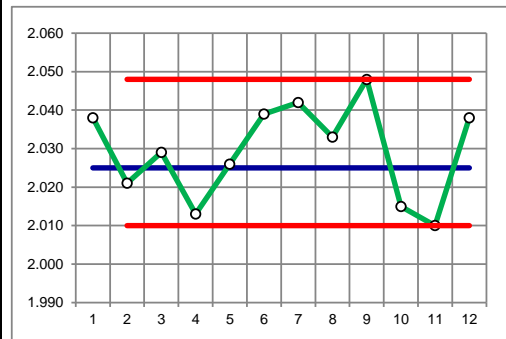

	n	Promedio	Desviación Estandar, σ_r	Error Estándar de la Media, σ_b
Valor Medido	12	2.029	0.0124	0.0036

Estadístico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio
0.0036	11	2.201	0.0043

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v,1-\alpha/2} \right) \right] \leq \text{cero} \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v,1-\alpha/2} \right) \right]$$

-0.0035 <= 0 >= 0.0122

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

TRANSDUCTOR (DESUMEX)

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:

Elaboro: LEYDA TREJO

Revisó: MIREYA HERNANDEZ