

Datos de referencia (Reference data):

Fecha de recepción: 2024-02-26 **Fecha de calibración:** 2024-02-27 **Fecha de emisión:** 2024-03-06 **Fecha de próxima calibración:** -----
(Reception date) (Calibration date) (Date issued) (Next calibration date)
Lugar de calibración: En sitio, instalaciones del cliente
(Calibration place)

Datos del cliente (Customer data):

Nombre: GRAMMER AUTOMOTIVE PUEBLA, S.A. DE C.V. **Nombre del usuario:** Ing. Mireya Hernandez
(Name) (User name)
Dirección: Avenida de la Luz #24 Bodegas 1 y 2 Acceso III, Parque Industrial Benito Juárez, **Correo electrónico:** Mireya.Hernandez@grammer.com
(Address) Querétaro, Querétaro, C.P.76120 (Email)

Datos del ítem (Item description):

Ítem: Máquina de medición por coordenadas (CMM) (Item)	Identificación: EM-002 (ID)	Sistema de palpado: TP20 (Probes system)	Software: PC-DMIS CAD++ 2016 (Software)
Marca: Brown & Sharpe (Brand)	Alcance de medida: 700-1000-500 (Measurement Scope)	Cabezal para palpador: PH10M (Probes Head)	
Modelo: Mistral 1075 (Model)	Datos del palpador (mm): (Probes Data)	No. serie del cabezal: 05G298 (Head serial number)	
Serie: 1299-9431 (Serial)	*DIAMETRO = 8 *LONGITUD L₀ = 10	No. serie del sistema: V98515 (System serial number)	

Método (Method):

Procedimiento de calibración de máquinas de medición por coordenadas.
(Calibration procedure for coordinate measuring machines.)

MESS-DI-PRO-001

Método: Comparación directa
(Method) (Direct comparison)

Condiciones ambientales:
(Environmental conditions)

Temperatura mínima: 21.0 °C
(Minimum temperature)
Temperatura máxima: 21.5 °C
(Maximum temperature)
Humedad relativa: 42 %
(Relative humidity)

Trazabilidad metrológica (Metrological traceability):

Descripción (Description)	Serie (Serial)	Certificado/Vigencia/Calibrado por (Certificate/Validity/calibrated by)	Identificación (ID)	INM (NMI)
Regla de Pasos	SE0700414	CNM-CC-740-458/2023 2026-08 / CENAM	MESS-P-KOB-89	CENAM
Esfera Patrón	B2377	MESS-CC-LCE-4920/2023 2025-12 / MESS	MESS-P-ESF-16	CENAM
Bloque Patrón	120013	CNM-CC-740-666/2023 2025-12 / CENAM	MESS-P-BLO-81	CENAM

Firmas (Signatures):

Calibró:
(Calibrated by)
Adolfo Isai Reyes Durán
Ingeniero de servicio
(Service Engineer)

Aprobó:
(Approved by)
Ángel Fernando San Juan
Signatario
(Signatory)

Formato y revisión:
(Format / review)

MESS-DI-FOR-004
Rev.: 4

El presente certificado ha sido emitido por Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. laboratorio acreditado por ema que es signataria del Arreglo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y de la cooperación de Asia Pacífico para la Acreditación de Laboratorios, APLAC. El (los) resultado (s) de la medición declarado (s) en este certificado puede (n) ser aceptado (s) internacionalmente a través del MRA ILAC/APLAC.

(This certificate has been issued by Mess Servicios Metrologicos S. de R.L. de C.V. laboratory accredited by ema that is a signatory of the Mutual Recognition Agreement (MRA) of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and of the Asia Pacific cooperation for the accreditation of Laboratories (APLAC). The result (s) of the measurement declared in this certificate can be accepted internationally through the MRA ILAC / APLAC).

Los resultados de este certificado tienen validez, dentro de las condiciones ambientales encontradas durante el proceso de medición y únicamente en su forma íntegra y original. Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento a personal no autorizado por Mess.

(The results of this certificate are valid, within the conditions found in the measurement process and in its complete and original form).
(The partial or total reproduction of this document is prohibited, without the approval of Mess).

Los resultados y niveles de incertidumbres declaradas en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito.

(The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of measurement.)

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a:

(442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18. En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente.
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18. In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid.
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)
"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"



Descripción del método

Method description

El método que se emplea esta basado en la(s) norma(s): ISO 10360-2:2009 e ISO 10360-5:2020

The method used is based on standard(s): ISO 10360-2:2009 and ISO 10360-5:2020

La calibración consiste en realizar 4 pruebas:

Calibration consist of performing 4 tests:

Determinar el error de indicación en mediciones de longitud en el mismo eje del brazo. ($E_{L=0}$)

Determine the error of indication in length measurements on the same axis of the arm.

Determinar el error de indicación en mediciones de longitud a una distancia del eje del brazo. ($E_{L=150}$)

Determine the error of indication in measurements of length at a distance from the axis of the arm.

Determinar el rango de repetibilidad en mediciones de longitud. (R_0)

Determine repeatability range on length measurements.

Determinar los errores de palpado. ($P_{Form.Sph.1x25.SS.Tact}$ y $P_{Size.Sph.1x25.SS.Tact}$)

Determine the probing errors.

Para evaluar el error de medición de longitud se emplea:

$E_{L,MPE}$ Máximo error de medición en longitud, con $L=0$ mm, y $L=150$ mm.

Para evaluar la repetibilidad se emplea:

R_0, MPL Límite máximo permitido para el rango de repetibilidad

Declaración de la incertidumbre estimada de la prueba	
Statement of estimated test uncertainty	
$U E_L$	
Incertidumbre de medición en longitud, con $L=0$, y $L=150$	
Expresado como ecuación de la recta:	$U E_L \pm = 0.36 + 2.7 \times L \quad \mu m \quad [L] = m$

Observaciones generales

(General remarks)

Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.

It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices.

El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.

The use of calibration results is the responsibility of the user.

Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.

The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.

Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales

The results that appear in this certificate have traceability to national standards.

En el presente certificado el término calibración debe entenderse como verificación del desempeño según la familia de normas ISO 10360.

In this certificate the term calibration should be understood as verification of performance according to the ISO 10360 family of standards.

La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.

The expanded uncertainty is expressed by a coverage factor of $k = 2$, which assures the confidence level of at least about 95%.

La incertidumbre fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002.

The uncertainty was estimated according NMX-CH-140-IMNC-2002.

Los resultados se expresan en el Sistema Internacional de unidades (SI).

Results are expressed in the International System of Units (SI).

En los gráficos las líneas rojas se refieren a los EMP.

In charts red lines are EMP.

Los resultados de la prueba de palpado ($P_{Form.Sph.1x25.SS.Tact}$ y $P_{Size.Sph.1x25.SS.Tact}$) y sus incertidumbres no se encuentran en el alcance acreditado.

The results of the probing test ($P_{Form.Sph.1x25.SS.Tact}$ y $P_{Size.Sph.1x25.SS.Tact}$) as well as their corresponding uncertainty are not in the accredited scope.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS




Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18.
En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente.
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18.
In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid.
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)
"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"



Condiciones ambientales en las que se aplican las pruebas

Environmental conditions in which the tests are applied

Condiciones ambientales durante el proceso de calibración (Environmental conditions in which the tests are applied)

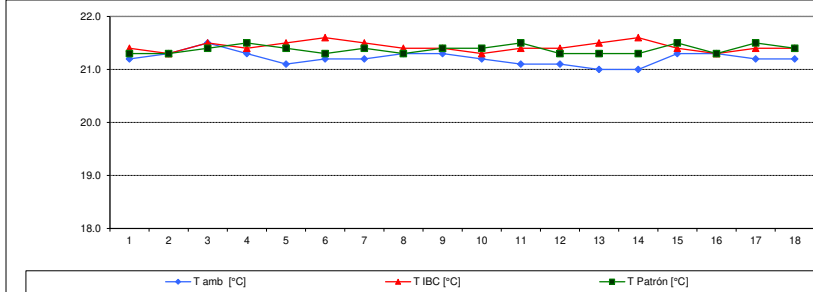

T min. 21.00 °C
T max. 21.50 °C
 ΔT_{amb} 0.50 °C

Temperatura Ambiental
21.21 °C U = \pm **0.11** °C

T min. 21.30 °C
T max. 21.60 °C
 ΔT_{mmc} 0.30 °C

Temperatura de MMC
21.43 °C U = \pm **0.11** °C

Termómetro utilizado:

Termómetro digital TESTO 720 02938571 MESS-CC-TEP-0700/2023 18/10/2025

Datos de especificaciones técnicas del equipo calibrado (Facts of specifications technical of instrument calibrated)

Modo de operación:		Automatica		Error máximo permisible de longitud	
		Reducción de eje por sistema de palpador o accesorios		$E_{L, MPE} = \pm 3.5 + L / 300 \mu m$	
Eje	Longitud de los ejes			Error máximo permisible de repetibilidad	
X	700 mm	Sin reducción		$R_{0, MPL} = \pm 2.3 \mu m$	
Y	1000 mm	150 mm en eje Y			
Z	500 mm	Sin reducción			
Resolución de las escalas		0.000 1 mm			
Tipo de cabezal para palpador:		Cabezal rotatorio indexable con dos grados de libertad		Palpadores empleados en las pruebas	
Sistema de palpado:		Electromecánico		E ₀ Rubí D8 X 10 mm M2 vástago de Acero	
Sistema intercambiador de herramientas:		Ninguno		E ₁₅₀ Rubí D8 X 160 mm M2 vástago de Acero	
				Palpado Rubí D8 X 10 mm M2 vástago de Acero	
Temperaturas para asegurar la incertidumbre del equipo:				Compensación térmica:	
T _{S, MIN} :	18 °C	$\Delta T_{S, 1}$: 1 °C/hr		$\Delta T_{S, H}$: 1 °C/m	
T _{S, MAX} :	22 °C	$\Delta T_{S, 24}$: 2 °C/24 hr		$\Delta T_{S, V}$: 1 °C/m	
CTE		X 11.5 x10 ⁻⁶ /°C por m		Peso máximo de carga tolerado en el equipo: Kg	
Efectivo para las escalas:		Y 11.5 x10 ⁻⁶ /°C por m		Sin referencia	
		Z 11.5 x10 ⁻⁶ /°C por m		Las pruebas se aplican con o sin carga de trabajo	
Incertidumbre del valor CTE (k=2)		1 x10 ⁻⁶ /°C por m		sin carga	
Presión nominal del aire comprimido de trabajo:		0.5 MPa			
Presión real indicada en IBC		0.5 MPa			

Pruebas de Repetibilidad

Repeatability tests

Prueba de repetibilidad del error de longitud, R ₀		Mediciones en mm	
Valor máximo de repetibilidad	0.001 8	Error de repetibilidad máximo permisible R _{0, MPL}	0.002 3

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18. En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18. In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").
"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"



Error de medición de longitud E_0

Length error E_0

Todos los resultados se expresan en mm

Longitud Patrón	1 era medición	E_{11}	2 da medición	E_{12}	3 era medición	E_{13}	Repetibilidad
Posición 5, paralela a eje X							
19.999 1	19.999 5	0.000 4	20.000 1	0.001 0	20.000 5	0.001 4	0.001 0
99.873 4	99.872 2	-0.001 2	99.872 4	-0.001 0	99.872 2	-0.001 2	0.000 2
219.929 6	219.927 9	-0.001 7	219.928 1	-0.001 5	219.928 1	-0.001 5	0.000 2
379.883 1	379.881 1	-0.002 0	379.881 0	-0.002 1	379.881 1	-0.002 0	0.000 1
419.872 0	419.869 9	-0.002 1	419.868 9	-0.003 1	419.869 5	-0.002 5	0.001 0
499.875 0	499.873 8	-0.001 2	499.873 0	-0.002 0	499.873 3	-0.001 7	0.000 8
Posición 6, paralela a eje Y							
19.999 1	20.001 0	0.001 9	20.000 6	0.001 5	20.000 6	0.001 5	0.000 4
99.873 4	99.871 2	-0.002 2	99.873 0	-0.000 4	99.872 8	-0.000 6	0.001 8
219.929 6	219.931 1	0.001 5	219.930 3	0.000 7	219.931 3	0.001 7	0.001 0
379.883 1	379.884 8	0.001 7	379.886 3	0.003 2	379.885 2	0.002 1	0.001 5
539.851 2	539.853 3	0.002 1	539.853 5	0.002 3	539.854 1	0.002 9	0.000 8
699.933 5	699.936 9	0.003 4	699.938 2	0.004 7	699.937 4	0.003 9	0.001 3
Posición 7, paralela a eje Z							
19.999 1	19.998 9	-0.000 2	19.997 3	-0.001 8	19.997 9	-0.001 2	0.001 6
99.873 4	99.871 0	-0.002 4	99.870 8	-0.002 6	99.872 0	-0.001 4	0.001 2
179.925 2	179.923 2	-0.002 0	179.924 4	-0.000 8	179.924 2	-0.001 0	0.001 2
259.951 0	259.949 9	-0.001 1	259.949 7	-0.001 3	259.948 7	-0.002 3	0.001 2
339.913 6	339.911 2	-0.002 4	339.911 6	-0.002 0	339.911 7	-0.001 9	0.000 5
419.872 0	419.868 9	-0.003 1	419.869 2	-0.002 8	419.869 5	-0.002 5	0.000 6
Posición 1, diagonal con orientación (1,0,0) a (0,1,1)							
19.999 1	19.998 6	-0.000 5	19.998 3	-0.000 8	19.997 9	-0.001 2	0.000 7
99.873 4	99.870 9	-0.002 5	99.871 5	-0.001 9	99.871 4	-0.002 0	0.000 6
299.933 8	299.931 5	-0.002 3	299.930 7	-0.003 1	299.931 8	-0.002 0	0.001 1
499.875 0	499.873 0	-0.002 0	499.872 4	-0.002 6	499.873 2	-0.001 8	0.000 8
699.933 5	699.929 7	-0.003 8	699.929 5	-0.004 0	699.930 3	-0.003 2	0.000 8
900.001 8	899.997 8	-0.004 0	899.997 9	-0.003 9	899.998 5	-0.003 3	0.000 7
Posición 2, diagonal con orientación (1,1,0) a (0,0,1)							
19.999 1	19.998 0	-0.001 1	19.998 3	-0.000 8	19.997 7	-0.001 4	0.000 6
99.873 4	99.872 6	-0.000 8	99.871 4	-0.002 0	99.871 8	-0.001 6	0.001 2
299.933 8	299.932 3	-0.001 5	299.931 1	-0.002 7	299.931 2	-0.002 6	0.001 2
499.875 0	499.872 2	-0.002 8	499.872 9	-0.002 1	499.873 8	-0.001 2	0.001 6
699.933 5	699.930 2	-0.003 3	699.930 5	-0.003 0	699.931 3	-0.002 2	0.001 1
900.001 8	899.998 6	-0.003 2	899.998 0	-0.003 8	899.998 9	-0.002 9	0.000 9
Posición 3, diagonal con orientación (0,1,0) a (1,0,1)							
19.999 1	19.997 7	-0.001 4	19.998 3	-0.000 8	19.997 9	-0.001 2	0.000 6
99.873 4	99.871 3	-0.002 1	99.872 2	-0.001 2	99.871 9	-0.001 5	0.000 9
299.933 8	299.932 5	-0.001 3	299.932 1	-0.001 7	299.931 4	-0.002 4	0.001 1
499.875 0	499.872 2	-0.002 8	499.873 0	-0.002 0	499.872 4	-0.002 6	0.000 8
699.933 5	699.929 5	-0.004 0	699.930 9	-0.002 6	699.930 6	-0.002 9	0.001 4
900.001 8	900.000 0	-0.001 8	899.999 3	-0.002 5	899.999 5	-0.002 3	0.000 7
Posición 4, diagonal con orientación (0,0,0) a (1,1,1)							
19.999 1	19.999 8	0.000 7	19.999 5	0.000 4	20.000 3	0.001 2	0.000 8
99.873 4	99.872 2	-0.001 2	99.872 3	-0.001 1	99.871 6	-0.001 8	0.000 7
299.933 8	299.931 9	-0.001 9	299.932 2	-0.001 6	299.931 6	-0.002 2	0.000 6
499.875 0	499.872 5	-0.002 5	499.872 4	-0.002 6	499.871 9	-0.003 1	0.000 6
699.933 5	699.930 8	-0.002 7	699.929 9	-0.003 6	699.931 2	-0.002 3	0.001 3
900.001 8	899.999 0	-0.002 8	899.999 3	-0.002 5	899.999 9	-0.001 9	0.000 9

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS











Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18.
En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente.
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18.
In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid.
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").
"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"



Información gráfica del error de medición de longitud E_0

Graphic information of length error E_0

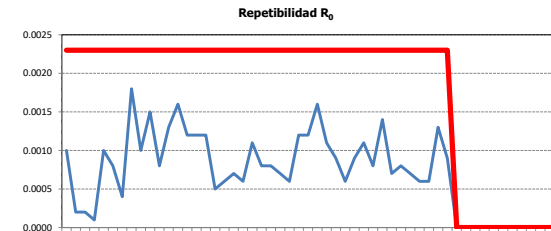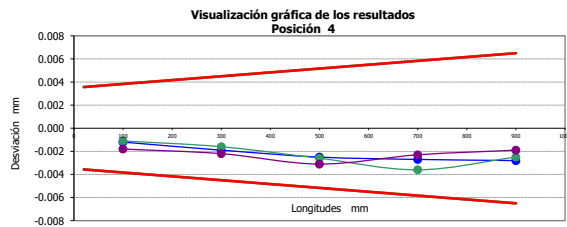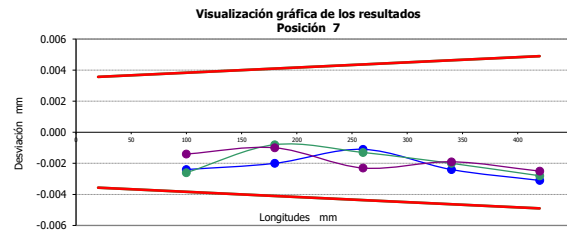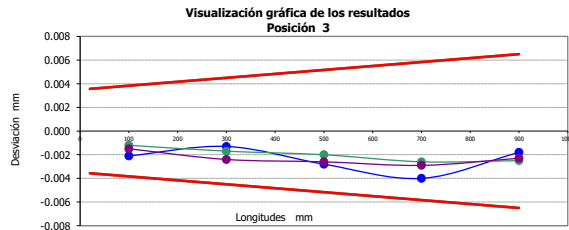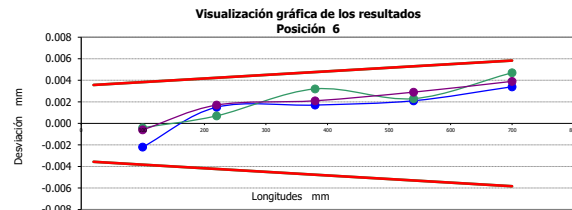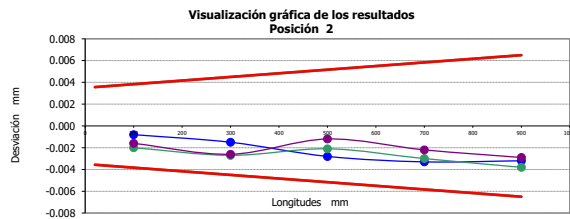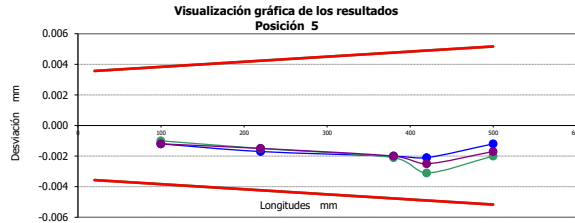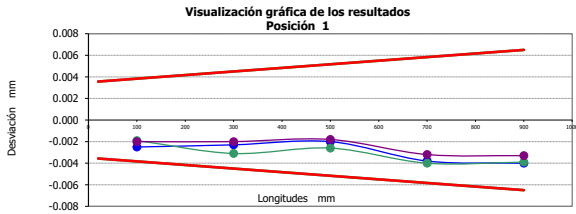

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18.
En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente.
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18.
In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid.
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)
"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"



Error de medición de longitud E_{150}



Length error E_{150}

Todos los resultados se expresan en mm

Longitud Patrón	1 era medición	E_{L1}	2 da medición	E_{L2}	3 era medición	E_{L3}	Repetibilidad
Posición 1A ZX, Diagonal 1 con L=150							
19.999 1	19.999 3	0.000 2	19.998 3	-0.000 8	19.998 6	-0.000 5	0.001 0
99.873 4	99.872 4	-0.001 0	99.872 6	-0.000 8	99.871 8	-0.001 6	0.000 8
219.929 6	219.927 3	-0.002 3	219.927 7	-0.001 9	219.927 1	-0.002 5	0.000 6
379.883 1	379.880 9	-0.002 2	379.880 0	-0.003 1	379.881 1	-0.002 0	0.001 1
539.851 2	539.848 0	-0.003 2	539.848 2	-0.003 0	539.848 8	-0.002 4	0.000 8
699.933 5	699.929 4	-0.004 1	699.928 9	-0.004 6	699.929 7	-0.003 8	0.000 8
Posición 2A ZY, Diagonal 2 con L=150							
19.999 1	19.997 6	-0.001 5	19.998 1	-0.001 0	19.998 6	-0.000 5	0.001 0
99.873 4	99.871 2	-0.002 2	99.871 9	-0.001 5	99.871 6	-0.001 8	0.000 7
299.933 8	299.932 2	-0.001 6	299.932 0	-0.001 8	299.932 8	-0.001 0	0.000 8
499.875 0	499.872 1	-0.002 9	499.872 8	-0.002 2	499.871 5	-0.003 5	0.001 3
699.933 5	699.931 7	-0.001 8	699.930 9	-0.002 6	699.931 2	-0.002 3	0.000 8
900.001 8	899.998 3	-0.003 5	899.997 8	-0.004 0	899.997 6	-0.004 2	0.000 7

Información gráfica del error de medición de longitud E_{150}

Graphic information of length error E_{150}

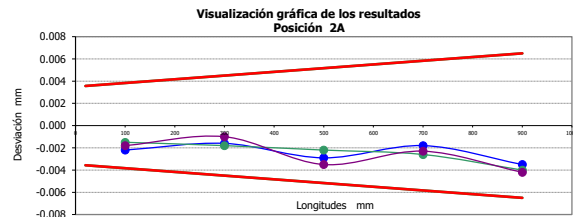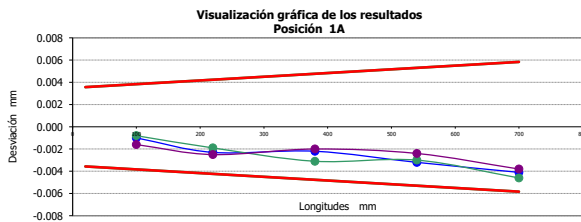

Error de palpado $P_{Form.Sph.1x25.SS.Tact}$
Probing error

(0.0042 ± 0.0002) mm

Error de palpado $P_{Size.Sph.1x25.SS.Tact}$
Probing error

(0.0032 ± 0.00068) mm

Requerimientos especiales (Special requirements)

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18.
En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente.
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18.
In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid.
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)
"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

FIN DE DOCUMENTO.



Patrón Nacional de Longitud
CENAM: CNM-PNM-2

PATRÓN PRIMARIO: CENAM

Regla de pasos KOBÁ
No. de serie: 201311 MB244
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-416/2020

Máquina de Medición por Coordenadas
Marca: Mitutoyo
Modelo: Legex 9106
No. de serie: 30155141
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-021/2022

Bloque patrón 20 mm
No. Serie: 997067
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-221/2019

Regla de pasos KOBÁ
No. de serie: 970410/102K
Certificado de Calibración D-K:
D-K-15007-01-00 28756 2022-09

Máquina de Medición por Coordenadas
Marca: Mitutoyo
Modelo: Legex 9106
No. de serie: 30155141
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-021/2022

Bloque patrón 20 mm
No. Serie: 997067
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-440/2023

PATRONES DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADOS POR: CENAM/ D-K

Regla de Pasos
ID: MESS-P-KOB-31
Marca: Industrie - Team - Service GmbH
Modelo: 300 mm
Serie: SE 0300169
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-630-2022
Alcance calibrado:
0.000 mm a 300.000 mm
Incertidumbre:
U= (0.25 + 0.30 * L) µm, [L]= m
Vigencia: 2025-11

Regla de Pasos
ID: MESS-P-KOB-24
Marca: Kolb & Baumann
Modelo: 620 mm
Serie: 200504 S256
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-654/2022
Alcance calibrado:
0.000 mm a 620.000 mm
Incertidumbre:
U= (0.25 + 0.30 * L) µm, [L]= m
Vigencia: 2025-11

Regla de Pasos
ID: MESS-P-KOB-33
Marca: Industrie - Team - Service GmbH
Modelo: 1000 mm
Serie: SE 0700255
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-722/2022
Alcance calibrado:
0.000 mm a 1100.000 mm
Incertidumbre:
U= (0.25 + 0.30 * L) µm, [L]= m
Vigencia: 2025-12

Regla de Pasos
ID: MESS-P-KOB-34
Marca: Industrie - Team - Service GmbH
Modelo: 1500 mm
No. de serie: SE 1540113
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-721/2022
Alcance calibrado:
0.000 mm a 1500.000 mm
Incertidumbre:
U= (0.25 + 0.35 * L) µm, [L]= m
Vigencia: 2025-12

Regla de pasos
MESS-P-KOB-39
Marca: Industrie - Team - Service GmbH
Modelo: 700 mm
Serie: SE 0700255
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-057/2023
Alcance calibrado:
0.000 mm a 700.000 mm
Incertidumbre:
U= (0.25 + 0.30 * L) µm, [L]= m
Vigencia: 2026-02

Regla de pasos
MESS-P-KOB-40
Marca: Industrie - Team - Service GmbH
Modelo: 700 mm
Serie: SE0700256
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-059/2023
Alcance calibrado:
0.000 mm a 700.000 mm
Incertidumbre:
U= (0.25 + 0.30 * L) µm, [L]= m
Vigencia: 2026-02

Regla de Pasos
ID: MESS-P-KOB-32
Marca: Industrie - Team - Service GmbH
Modelo: 700 mm
Serie: SE 0700228
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-720/2022
Alcance calibrado:
0.000 mm a 700.000 mm
Incertidumbre:
U= (0.25 + 0.30 * L) µm, [L]= m
Vigencia: 2025-12

Regla de Pasos
ID: MESS-P-KOB-88
Marca: Industrie - Team - Service GmbH
Modelo: 700 mm
Serie: SE0700413
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-697/2022
Alcance calibrado:
0.000 mm a 700.000 mm
Incertidumbre:
U= (0.25 + 0.30 * L) µm, [L]= m
Vigencia: 2025-11

Regla de Pasos
ID: MESS-P-KOB-01
Marca: Kolb & Baumann
Modelo: 500 mm
Serie: SE0500301
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-450/2023
Alcance calibrado:
0.000 mm a 500.000 mm
Incertidumbre:
U= (0.25 + 0.30 * L) µm, [L]= m
Vigencia: 2026-08

Regla de pasos
MESS-P-KOB-89
Marca: Industrie - Team - Service GmbH
Modelo: 700 mm
Serie: SE0700414
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-458/2023
Alcance calibrado:
0.000 mm a 700.000 mm
Incertidumbre:
U= (0.25 + 0.30 * L) µm, [L]= m
Vigencia: 2026-08

Regla de Pasos
ID: MESS-P-KOB-09
Marca: Kolb & Baumann
Modelo: 620 mm
No. de serie: 200012 S80
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-583/2023
Alcance calibrado:
0.000 mm a 620.000 mm
Incertidumbre:
U= (0.25 + 0.30 * L) µm, [L]= m
Vigencia: 2027-10

PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR: CENAM

Regla de Pasos
ID: MESS-P-KOB-02
Marca: Industrie - Team - Service GmbH
Modelo: 700 mm
Serie: SE0700485
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-540/2023
Alcance calibrado:
0.000 mm a 700.000 mm
Incertidumbre:
U= (0.25 + 0.30 * L) µm, [L]= m
Vigencia: 2026-09

Regla de Pasos
ID: MESS-P-KOB-03
Marca: Industrie - Team - Service GmbH
Modelo: 1.100 mm
Serie: SE1100229
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-541/2023
Alcance calibrado:
0.000 mm a 1.100.000 mm
Incertidumbre:
U= (0.25 + 0.30 * L) µm, [L]= m
Vigencia: 2026-09

ITEM DEL CLIENTE

Item calibrado

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:

lp

Ing. María Guadalupe Suárez Palmirino

Revisó:

lp

Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:

César


Ing. César Ramírez García



Fecha de revisión: 2023-10-02

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. y MESS S.C Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. Tel. 01 (442) 1 96 49 38.

Prohibida la reproducción parcial o total del presente documento sin la autorización correspondiente.

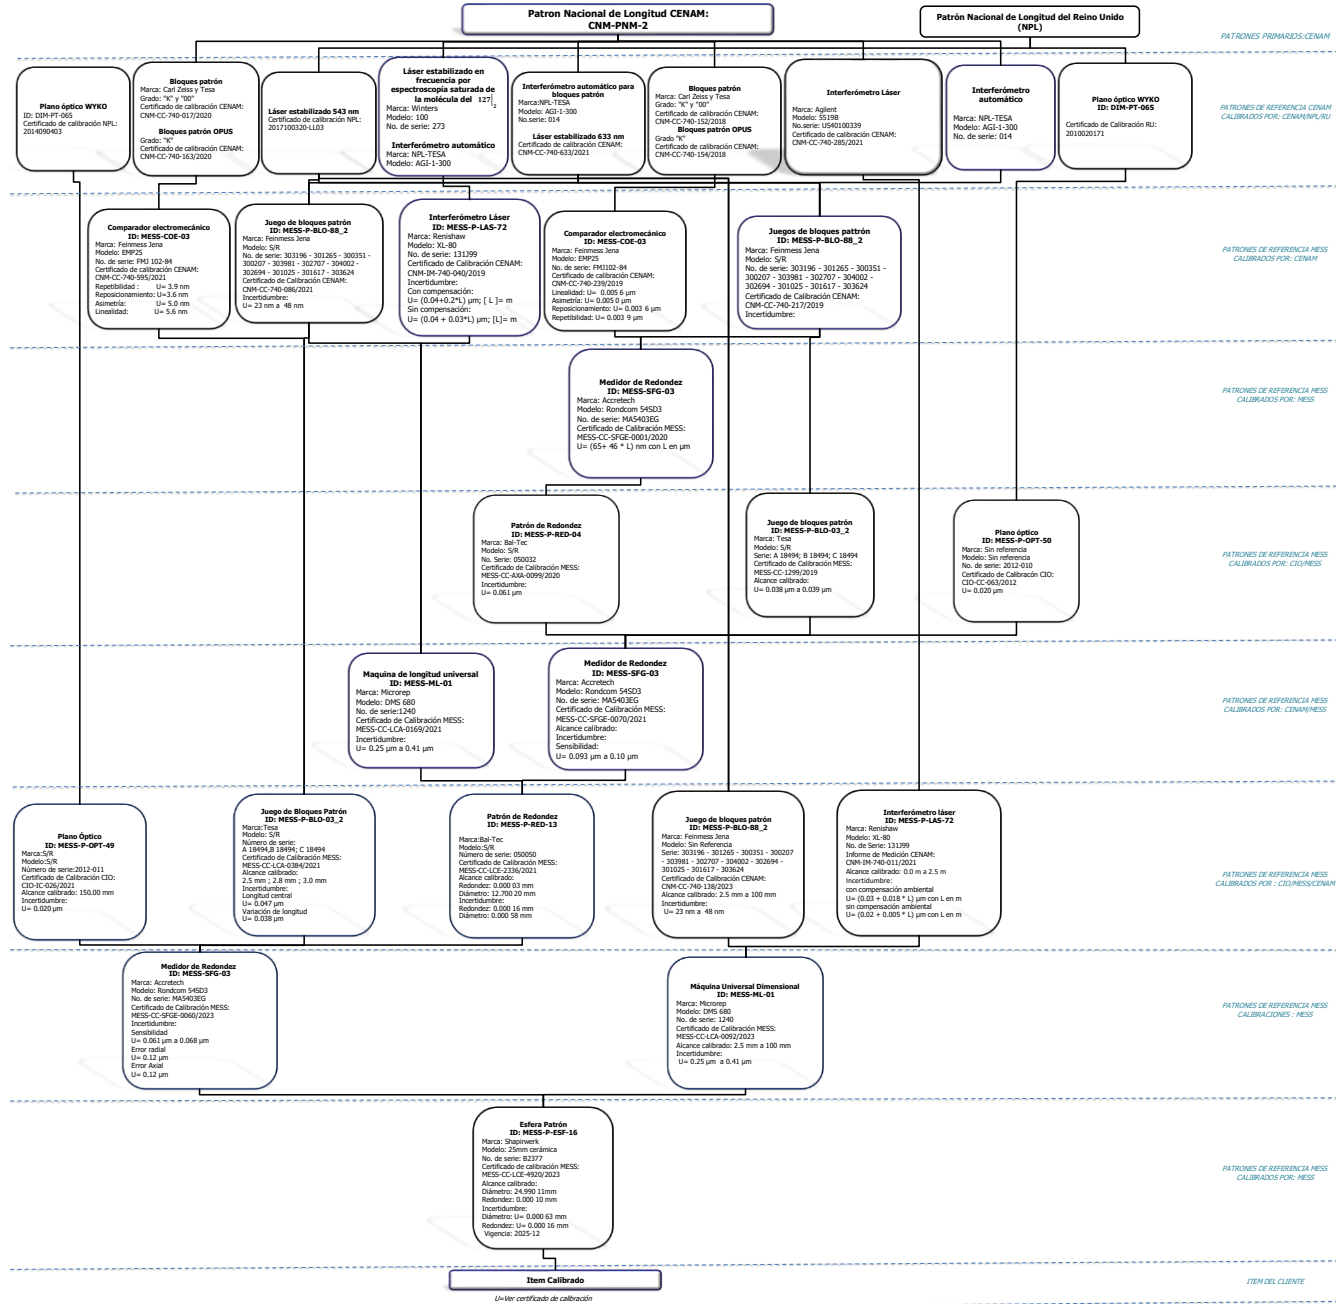

Elaboro:



Ing. María Guadalupe Solís Salazar

Revisó:



Ing. Mario de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Juan A. Escamado Secretario del cargo



Patrón Nacional de Longitud
CENAM: CNM-PNM-2

PATRÓN PRIMARIO: CENAM

CMM
Marca: Mitutoyo Legex 9106
No. de serie: 30155141
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-021/2022

Bloque patrón de 20 mm
Marca: Mitutoyo
Serie: 997067
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-240/2023

Regla de pasos KOBA
Serie: 970410/102K
Certificado de Calibración D-K:
D-K-15007-01-00 28756 2022-09

CMM
Marca: Mitutoyo Legex 9106
No. de serie: 30155141
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-021/2022

Bloque patrón de 20 mm
Marca: Mitutoyo
Serie: 997067
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-221/2019

Regla de pasos KOBA
Serie: 970410/102K
Certificado de Calibración D-K:
D-K-15007-01-00 28756 2022-09

PATRONES DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADOS POR: CENAM/ D-K

Bloque patrón
ID: MESS-P-BLO-81
Marca: Feinmess Jena
Modelo: S/R
No. de serie: 120013
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-666/2023
Alcance calibrado: 900 mm
Incertidumbre:
Longitud central: $U = 0.52 \mu\text{m}$
Vigencia: 2025-12

Bloque patrón
ID: MESS-P-BLO-08_4
Marca: Feinmess Jena
Modelo: S/R
No. serie: 170178
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-558/2023
Alcance calibrado: 1 000 mm
Incertidumbre:
Longitud central : $U = 0.55 \mu\text{m}$
Vigencia: 2025-10

Bloque patrón
ID: MESS-P-BLO-78
Marca: Feinmess Jena
Modelo: S/R
No. serie: 100035
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-556/2023
Alcance calibrado: 1 000 mm
Incertidumbre:
Longitud central :
 $U = 0.55 \mu\text{m}$
Vigencia: 2025-10

Bloque patrón
ID: MESS-P-BLO-79
Marca: Feinmess Jena
Modelo: S/R
No. serie: 100014
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-559/2023
Alcance calibrado: 1 000 mm
Incertidumbre:
Longitud central : $U = 0.55 \mu\text{m}$
Vigencia: 2025-10

Bloque patrón
ID: MESS-P-BLO-80
Marca: Feinmess Jena
Modelo: S/R
No. de serie: 100073
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-550/2023
Alcance calibrado: 1 000 mm
Incertidumbre:
Longitud central: $U = 0.55 \mu\text{m}$
Vigencia: 2025-09

Bloque patrón
ID: MESS-P-BLO-77
Marca: Feinmess Jena
Modelo: S/R
No. serie: 100017
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-297/2023
Alcance calibrado: 1 000 mm
Incertidumbre:
Longitud central: $U = 0.55 \mu\text{m}$
Vigencia: 2025-05

PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR: CENAM

Item calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:

Ing. Maria Guadalupe Suárez Palomino

Revisó:

Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:

Ing. César Ramírez García



Fecha de revisión: 2023-12-21