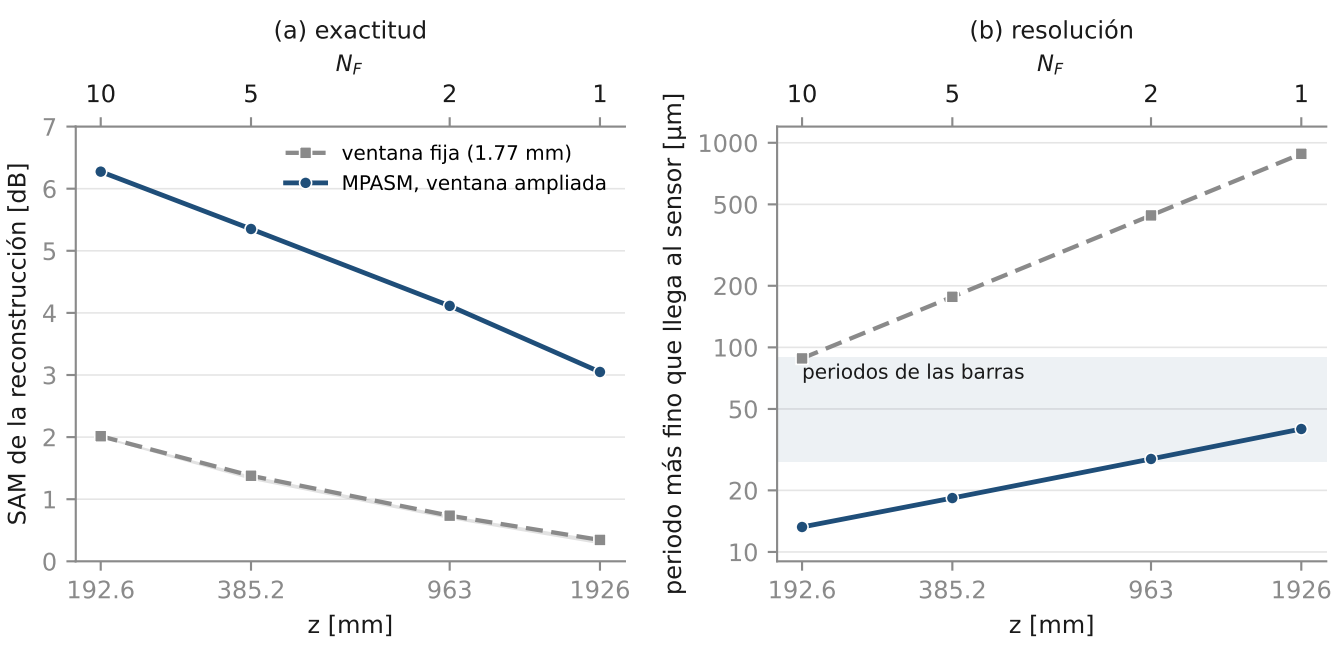
(a) exactitud
N_F
10
5
2
1
SAM de la reconstrucción [dB]
0
1
2
3
4
5
6
7
ventana fija (1.77 mm)
MPASM, ventana ampliada
192.6
385.2
963
1926
z [mm]
(b) resolución
N_F
10
5
2
1
periodo más fino que llega al sensor [µm]
1000
500
200
100
50
20
10
periodos de las barras
192.6
385.2
963
1926
z [mm]