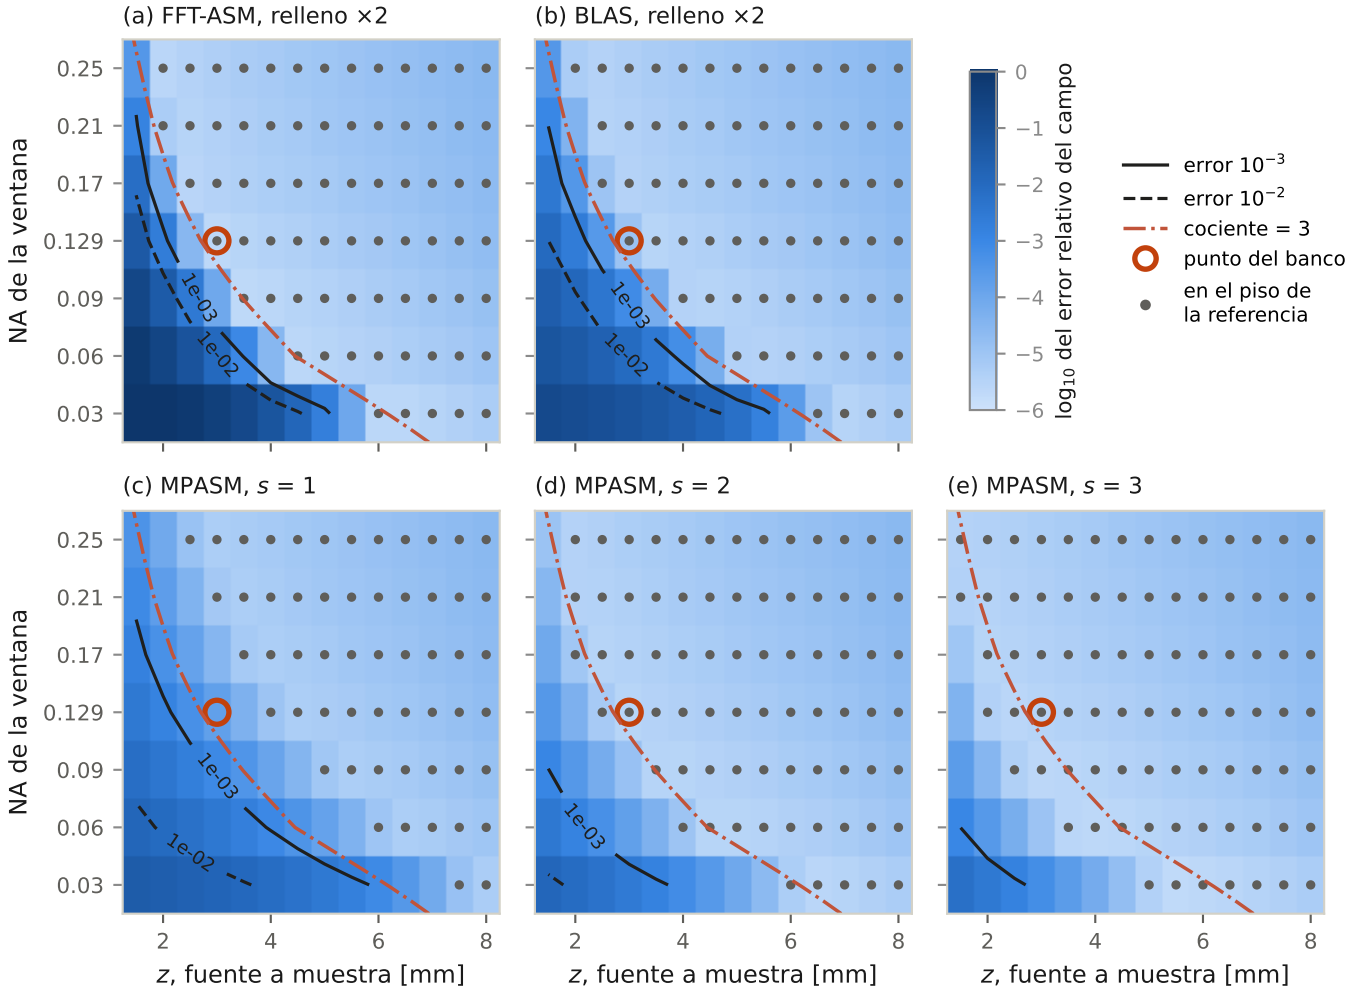
(a) FFT-ASM, relleno ×2
(b) BLAS, relleno ×2
(c) MPASM, s = 1
(d) MPASM, s = 2
(e) MPASM, s = 3
NA de la ventana
0.25
0.21
0.17
0.129
0.09
0.06
0.03
1e-03
1e-02
2
4
6
8
z, fuente a muestra [mm]
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
$\log_{10}$ del error relativo del campo
error 10^{-3}
error 10^{-2}
cociente = 3
punto del banco
en el piso de la referencia