



Protocolo de LTD: El protocolo LTD está compuesto por una señal bifásica simétrica de ancho de pulso de $250\mu\text{s}$ y una frecuencia de 2Hz durante 16 minutos.

Señal trigger: Señal que genera un pulso de 0V durante $500\mu\text{s}$ y después pasa a 5V que se debe activar cuando se inicia el primer pulso del protocolo LTD y al finalizar el último pulso del protocolo LTD

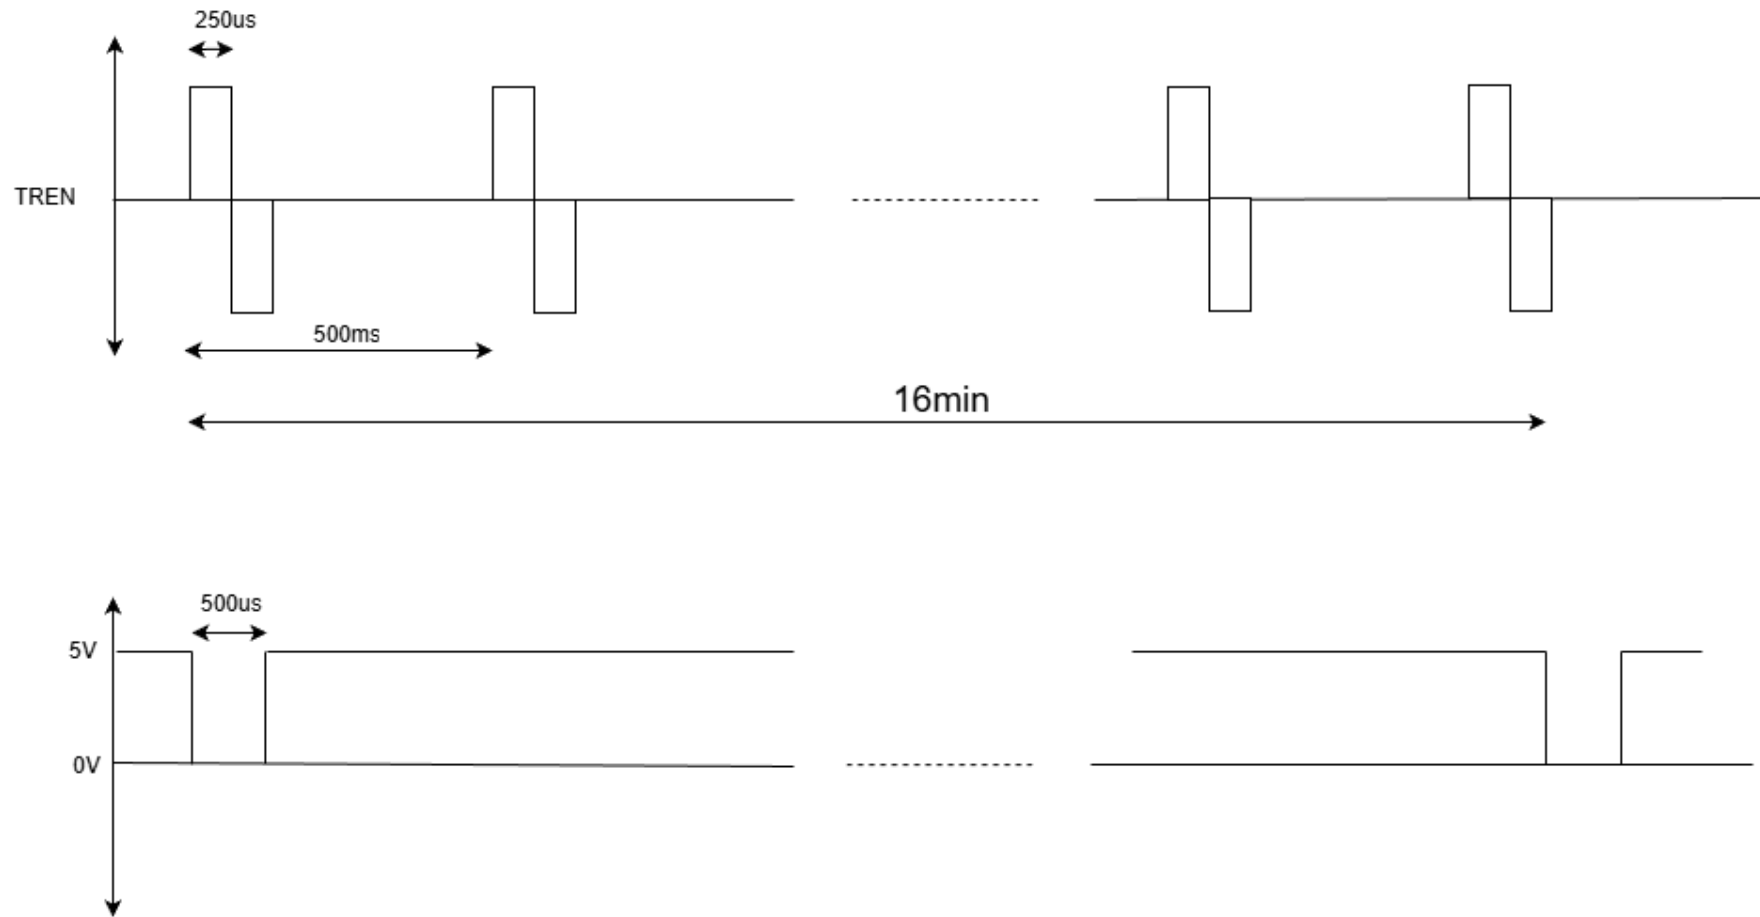

Protocolo de LTP: El protocolo LTP está compuesto por una señal bifásica simétrica de ancho de pulso de $250\mu\text{s}$ y una frecuencia de 100Hz durante 5 segundos después hay 55 segundos sin estimulación y esta secuencia se repite 5 veces.

Señal trigger: Señal que genera un pulso de 0V durante $500\mu\text{s}$ y después pasa a 5V que se debe activar cuando se inicia el primer pulso de cada secuencia del protocolo LTP y al finalizar el último pulso de cada secuencia.

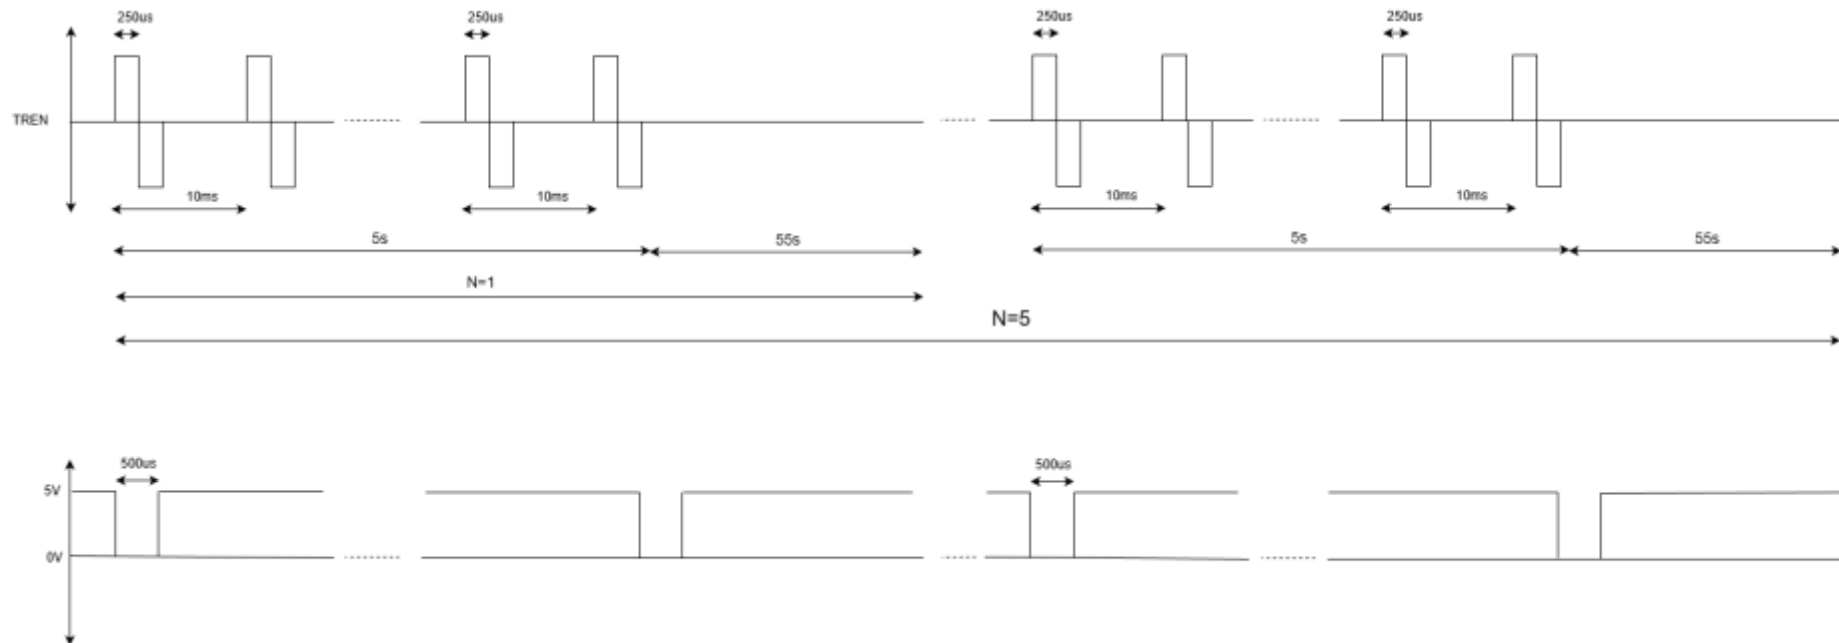

Protocolo de ThetaBurst: El protocolo TB está compuesto por una ráfaga formada por 4 pulsos simétricos ($PW=500\mu s$) separados 10ms. A partir de la ráfaga se conforma un tren compuesto por 10 ráfagas separadas 200ms. Y finalmente se conforma la señal thetaBurst con 40 trenes separados 10s.

Señal trigger: Señal que genera un pulso de 0V durante $500\mu s$ y después pasa a 5V que se debe activar cuando se inicia el primer pulso de cada burst del protocolo TB y al finalizar el último pulso de cada burst.

