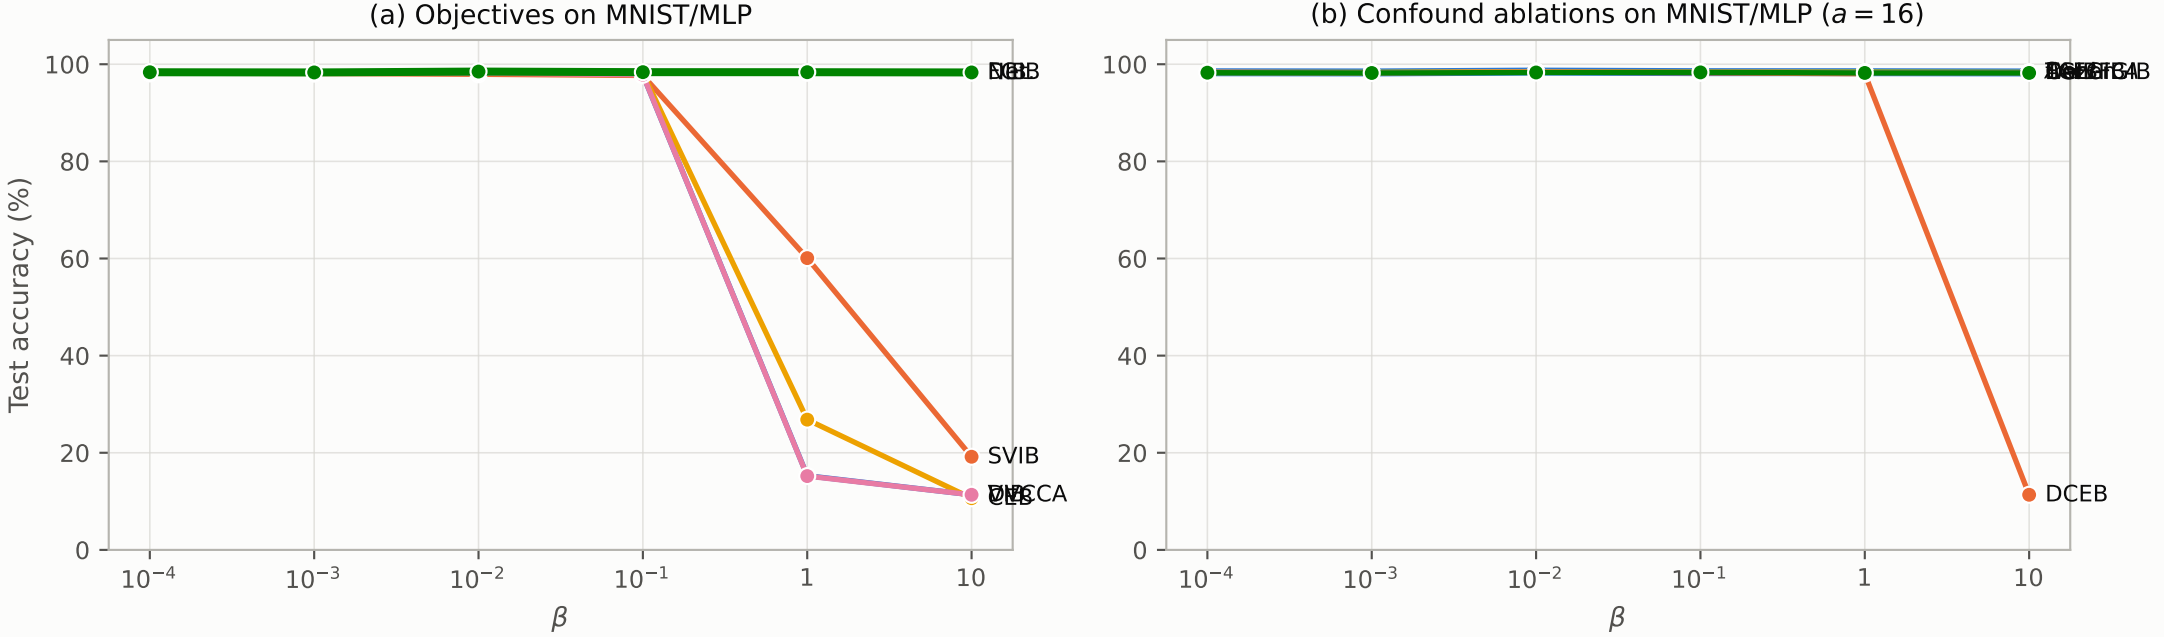
(a) Objectives on MNIST/MLP
Test accuracy (%)
100
80
60
40
20
0
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
1
10
β
SVIB
DCEB
(b) Confound ablations on MNIST/MLP ($a = 16$)
DCEB
β