de

BD Microtainer®

Blutentnahmeröhrchen zur chemischen Analyse





REF 365964 REF 365966 REF 365968 REF 365979 REF 365986 REF 365988 REF 365993

VERWENDUNGSZWECK

BD Microtainer® Blutentnahmeröhrchen sind nicht steril und zur einmaligen Verwendung für die In-vitro-Diagnostik vorgesehen. Sie sind für die Verwendung durch geschultes medizinisches Fachpersonal zur Entnahme, Lagerung und zum Transport menschlicher Kapillarblutproben und die anschließende Trennung von Serum oder Plasma durch Zentrifugation für diagnostische In-vitro-Testungen vorgesehen.

BD Microtainer® SST™, BD Microtainer® PST™, BD Microtainer® Serum und BD Microtainer® Lithium-Heparin-Blutententnahmeröhrchen werden für chemische Tests oder für andere Tests verwendet, bei denen nach Anweisungen des Labors eine Serum- oder Plasmaprobe erforderlich ist.

BD Microtainer® Fluorid-Blutentnahmeröhrchen werden für die Bestimmung von Glukose oder für andere Tests verwendet, bei denen nach Anweisungen des Labors eine Plasma- oder Vollblutprobe erforderlich ist.

PRODUKTBESCHREIBUNG

BD Microtainer® Blutentnahmeröhrchen bestehen aus einem Kunststoffreservoir und einem farbcodierten BD Microgard™ Verschluss. Die Röhrchen enthalten je nach gewünschter Probe und Anforderungen der analytischen Testmethode verschiedene Zusatzstoffe. Die Produktkonfigurationen finden Sie in Tabelle A. Markierungen auf dem Reservoir zeigen die Füllstände an. Der obere Rand des Reservoirs dient als Probensammler.

Serumröhrchen

BD Microtainer® Z (kein Zusatzstoff) Blutentnahmeröhrchen und BD Microtainer® SST™ Blutentnahmeröhrchen verfügen über eine Silikonbeschichtung an den Wänden des Röhrchens, um die Haftung von roten Blutkörperchen zu reduzieren.

BD Microtainer® SST™ Blutentnahmeröhrchen sind mit mikronisierten Silikapartikeln beschichtet, um die Gerinnung zu beschleunigen. Diese Beschichtung kann weiß bis leicht milchig aussehen. Am Boden des Röhrchens befindet sich ein Trenngel. Die Dichte dieses Materials bewirkt, dass es sich während der Zentrifugation nach oben bewegt, um an die Gerinnungsgrenze des Serums zu gelangen. Dort bildet es eine Barriere, die Serum von Fibrin und Zellen trennt.

Plasmaröhrchen

BD Microtainer® Lithium-Heparin-Blutentnahmeröhrchen und BD Microtainer® PST™ Blutentnahmeröhrchen enthalten ein Lithium-Heparin-Zusatzstoff (LH) für die Antikoagulation des angegebenen Volumens an Kapillarblut.

BD Microtainer® PST™ Blutentnahmeröhrchen enthalten ein Trenngel am Boden des Röhrchens. Die Dichte dieses Materials bewirkt, dass es sich während der Zentrifugation nach oben bewegt, um an die Oberfläche des Plasmas zu gelangen. Dort bildet es eine Barriere, die Plasma von Blutzellen trennt.

BD Microtainer® Fluorid-Blutentnahmeröhrchen enthalten den Zusatzstoff Natriumfluorid/Dinatrium EDTA (FE). Na_2EDTA bewirkt eine Antikoagulation der Probe, während Natriumfluorid als glykolytischer Hemmer wirkt.

Gelbe Röhrchen

Gelbe BD Microtainer® SST™ und PST™ Blutentnahmeröhrchen reduzieren die Lichtdurchlässigkeit signifikant und werden verwendet, wenn ein Schutz für lichtempfindliche Analyte erforderlich ist.

Verlängerungshülse (Optional)

Das Röhrchen kann mit der optionalen BD Microtainer® Verlängerungshülse (Bestellnummer 368933) verwendet werden. Die Verlängerungshülse passt in den Boden des Röhrchens und erhöht die Länge auf etwa 75 Millimeter (mm). Mit dieser Verlängerungshülse passt das Röhrchen in ein Standard-Reagenzglasgestell von 13 x 75 mm. Die Verlängerungshülse bietet auch eine größere Fläche für die Probenbeschriftung.




TABELLE A

Produkt	Röhrchentyp	Füllvolumen (µL)	Zusatzstoff	Farbe des BD Microgard™ Verschlusses
Serumröhrchen				
Z (kein Zusatzstoff)	Durchsichtiges Reservoir	250–500	Kein(e)	Rot
BD SST™	Durchsichtiges Reservoir	400–600	Gerinnungsaktivator und Gelbarriere	Gold
	Gelbes Reservoir			
Plasmaröhrchen				
Lithium-Heparin	Durchsichtiges Reservoir	200–400	Lithium-Heparin (LH)	Grün
BD PST™	Durchsichtiges Reservoir	400–600	Lithium-Heparin (LH) und Gelbarriere	Hellgrün
	Gelbes Reservoir			
Fluorid	Durchsichtiges Reservoir		Natriumfluorid/ Dinatrium EDTA (FE)	Grau

EIGENSCHAFTEN

1. BD Microtainer® Blutentnahmeröhrchen sind mit folgenden Komponenten ausgestattet:
   - integrierte Blutaufnahmeöffnung, die den Blutfluss in das Röhrchen erleichtert;
   - Markierungen zur Angabe der Füllvolumina gemäß Tabelle A;
   - Verschluss, der eng über der oberen Kante des Röhrchens liegt, um das Risiko eines Probenkontakts beim Entfernen der Kappe zu verringern.
2. BD Microtainer® Fluorid-Blutentnahmeröhrchen hemmen die Glykolyse bei Raumtemperatur bis zu 24 Stunden lang.
3. Das gelbe Röhrenreservoir reduziert die Lichtdurchlässigkeit erheblich und wird verwendet, wenn ein Schutz für lichtempfindliche Analyte erforderlich ist.

EINSCHRÄNKUNGEN DES SYSTEMS

1. Konzentrationen/Aktivitäten chemischer Analyten in Serum oder Plasma, die aus Kapillarproben gewonnen werden, können von den Konzentrationen/Aktivitäten von Analyten in Serum oder Plasma, die aus venösen Proben gewonnen werden, abweichen.[1] Das Labor sollte beurteilen, ob diese Unterschiede beim Wechsel zwischen kapillaren und venösen Blutproben klinisch relevant sein können.
2. Um ein geeignetes Blut-Zusatzstoff-Verhältnis für eine angemessene Mischung und genaue Testergebnisse zu gewährleisten, muss die Blutfüllmenge innerhalb des angegebenen Bereichs liegen.
3. Bei Röhrchen, die für die Erzeugung von Serum oder Plasma für Tests zentrifugiert werden, werden die Erythrozyten unter normalen Verarbeitungsbedingungen ggf. nicht vollständig sedimentiert. Der erythrozytenbasierte Stoffwechsel sowie die natürliche Zersetzung ex vivo können die Plasma-Analytkonzentrationen/-Aktivitäten nach dem Zentrifugieren beeinträchtigen.
4. Die Stabilität der Analyten sollte bezüglich der Lagerbehälter und der Bedingungen des jeweiligen Labors beurteilt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Fremdkörper vorhanden sind oder das Röhrchen beschädigt ist.
2. Das Serum oder Plasma sollte innerhalb von 2 Stunden nach der Entnahme von den Zellen getrennt werden, um falsche Testergebnisse zu vermeiden, es sei denn, es liegt ein eindeutiger Nachweis vor, dass längere Kontaktzeiten nicht zu Ergebnisfehlern beitragen.
3. Befolgen Sie die Verfahren Ihrer Einrichtung, wenn Gerinnsel oder andere sichtbare Hindernisse in der Probe vorhanden sind. Dies kann dazu führen, dass die Probe nicht getestet werden kann.
4. Wenn für einen bestimmten Blutlabortest der Typ, die Größe, die Handhabung, die Verarbeitung oder die Lagerbedingungen des Sammelröhrchens eines Herstellers gewechselt werden, sollte das Laborpersonal die Daten des Herstellers des Röhrchens mit den eigenen Daten vergleichen, um den Referenzbereich für

ein spezifisches Instrument/Reagenz zu bestimmen bzw. zu überprüfen. Auf Grundlage dieser Informationen kann das Labor dann entscheiden, ob Änderungen angebracht sind.

VORSICHT

1. Befolgen Sie die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen. Verwenden Sie Handschuhe, Kittel, Augenschutz und andere persönliche Schutzausrüstung sowie technische Vorrichtungen zum Schutz vor Blutspritzern, Blutleckagen und einer möglichen Exposition gegenüber hämatogenen Pathogenen.
2. Alle biologischen Proben und spitzen/scharfen Instrumente zur Blutentnahme (Lanzetten) sind entsprechend den Richtlinien und Verfahren Ihrer Einrichtung zu handhaben. Sorgen Sie für entsprechende ärztliche Hilfe, sollte es zu einer Exposition gegenüber den biologischen Proben kommen (bspw. durch eine Verletzung bei der Punktion), da durch diese virale Hepatitis, HIV (AIDS) oder andere Infektionskrankheiten übertragen werden können. Verwenden Sie einen integrierten Kanülenschutz, falls das Blutentnahmesystem einen solchen aufweist. Die Richtlinien und Verfahren Ihrer Einrichtung können jedoch abweichen und müssen stets befolgt werden.
3. Sämtliche spitzen/scharfen Instrumente zur Blutentnahme sind in Behältern für biogefährlichen Abfall zu entsorgen, die für diesen Zweck zugelassen sind.
4. Über- oder Unterbefüllen der Röhrchen führt zu einem falschen Blut-Zusatzstoff-Verhältnis und damit möglicherweise zu falschen Analyseergebnissen oder einer schlechten Produktleistung.
5. Endotoxin wird nicht kontrolliert. Blut und Blutkomponenten, die in diesem Röhrchen entnommen und verarbeitet werden, sind nicht für die Infusion oder das Einführen in den menschlichen Körper vorgesehen.
6. Alle biologischen Proben und Materialien gelten als biologisch gefährlich und sollten mit Vorsicht behandelt werden, da das Risiko einer Übertragung von Infektionen besteht. Entsorgen Sie medizinischen Abfall mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen gemäß den bundesweit, landesweit und örtlich geltenden Vorschriften. Pipettieren Sie niemals mit dem Mund. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, Schutzbrille und Handschuhe.

Hinweis: Nur in der EU: Schwerwiegende Vorkommnisse in Verbindung mit dem Medizinprodukt sind vom Anwender dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden. Außerhalb der EU: Wenden Sie sich an Ihre zuständige BD-Vertretung, wenn Sie einen Vorfall im Zusammenhang mit diesem Produkt melden möchten oder eine Frage zu diesem Produkt haben.

GEFAHR

Natriumfluorid (NaF), CAS-Nummer: 7681-49-4

REF 365993



H301 Giftig bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. **P280**Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P301+P310** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **P330** Mund ausspülen. **P332+P313** Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P362+P364** Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. **P337+P313** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P501** Inhalt/Behälter gemäß entsprechenden Gesetzen und Vorschriften sowie Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der Entsorgung einer geeigneten Behandlung und Entsorgungseinrichtung zuführen.

LAGERUNG

Röhrchen unter 25 °C lagern. Röhrchen nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Wenn das Verfallsdatum auf dem Röhrchen nicht lesbar ist, greifen Sie auf den Polybeutel, das Etikett der Verpackung oder den Barcode zurück. Wenn das Verfallsdatum nicht bestimmt werden kann, verwenden Sie das Röhrchen nicht.

PROBENENTNAHME UND -HANDHABUNG

VOR DURCHFÜHRUNG DER BLUTENTNAHME DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOLLSTÄNDIG LESEN.

Mitgelieferte erforderliche Materialien für die Probenentnahme
BD Microtainer® Blutentnahmeröhrchen.


Erforderliche Ausrüstung, die nicht für die Probenentnahme bereitgestellt wird
1. Persönliche Schutzausrüstung, die zum Schutz vor Kontakt mit hämatogenen Pathogenen erforderlich ist.
2. Lanzette, die für die Stelle und das Blutvolumen geeignet ist.
3. Reinigungstuch.
4. Mulltupfer und ein zugelassener Behälter für biogefährliche Abfälle.

Optionale Ausrüstung, die nicht für die Probenentnahme bereitgestellt wird
1. Wärmevorrichtung.
2. Pflaster. Vermeiden Sie Verbände bei Patienten, die dazu neigen Finger oder Füße in den Mund zu stecken, da es zu Verschlucken/Aspiration kommen kann.


GEBRAUCHSANWEISUNG

BEI DER KAPILLARENENTNAHME UND BEI DER HANDHABUNG DER BLUTENTNAHMERÖHRCHEN HANDSCHUHE TRAGEN, UM DIE GEFAHR EINER EXPOSITION ZU MINIMIEREN

1. Reihenfolge der Entnahme: Die folgende Entnahmereihenfolge wird für Mikroentnahmeröhrchen empfohlen, wenn mehrere Proben für medizinische Laboruntersuchungen während einer einzigen Kapillarpunktion entnommen werden.
    1. Kapillarblutgas
    2. EDTA-Röhrchen
    3. Andere Röhrchen mit Zusatzstoffen
    4. Röhrchen ohne Zusatzstoffe
    5. Filterpapier für die Sammlung von Trockenblut
2. Punktionsstelle auswählen, gegebenenfalls anwärmen.
3. Die Stelle reinigen und lufttrocknen lassen. Nicht durch Abwischen trocknen, da die Desinfektion während der Lufttrocknung erfolgt.
4. Den Verschluss vom Röhrchen entfernen, und ihn auf eine geeignete Oberfläche legen.
5. Die Haut gemäß den Anweisungen des Herstellers mit der entsprechenden Lanzette punktieren.

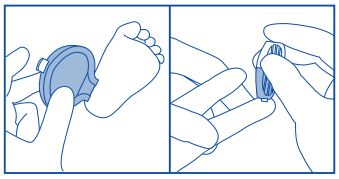


6. Die gebrauchte Lanzette in einem zugelassenen Behälter für biogefährlichen Abfall und scharfe Gegenstände entsorgen.
7. Den ersten Bluttropfen mit Mull abwischen. Das BD Microtainer® Röhrchen angewinkelt zur Oberfläche der Punktionsstelle halten. Mit der integrierten Blutaufnahmeöffnung den Bluttropfen berühren.

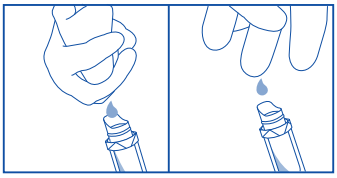


Bei der Entnahme der Blutprobe nicht über die Hautoberfläche schaben. Nach der Entnahme von zwei oder drei Tropfen fließt das Blut frei an der Innenwand des Röhrchens entlang. **VORSICHT:** Das „Melken" der Einstichstelle kann Hämolyse verursachen und die Genauigkeit der Testergebnisse negativ beeinflussen.


8. Der Füllstand des Röhrchens muss zwischen den Markierungen liegen, um ein angemessenes Blut-Zusatzstoff-Verhältnis zu erreichen.



9. Den Verschluss wieder schließen, indem die Kappe nach unten gedreht und gedrückt wird, bis sie hörbar einrastet.
10. Die Probe sofort nach der Entnahme mischen, indem die gefüllten BD Microtainer® SST™ Blutentnahmeröhrchen mindestens 5 Mal und Plasmaröhrchen 8–10 Mal umgedreht werden.

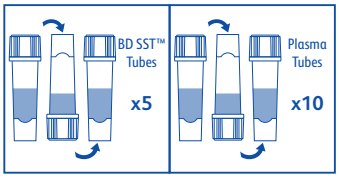

11. Zu Erinnerung: Die gebrauchte Lanzette in einem zugelassenen Behältern für biogefährlichen Abfall und scharfe Gegenstände entsorgen. Alle kontaminierten Materialien in einem geeigneten Behälter entsorgen.



TRENNVERFAHREN FÜR SERUM/PLASMA

1. Serumtrennung: Das Blut mindestens 30 Minuten lang gerinnen lassen.
2. Die Probe nach Bedarf in die Zentrifuge oder in den Zentrifugenadapter stellen, und dabei darauf achten, das System auszugleichen.

3. Wie folgt zentrifugieren:
   RZB hängt mit der Einstellung der Zentrifugendrehzahl (U/min) unter Verwendung der folgenden Gleichung zusammen:

$$rpm = \sqrt{\frac{RCF \times 10^5}{1.12 \times r}}$$

Dabei ist „r“ der radiale Abstand von der Mitte des Zentrifugenkopfes zum Boden des Röhrchens in cm.

Empfohlene RZB und Zeit der Zentrifugation		
Produkt	**RZB**	**Zeit**
Röhrchen mit Gel	6000–15000 g	90 Sekunden
Röhrchen ohne Gel	Mindestens 2000 g	3 Minuten

RZB = Relative Zentrifugalbeschleunigung, g's

Hinweis: Die Verwendung alternativer Zentrifugationsbedingungen kann ebenfalls eine akzeptable Leistung erbringen; dies sollte vom Labor überprüft und validiert werden.

4. Röhrchen aus der Zentrifuge entfernen. Das Serum/Plasma ist einsatzbereit und kann direkt in den Analysenbecher pipettiert werden.

VORSICHT BEI DER ZENTRIFUGATION

- Die Anweisungen zur Desinfektion sind der Bedienungsanleitung der Zentrifuge zu entnehmen.
- Stets geeignete Becher oder Einsätze verwenden. Zentrifugenbecher oder -einsätze sollten die entsprechende Größe für die verwendeten Röhrchen haben.
- Die Verwendung von Röhrchen mit Rissen oder Absplitterungen oder einer übermäßigen Zentrifugationsgeschwindigkeit kann zu einem Röhrchenbruch führen, wobei Probe, Tröpfchen und Aerosol in die Zentrifugentrommel gelangen können. Die Freisetzung dieser potenziell gefährlichen Materialien kann durch die Verwendung speziell konstruierter, luftdicht verschlossener Behälter vermieden werden, in denen die Röhrchen während der Zentrifugation gehalten werden.
- Achten Sie darauf, dass die Röhrchen ordnungsgemäß im Röhrchenträger der Zentrifuge sitzen. Eine inkorrekte Platzierung kann dazu führen, dass das Röhrchen über den Röhrchenträger hinausragt. Röhrchen, die über den Röhrchenträger hinausragen, können sich möglicherweise am Zentrifugenkopf verfangen und zerbrechen.
- Ordnen Sie die Röhrchen zu ähnlichen Röhrchen zu (Füllvolumen, Röhrchentyp, Röhrchengröße).
- Achten Sie darauf, dass sich die Zentrifuge stets im Stillstand befindet, bevor die Röhrchen entfernt werden.
- Wenn der Zentrifugenkopf zum Stillstand gekommen ist, den Deckel öffnen und den Inhalt auf zerbrochene Röhrchen prüfen.
- Wenn sich ein Bruch andeutet, verwenden Sie ein mechanisches Instrument wie eine Zange oder eine Arterienklemme, um die Röhrchen zu entfernen.


Information zur Barriere des Trenngels

Die Fließeigenschaften des Barrierematerials sind temperaturabhängig. Der Fluss kann beeinträchtigt werden, wenn das Röhrchen vor oder während der Zentrifugation gekühlt wurde. Die gekühlten Zentrifugen auf 25 °C einstellen, um den Fluss zu optimieren und eine Erwärmung während der Zentrifugation zu vermeiden.

Sobald sich eine Barriere gebildet hat, sollten die Röhrchen nicht erneut zentrifugiert werden.

Anweisungen zum Entfernen und Wiedereinsetzen des BD Microgard™ Verschlusses

Um den Verschluss zu entfernen, den gerippten Rand greifen und beim Abziehen drehen. Um den Verschluss wieder einzusetzen, den Deckel nach unten auf den Behälter drücken, bis er hörbar einrastet.



ANALYTISCHE ÄQUIVALENZ

Für die BD Microtainer® Blutentnahmeröhrchen wurden Bewertungen für eine Vielzahl von Analyten mit verschiedenen Testmethoden und Zeitspannen durchgeführt. BD Life Sciences – Integrated Diagnostic Solutions steht für die Beantwortung von Fragen zu diesen Studien zur Verfügung. Dort erhalten Sie Referenzen und technische Berichte zu den Beurteilungen sowie weiterführende Informationen zur Verwendung der BD Microtainer® Blutentnahmeröhrchen mit Ihrem Instrument/Reagenziensystem.

REFERENZEN

1. CLSI Document GP42-ED7:2020. Collection of Capillary Blood Specimens; approved standard, 7th edition. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020.
2. CLSI Document GP39-A6:2010. Tubes and Additives for Venous and Capillary Blood Specimen Collection; approved standard, 6th edition. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2010.

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Technischer Kundendienst und Support: Wenden Sie sich an Ihren BD-Vertreter vor Ort oder an bd.com.

Bisherige Änderungen

Version	Datum	Zusammenfassung der Änderungen
01	2022-02	Erste IVDR-Ausgabe

SYMBOL-ERKLÄRUNGEN [L006715(06) 2021-08]

Einige der unten aufgelisteten Symbole treffen möglicherweise nicht auf dieses Produkt zu.

Nur für Kunden in den USA: Symbol-Erklärungen finden Sie unter **bd.com/symbols-glossary**.

Symbol	Bedeutung
	Hersteller
EC REP	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
CH REP	Bevollmächtigter in der Schweiz
	Herstellungsdatum
	Verfallsdatum
LOT	Loscode
REF	Bestellnummer
SN	Seriennummer
STERILE	Steril
STERILE A	Sterilisation durch Anwendung aseptischer Verfahrenstechniken
STERILE EO	Sterilisation mit Ethylenoxid
STERILE R	Sterilisation durch Bestrahlung
STERILE	Sterilisation mit Dampf oder trockener Hitze
	Nicht wieder sterilisieren
NON STERILE	Nicht steril
	Inhalt bei beschädigter Packung nicht verwenden und *Gebrauchsanweisung* beachten
STERILE	Steriler Flüssigkeitspfad
STERILE EO	Steriler Flüssigkeitspfad (Ethylenoxid)
STERILE R	Steriler Flüssigkeitspfad (Bestrahlung)
	Zerbrechlich, mit Sorgfalt behandeln
	Vor Sonneneinstrahlung schützen
	Vor Nässe schützen
	Temperaturuntergrenze
	Temperaturobergrenze
	Temperaturgrenze
%	Feuchtigkeitsbegrenzung
	Biologische Risiken
	Nicht wiederverwenden
	Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische *Gebrauchsanweisung* beachten
	Vorsicht
LATEX	Enthält oder Vorhandensein von Naturgummilatex
IVD	Medizingerät zur In-vitro-Diagnostik
CONTROL –	Negative Kontrolle
CONTROL +	Positive Kontrolle
Σ	Inhalt ausreichend für <*n*> Tests
	Nur zur IVD-Leistungsbewertung
	Pyrogenfrei
#	Patientennummer
	Diese Seite nach oben
	Nicht stapeln

Symbol	Bedeutung
	Einfaches Sterilbarrieresystem
PHT DEHP BBP	Enthält oder Anwesenheit von Phthalat: Kombination aus Bis(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) und Benzylbutylphthalat (BBP)
	Gesondert sammeln Gibt an, dass eine getrennte Sammlung für Elektro- und Elektronik-Altgeräte erforderlich ist.
CE	CE-Kennzeichnung, steht für die europäische technische Konformität
	Produkt für patientennahe Tests
	Produkt zur Eigenanwendung
Rx Only	Folgendes gilt nur in den USA: „Vorsicht: Gemäß der Bundesgesetzgebung der USA darf dieses Gerät nur an zugelassene Ärzte oder auf deren Anweisung verkauft werden."
CC	Herstellungsland „CC" wird durch den aus zwei oder drei Buchstaben bestehenden Ländercode ersetzt.
	Entnahmezeit
	Schneiden
	Hier aufreißen
	Entnahmedatum
	Vor Licht schützen
H_2	Erzeugt Wasserstoffgas
	Perforation
	Start-Panel-Sequenznummer
	End-Panel-Sequenznummer
	Interne Sequenznummer
MD	Medizinprodukt
	Enthält Gefahrstoffe
	Ukrainisches Konformitätskennzeichen
FC	Erfüllt die FCC-Anforderungen gemäß 21 CFR Teil 15
c UL us	UL-Produktzertifizierung für USA und Kanada
UDI	Eindeutige Produktkennung

Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417-1885 USA

EC REP Becton Dickinson Ireland Ltd.
Donore Road, Drogheda, Co. Louth, A92 YW26, Ireland

CH REP BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park – A4, Route de Crassier 17, 1262 Eysins, Switzerland

Australian and New Zealand Sponsors:
Becton Dickinson Pty Ltd., 66 Waterloo Road
Macquarie Park NSW 2113, Australia

Becton Dickinson Limited, 14B George Bourke Drive
Mt. Wellington Auckland 1060, New Zealand

BD, das BD-Logo, Microgard, Microtainer, PST und SST sind Marken von Becton, Dickinson and Company oder seinen verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2022 BD. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu möglicherweise in den USA geltenden Patenten finden Sie unter bd.com/patents.

2022-02
VDP40477(01)