25-羟基维生素 D 校准品说明书

【产品名称】

通用名称：25-羟基维生素D校准品

英文名称：Access 25(OH) Vitamin D Total Calibrators

【包装规格】

校准品0（S0）- 校准品5（S5）：1.4 mL/瓶

【预期用途】

本产品用于25-羟基维生素D测定时的校准。

并与UniCel DxI 800全自动免疫分析仪配合使用，定量测定人血清和血浆中的总25-羟基维生素D的水平。临床用于辅助评估维生素D是否充足。

【检验原理】

定量检测项目的校准原理是将具有已知分析物浓度的样本（即校准品），像检测患者样本那样进行测试，测量其反应所得到的相对发光量值。通过相对发光量值与已知的分析物浓度之间的数学关系，建立校准曲线。检测患者样本时，将患者样本的相对发光量值（RLU），利用该数学关系式或校准曲线进行转换，即可对应得出该样本中的定量分析物的浓度。

【主要组成成分】

S0：	含< 0.1%叠氮钠和 0.1% Proclin* 300 的人血清
S1、S2、S3、S4、S5：	约含 6、17、37、87 和 210 ng/mL（15、43、93、218 和 525 nmol/L）25-羟基维生素 D 的人血清，< 0.1%叠氮钠，0.1% ProClin 300
校准卡：	1

溯源性:

25-羟基维生素 D 校准品中的测量物（分析物）可溯源至由根特大学开发，并获得检验医学溯源联合委员会（JCTLM）批准的同位素稀释质谱法（ID-LC-MS/MS）参考方法程序（RMP）。[1,2] 该 RMP 可进一步溯源至 NIST SRM 2972。[2,3] 溯源性的建立过程按 EN ISO 17511 进行。

将 40 份血清样本，利用 25-羟基维生素 D 检测试剂盒在 UniCel DxI 800 全自动免疫分析仪上检测，并与通过 RMP 方法检测所得的结果进行比较，通过加权 Deming 回归分析后，得

到以下结果：

N	斜率（95% CI）	ng/mL		nmol/L	
		观察范围†	截距（95% CI）	观察范围†	截距（95% CI）
40	0.97（0.73 - 1.20）	9.0 - 79.2	-0.75（-7.57 - 6.06）	22.5 - 198.0	-1.88（-18.92 - 15.15）

† 观察到的 RMP 浓度范围。

散点图及 Deming 拟合

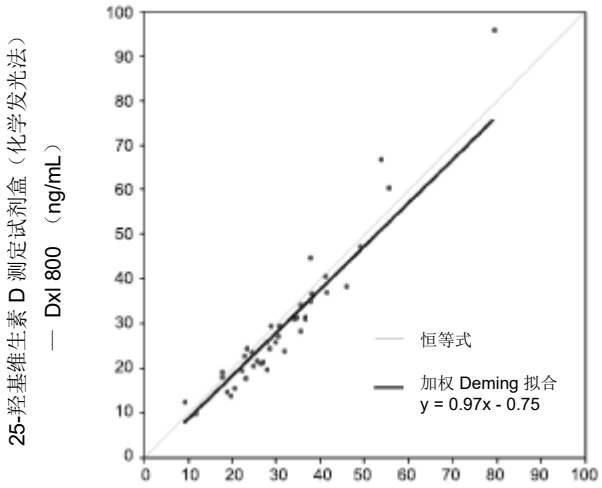

ID-LC-MS/MS 25-羟基维生素 D RMP（ng/mL）

使用其它方法确定的赋值可能会存在差异。若此差异存在，可能是不同方法间的偏倚造成的。

【储存条件及有效期】

在-15℃至-30℃环境下冷冻保存，有效期265天。

生产日期和失效日期详见标签。

- 即用型。
- 接收后在-15至-30℃环境下冷冻保存且竖直放置。
- 在室温下解冻。使用前轻轻倒转以充分混匀不同成份。防止形成气泡。
- 从-15至-30℃的保存环境中取出后，解冻的小瓶可于2至10℃下稳定保存56天。在小瓶上标记解冻日期和失效日期。
- 每次使用后，将校准品返回2至10℃下。请勿冷冻已开封的小瓶。

- 可能存在变质情况的表现为质控值超出范围。
- 参见校准卡以获取准确的浓度信息。

【适用仪器】

UniCel DxI800 全自动免疫分析仪。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品、校准品测试申请的输入和审核校准数据的信息。
2. **校准品 S0 在校准时需重复运行四次，校准品 S1 重复运行 3 次，校准品 S2-S5 重复运行两次。**
   该校准品提供 6 种浓度水平 – 0 以及 6、17、37、87 和 210 ng/m（15、43、93、218 和 525 nmol/L）。校准曲线有效期为 28 天。

【检验方法的局限性】

试剂内如有微生物污染的迹象或显著浑浊，请丢弃。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 按照所述程序对患者样本和血液制品进行常规操作时，可将风险降至最低。然而，无论其来源、处理方式或事先获得的证明如何，均应视为具有潜在传染性，并按照通用的预防措施和药物临床试验质量管理规范进行操作。使用适当的消毒剂消毒。这些材料及其容器的存储和处置应遵照当地法规和指导原则。
- 已对用于制备试剂的人源性材料进行了试验，结果显示对乙型肝炎、丙型肝炎（HCV）和人体免疫缺损病毒（HIV-1 和 HIV-2）呈阴性或无反应。因为没有任何检测方法可完全确保不存在致病因子，因此将试剂和患者样本视为可能传播感染性疾病。[4]
- 有关产品存在的危害，请参照以下章节：**反应成分，GHS 危险等级分类和 EU 危险等级分类**。

反应成分

⚠ 注意

叠氮钠防腐剂在金属排水管中可能形成爆炸性化合物。
参见 NIOSH 公报：爆炸性叠氮化物危害（8/16/76）。
为避免可能产生的叠氮化物堆积，请在处置未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮钠的处理必须符合当地的相关规定。

GHS 危险等级分类

25-羟基维生素D校准品S0 警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉被污染的衣服，清洗后方可使用. 反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC#247-500-7] 和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC#220-239-6](3:1) < 0.05%

25-羟基维生素D校准品S1、S2、S3、S4、S5、S6 警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉被污染的衣服，清洗后方可使用. 反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC#247-500-7] 和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC#220-239-6](3:1) < 0.05%

SDS	安全数据表可从 techdocs.beckmancoulter.com 获取

欧洲危害等级分类

25-羟基维生素 D 校准品 S0 Xi; R43

R43	皮肤接触可引起过敏。
S24	避免接触皮肤。
S28	接触皮肤后，立即用大量肥皂和水冲洗。
S37	佩戴合适的手套。

25-羟基维生素 D 校准品 S1、S2、S3、S4、S5 Xi; R43

R43	皮肤接触可引起过敏。

S24	避免接触皮肤。
S28	接触皮肤后，立即用大量肥皂和水冲洗。
S37	佩戴合适的手套。

【标识的解释】

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【参考文献】

1. Stepman HCM, Vanderroost A, Van Uytfanghe K, Thienpont LM. Candidate reference measurement procedures for serum 25-hydroxyvitamin D_3 and 25-hydroxyvitamin D_2 using isotope dilution-liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Clin Chem 2011; 57: 441-448.
2. Thienpont L, Stepman HCM, Vesper HW. Standardization of measurements of 25-Hydroxyvitamin D_3 and D_2. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 2012; 72 (Suppl 243): 41-49.
3. Certificate of analysis, Standard Reference Material 2972: 25-hydroxyvitamin D_2 and D_3 calibration solutions. Gaithersburg, MD: Standard Reference Materials Program, NIST; 2009.
4. HHS Publication, 5th ed., December 2009. Biosafety in Microbiological and

Biomedical Laboratories.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, California, 92821, USA

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, Minnesota, 55318, USA

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进20202400054

【说明书核准日期及修改日期】

2020-2-3

2020-11-27

2022-06-30