


**HbA1c:** Žádná data

**Pumpa:Paradigm Veo - 554**

**Senzor:**Použitý

**Glukóza - vysoká / nízká / průměrná (mmol/l)**

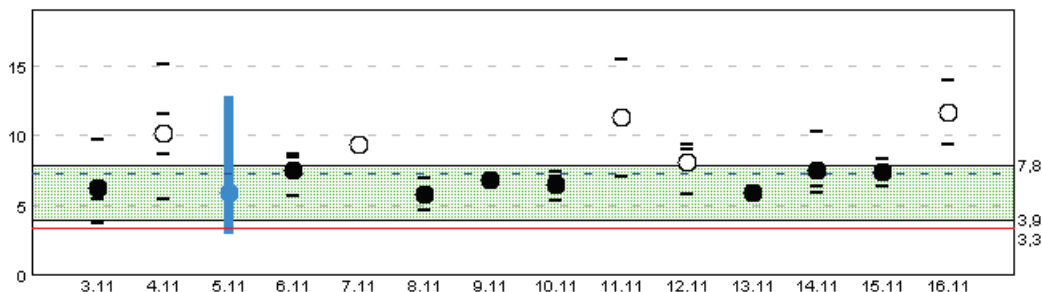


V rozsahu ● Mimo rozsah ○ Glukometr (GL) — Glukóza ze senzoru (SGL) | Cílový rozsah ■ Prům. --- Hypo —




## Stat. GL/SGL

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Prům. Glukóza            | 8,1 / 7,2   |
| Počet měření             | 38 / 169    |
| Prům. Počet měření / den | 2,71 / 84,5 |

**Celk. denní dávka inzulínu (jedn.)**


**Bazální dávka**  **Bolus**  **Baz. dáv. > 50 %**  **Prům. Celk. denní dávka** 

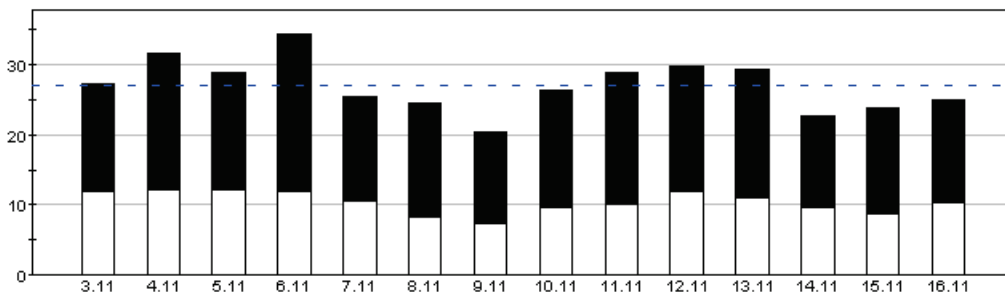

|                          |      |     |
|--------------------------|------|-----|
| Prům. Celk. denní dávka  | 27,0 |     |
| Prům. Denní bazál.       | 10,4 | 39% |
| Prům. Denní bolus        | 16,6 | 61% |
| Prům. Počet bolusů / den | 8,14 |     |

### Celkové denní sacharidy (gramy)

Prům. ...

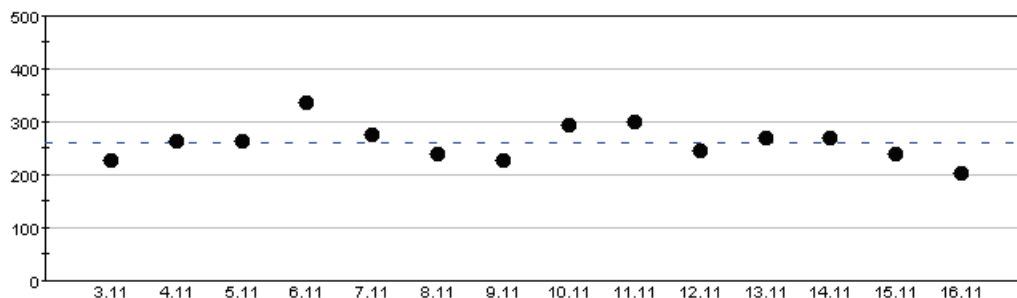

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Prům. Denní sachar. | 261 |
| Max. denní sachar.  | 336 |
| Min. denní sachar.  | 204 |

### Souhrn (Data pro každý den)

[illegible]