


HbA1c: Žádná data

Data senzoru (mmol/l)

16.11.12 — Prům. —

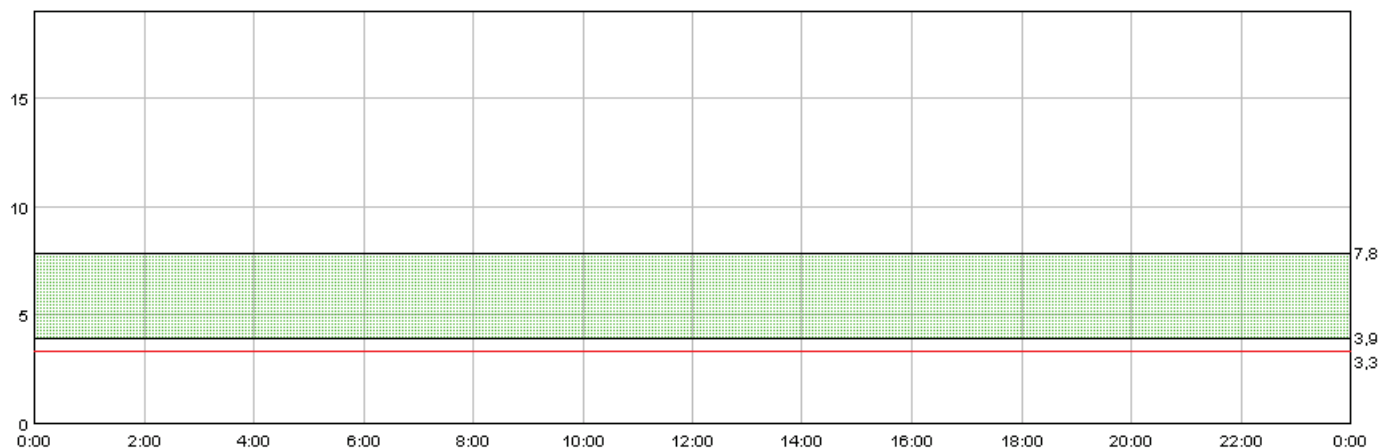

	Pá 16 XI	Průměr / Celkem
Počet hodnot senzoru	0	0
Vysoká SGL (mmol/l)	—	0,0
Nizká SGL (mmol/l)	—	0,0
Průměrná SGL (mmol/l)	—	0,0
Standardní odch.	—	—
Průměrný absolutní rozdíl (%)	—	—
Počet platných kalibrací	0	0

Souhrn výkyvů

	Pá 16 XI	Průměr / Celkem
Počet výkyvů	0	0
Počet vysokých výkyvů	0	0
Počet výkyvů hypo	0	0
AUC nad limit	—	—
AUC pod limit	—	—

Rozložení trvání (hh:mm)



Nad 7,8	—								
V rámci (3,9 - 7,8)	—								
Pod 3,9	—								