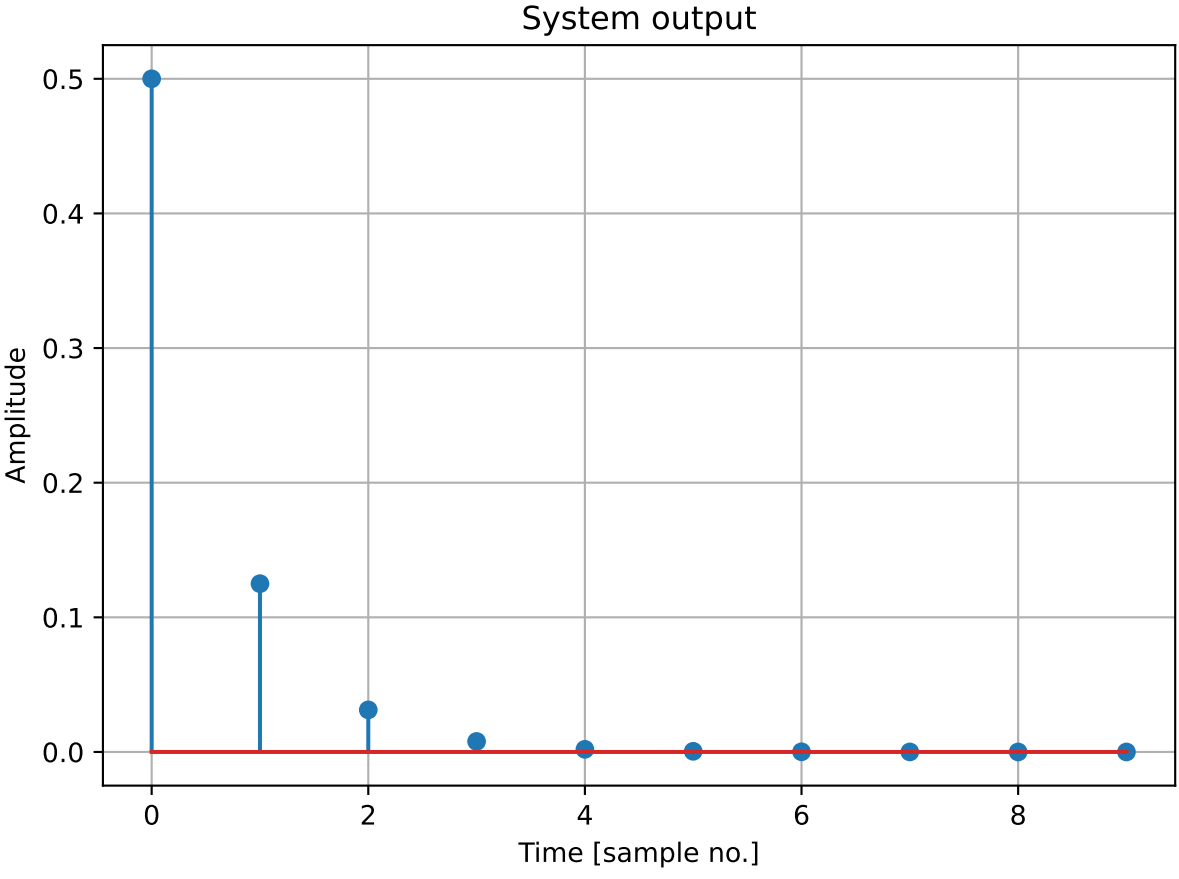
System output
Amplitude
Time [sample no.]
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
2
4
6
8