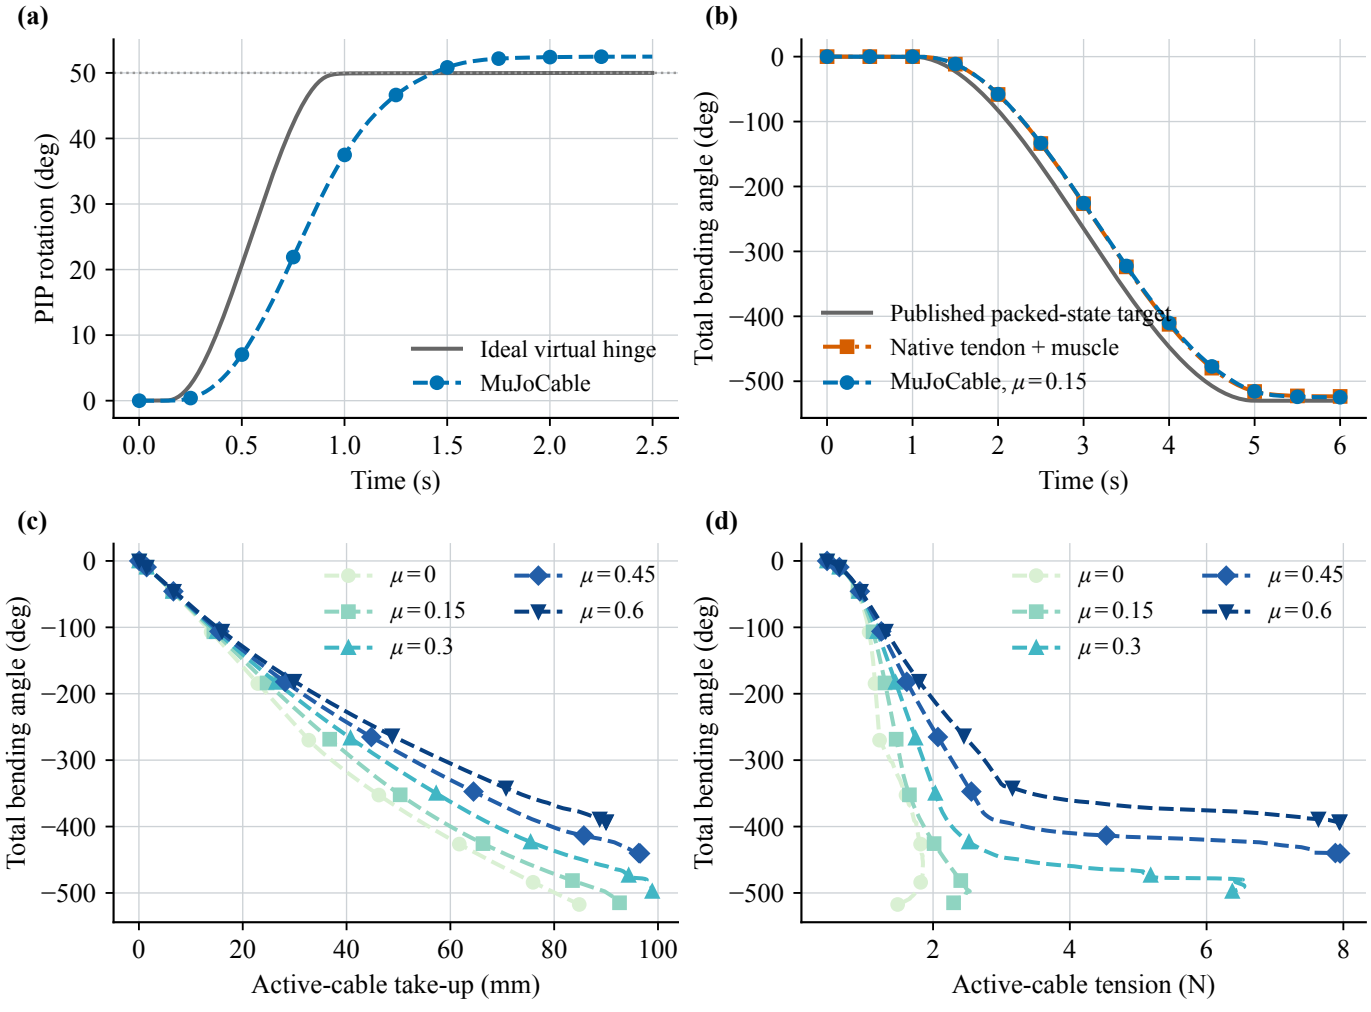

(a)
PIP rotation (deg)
Time (s)
Ideal virtual hinge
MuJoCable
(b)
Total bending angle (deg)
Time (s)
Published packed-state target
Native tendon + muscle
MuJoCable, μ = 0.15
(c)
Total bending angle (deg)
Active-cable take-up (mm)
μ = 0
μ = 0.15
μ = 0.3
μ = 0.45
μ = 0.6
(d)
Total bending angle (deg)
Active-cable tension (N)
μ = 0
μ = 0.15
μ = 0.3
μ = 0.45
μ = 0.6