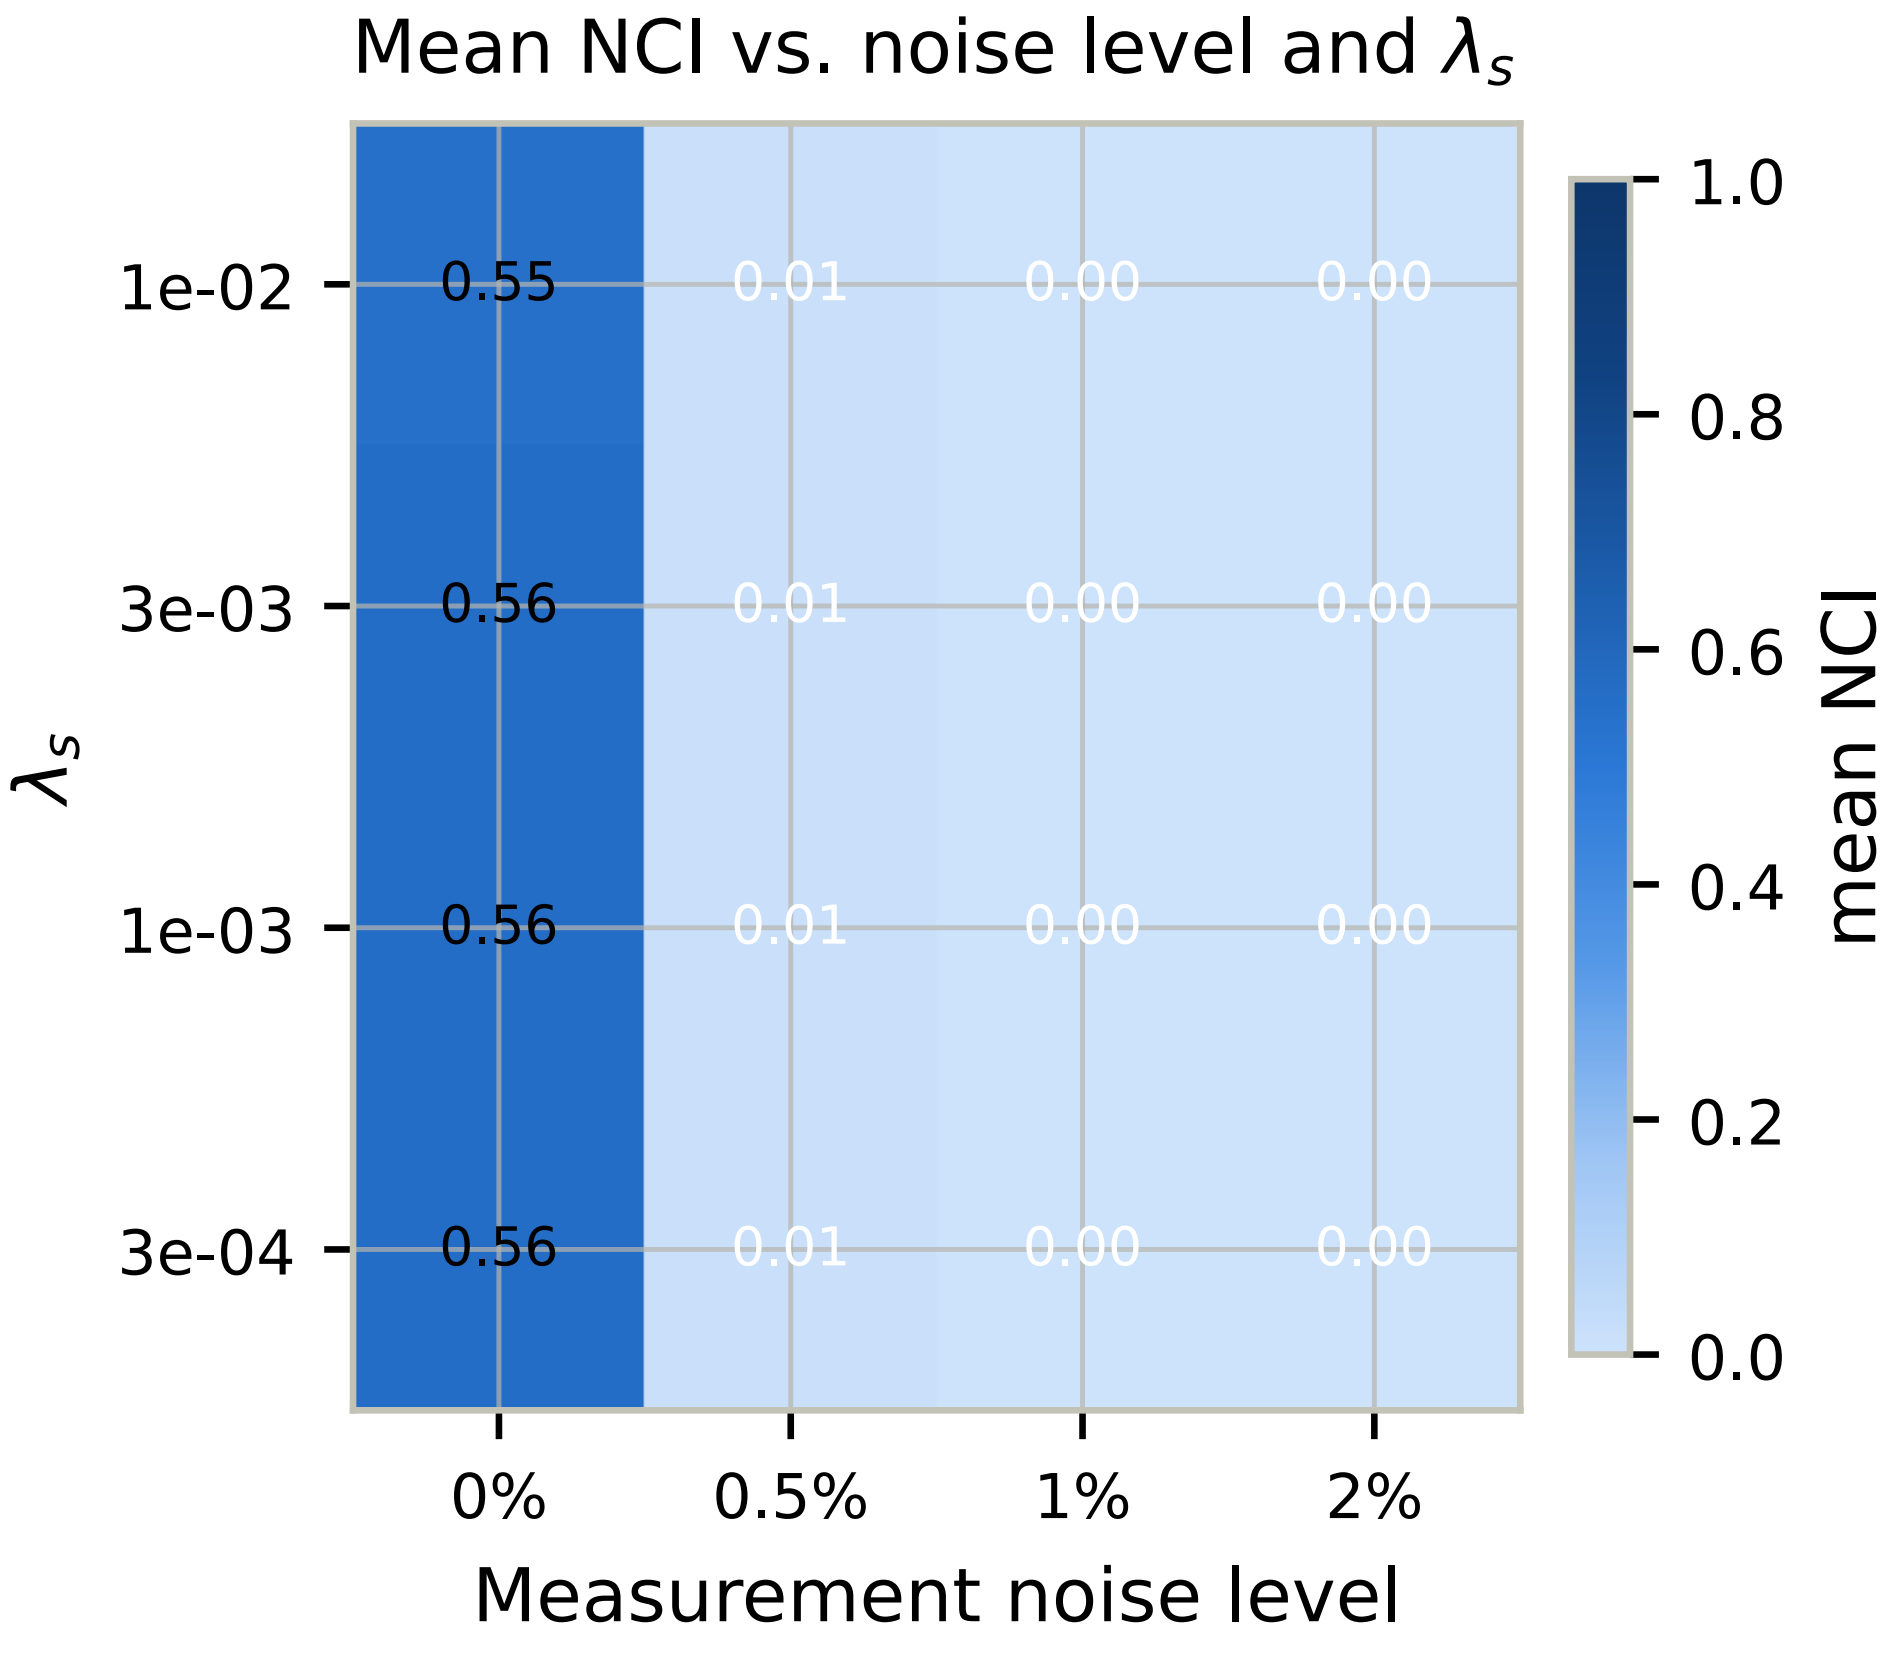
Mean NCI vs. noise level and λ_s
1e-02
3e-03
1e-03
3e-04
λ_s
0.55
0.01
0.00
0.00
0.56
0.01
0.00
0.00
0.56
0.01
0.00
0.00
0.56
0.01
0.00
0.00
0%
0.5%
1%
2%
Measurement noise level
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
mean NCI