


Samples per sec. = 4800/1

Sanyo 3400ma KS 2983 at 2C discharge
On shaker for 25 secs at 4800s/sec on normal axis



9-2 conta

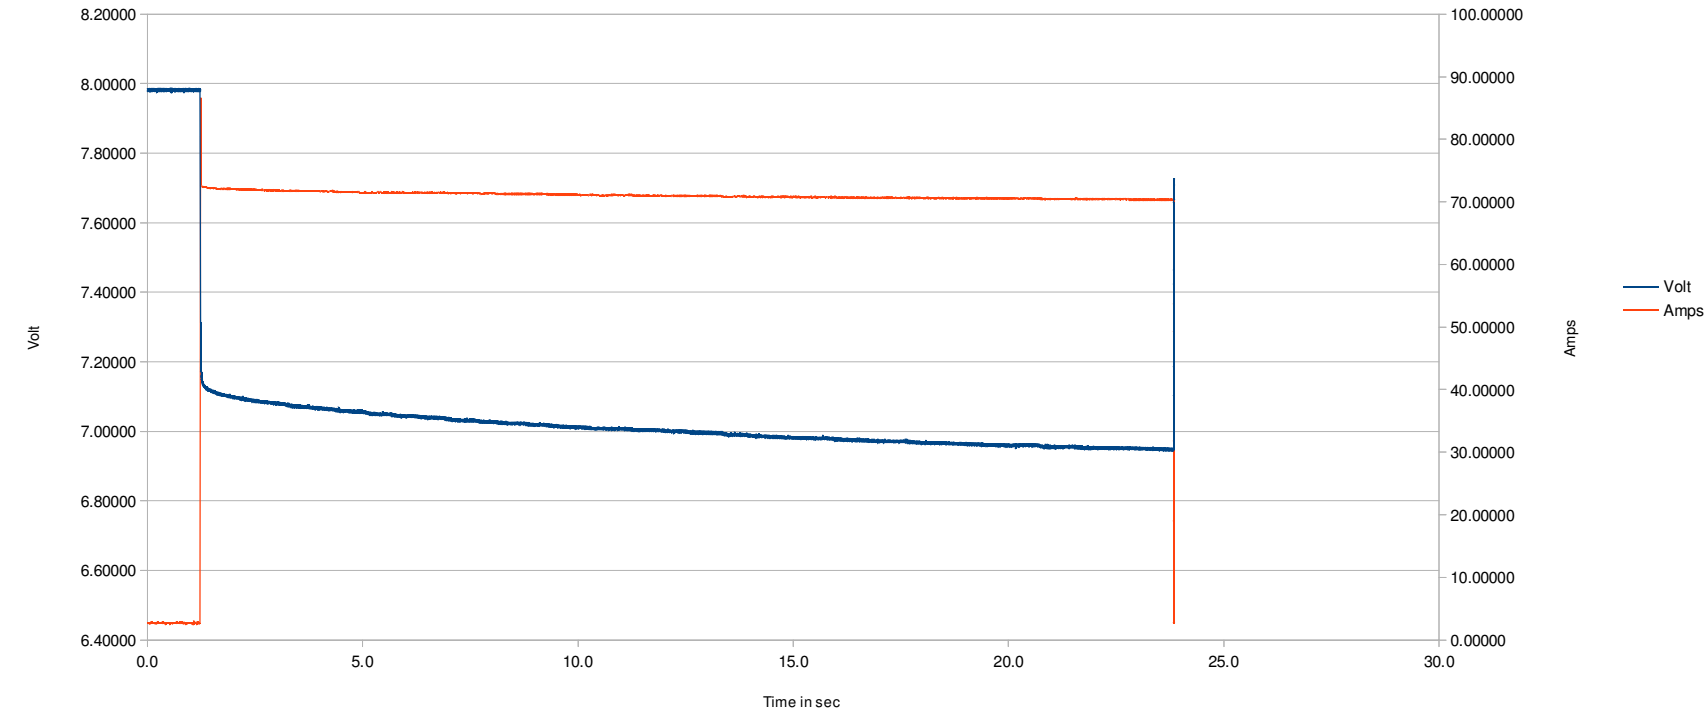

0.0	7.98060	2.72390	06/11/15	01:36:00 PM
0.0	7.98310	2.72390	06/11/15	01:36:00 PM
0.0	7.98060	2.71160	06/11/15	01:36:00 PM
0.0	7.98310	2.72390	06/11/15	01:36:00 PM
0.0	7.98180	2.72390	06/11/15	01:36:00 PM
0.0	7.98180	2.69930	06/11/15	01:36:00 PM
0.0	7.98180	2.72390	06/11/15	01:36:00 PM
0.0	7.98310	2.73610	06/11/15	01:36:00 PM
0.0	7.98310	2.71160	06/11/15	01:36:00 PM
0.0	7.98180	2.71160	06/11/15	01:36:00 PM
0.0	7.98180	2.72390	06/11/15	01:36:00 PM
0.0	7.98310	2.71160	06/11/15	01:36:00 PM
0.0	7.98060	2.71160	06/11/15	01:36:00 PM
0.0	7.98060	2.71160	06/11/15	01:36:00 PM
0.0	7.98430	2.73610	06/11/15	01:36:00 PM