Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 50217
CALIBRATION DATE: 10-Apr-26

SBE 16plus V2 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

g = -1.010314e+00
h = 1.292675e-01
i = -1.406052e-04
j = 2.649546e-05

CPcor = -9.5700e-008
CTcor = 3.2500e-006

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2797.67	0.0000	0.00000
1.0000	34.6290	2.96148	5542.32	2.9615	0.00001
4.5001	34.6089	3.26709	5750.87	3.2671	-0.00001
14.9999	34.5666	4.24420	6371.30	4.2442	-0.00001
18.5000	34.5574	4.58771	6575.25	4.5877	-0.00000
24.0000	34.5475	5.14304	6891.92	5.1431	0.00001
29.0000	34.5420	5.66243	7175.13	5.6624	0.00002
32.5000	34.5390	6.03308	7370.37	6.0331	-0.00002

f = Instrument Output (Hz) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity

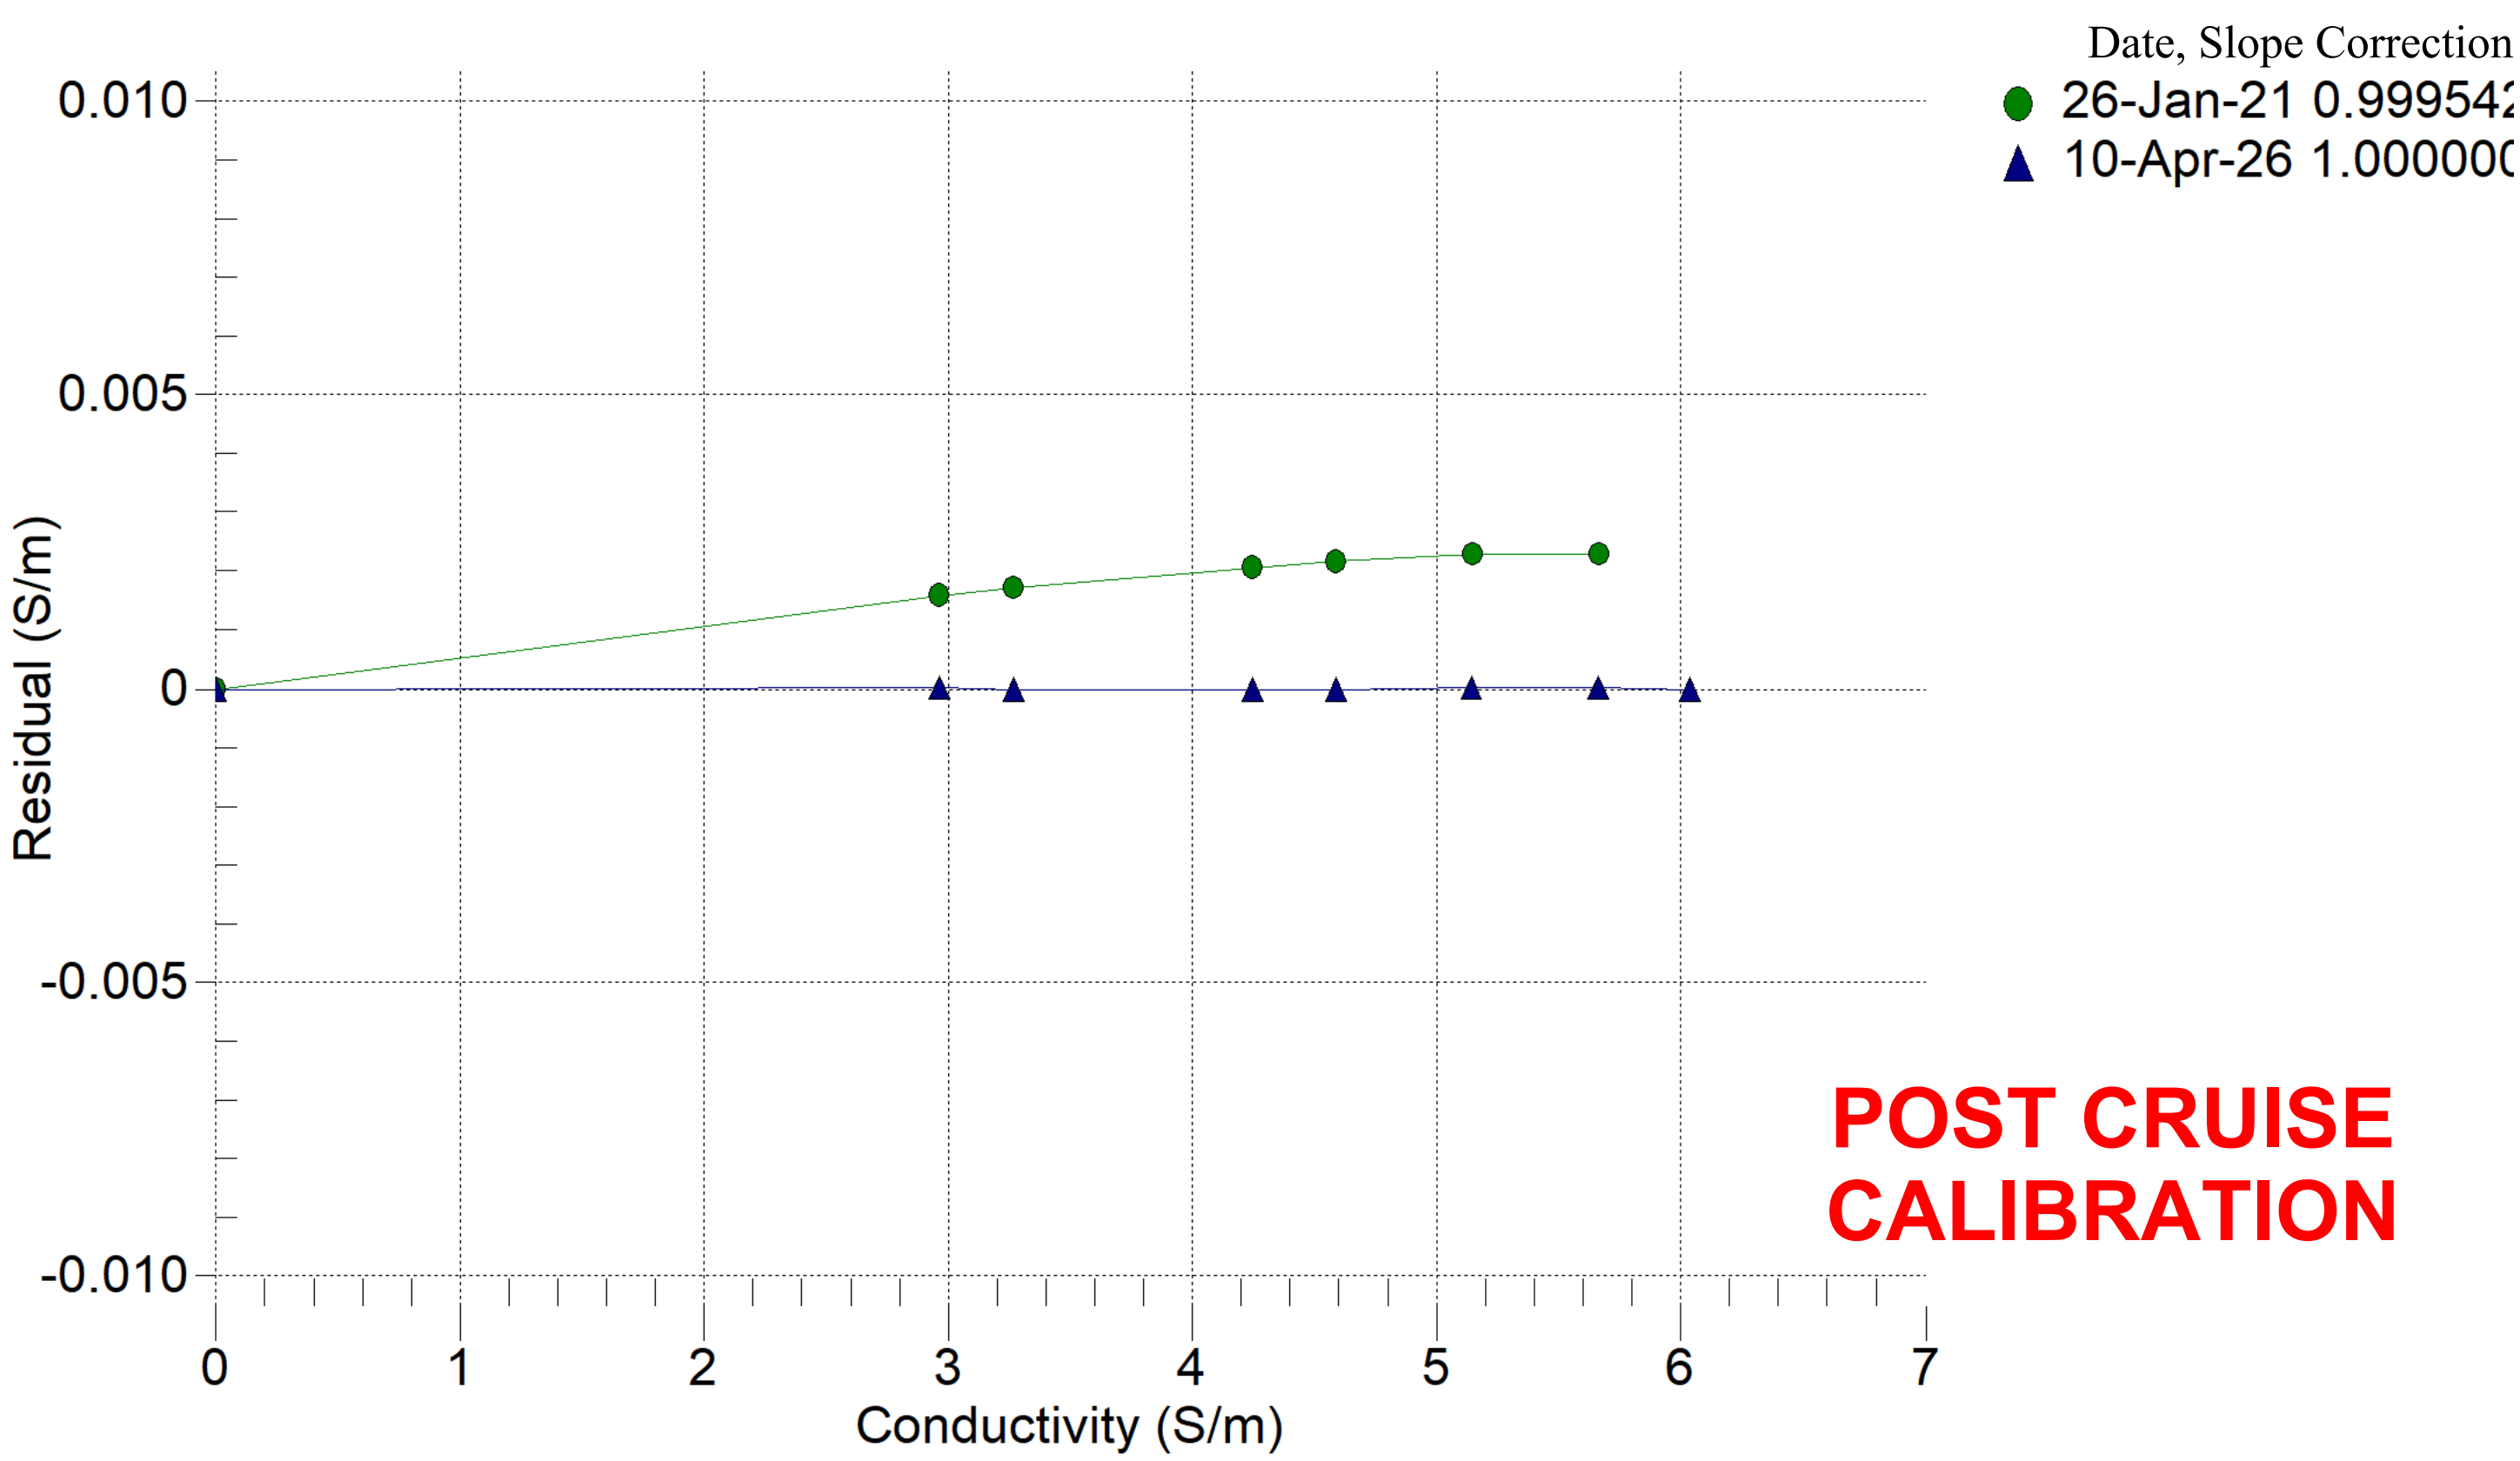

POST CRUISE CALIBRATION